

A

B

1%

11%

87%

1%

6%

15%

78%

1%

40

54

70

180

250

400

mg/dL

SmartGuard verlaten

A

B

Geen kalibratie

0

0

SmartGuard Max toediening

0

0

SmartGuard Min toediening

0

0

BG vereist voor SmartGuard

0

0

Te lage waarde sensoralgoritme

0

0

Update sensor bezig

0

0

Geen SG-waarden

0

0

Sensor uitgewerkt

0

1 •

SmartGuard uitgezet door gebruiker

+ • • • • • 6

9 • • • • • +

Langdurige stop

0

0

SmartGuard opwarmen

0

0

Ongedefinieerd

0

0

Statistieken

A

B

SmartGuard (per week)

99% (6d 23h)

81% (5d 16h)

Manuele modus (per week)

1% (01h)

19% (1d 08h)

Gebruiksduur sensor (per week)

97% (6d 19h)

85% (5d 23h)

Gemiddelde SG ± STD

133 ± 41 mg/dL

144 ± 53 mg/dL

GMI³

6,5%

6,8%

Variatiecoëfficiënt (%)

31,0%

37,0%

Lage/hoge SG-alarmen (per dag)

0,1 / 2,9

0,9 / 4,7

BG-gemiddelde

149 ± 70 mg/dL

161 ± 71 mg/dL

BG / Kalibratie (per dag)

1,5 / 1,0

1,9 / 0,8

Totale dagdosis (per dag)

32,4 eenheden

32,5 eenheden

Bolusdosis (per dag)

22,3E (69%)

19,4E (60%)

Autocorrectiehoeveelheid (per dag)

4,3E (19%)

5,4E (28%)

Autobasaal / Basale dosis (per dag)

10,1E (31%)

13,1E (40%)

Infusieset/reservoir vervangen

3,0 / 3,0 dgn

3,7 / 3,7 dgn

KH-invoer/maaltijden (per dag)

164 ± 57 g / 6,3

117 ± 36 g / 4,9

Actieve-insulinetijd

2:00 uur

2:00 uur

Geprogrammeerd 24-uurs basaal handmatig⁴

18,100E


18,100E

SmartGuard-streefwaarde

100 mg/dL

100 mg/dL

1 Meest recente pompinstellingen worden weergegeven
2 Alleen hoogste prioriteit wordt weergegeven.
3 Indicator voor glucoseregulering
4 Geprogrammeerd 24-uurs totaal in Manuele modus voor actief basaal patroon

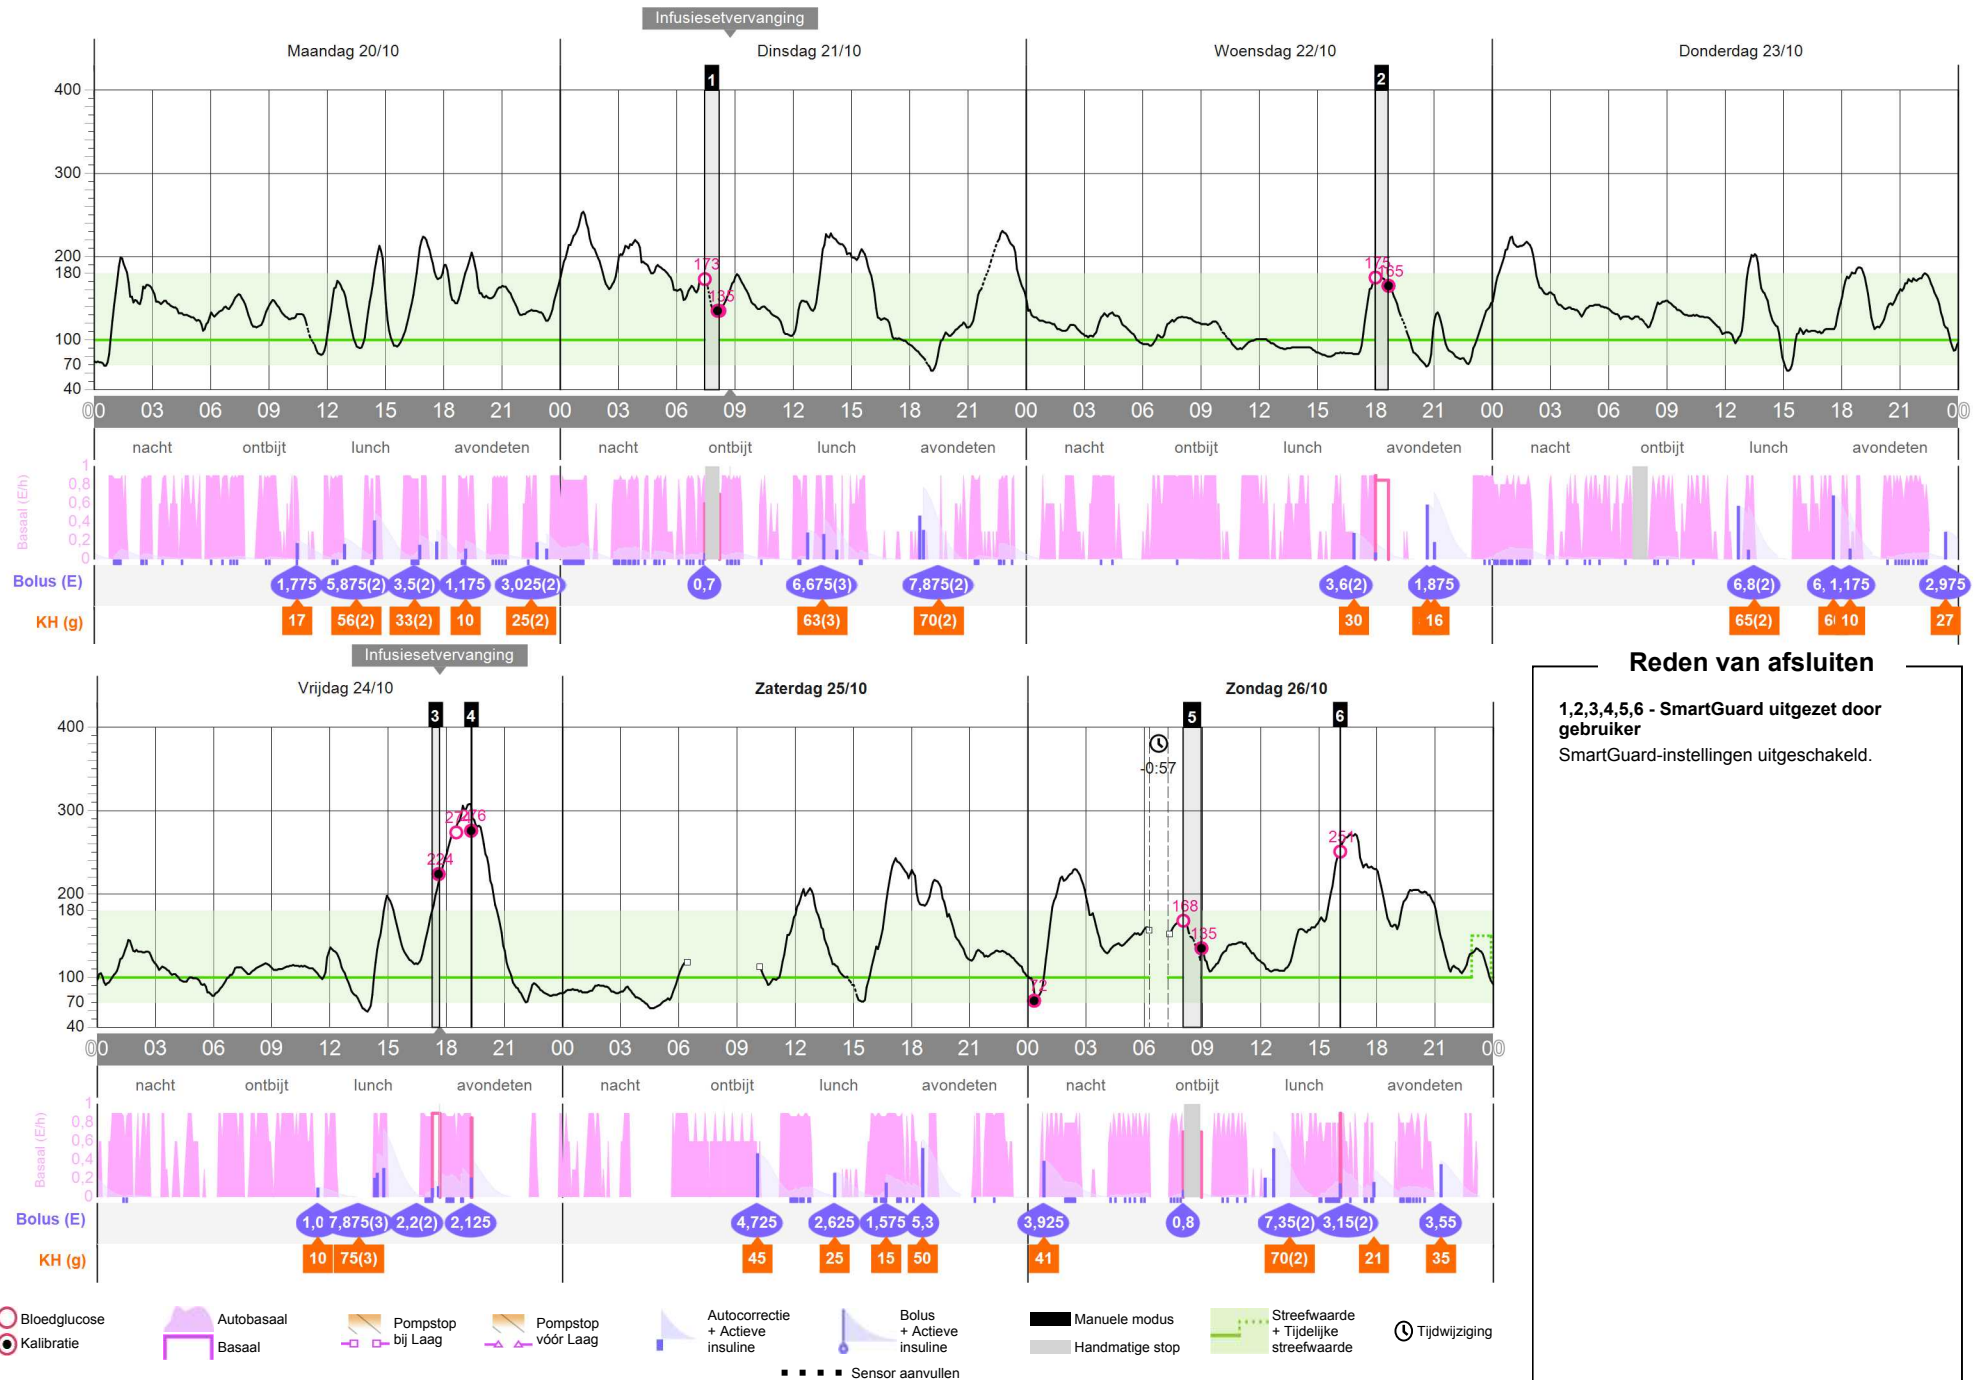

Reden van afsluiten

1,2,3,4,5,6 - SmartGuard uitgezet door gebruiker
SmartGuard-instellingen uitgeschakeld.



Maandag 20/10


TDD 33,2E

Totaal basaal 35% | 11,6E

Totaal bolus 65% | 21,6E

{ Bolus 71% | 15,3E + Autocorrectie 29% | 6,3E }

Tijd binnen bereik

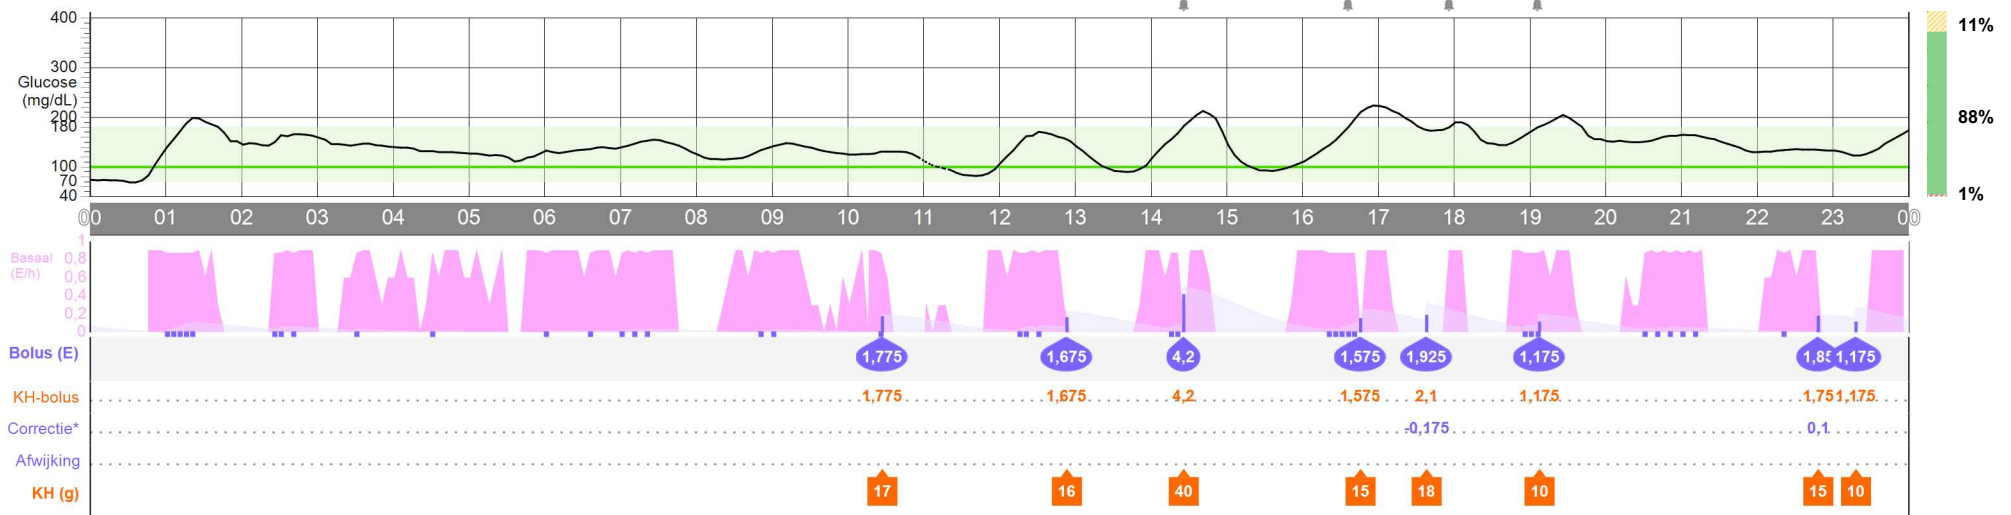

Dinsdag 21/10


TDD 35,8E

Totaal basaal 28% | 10,0E
Infusiesetvervanging

Totaal bolus 72% | 25,8E

{ Bolus 59% | 15,3E + Autocorrectie 41% | 10,5E }

Tijd binnen bereik

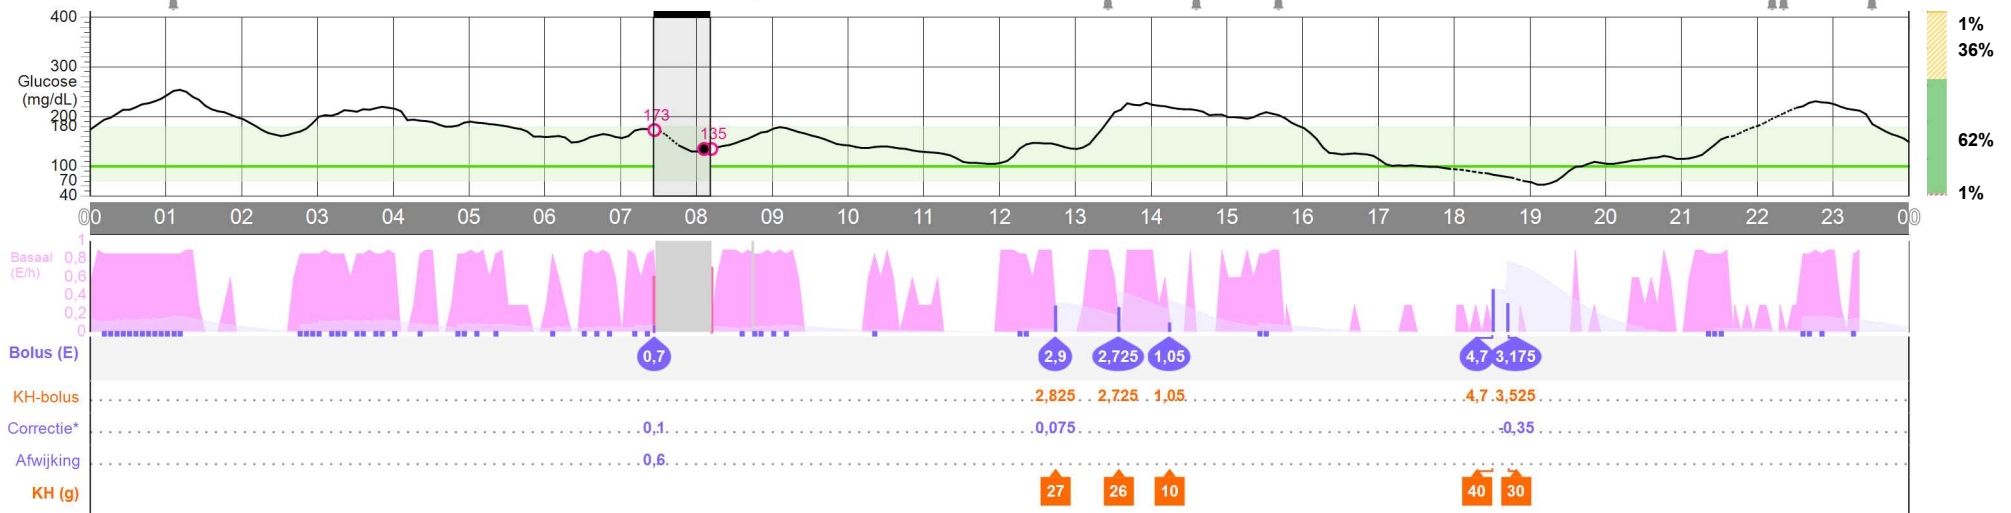

*Actieve insuline meegewogen. SmartGuard weegt SmartGuard-boluscorrectie ook mee.

Woensdag 22/10


TDD 22,5E

Totaal basaal 47% | 10,6E

Totaal bolus 53% | 11,9E

{ Bolus 96% | 11,4E + Autocorrectie 4% | 0,5E }

Tijd binnen bereik

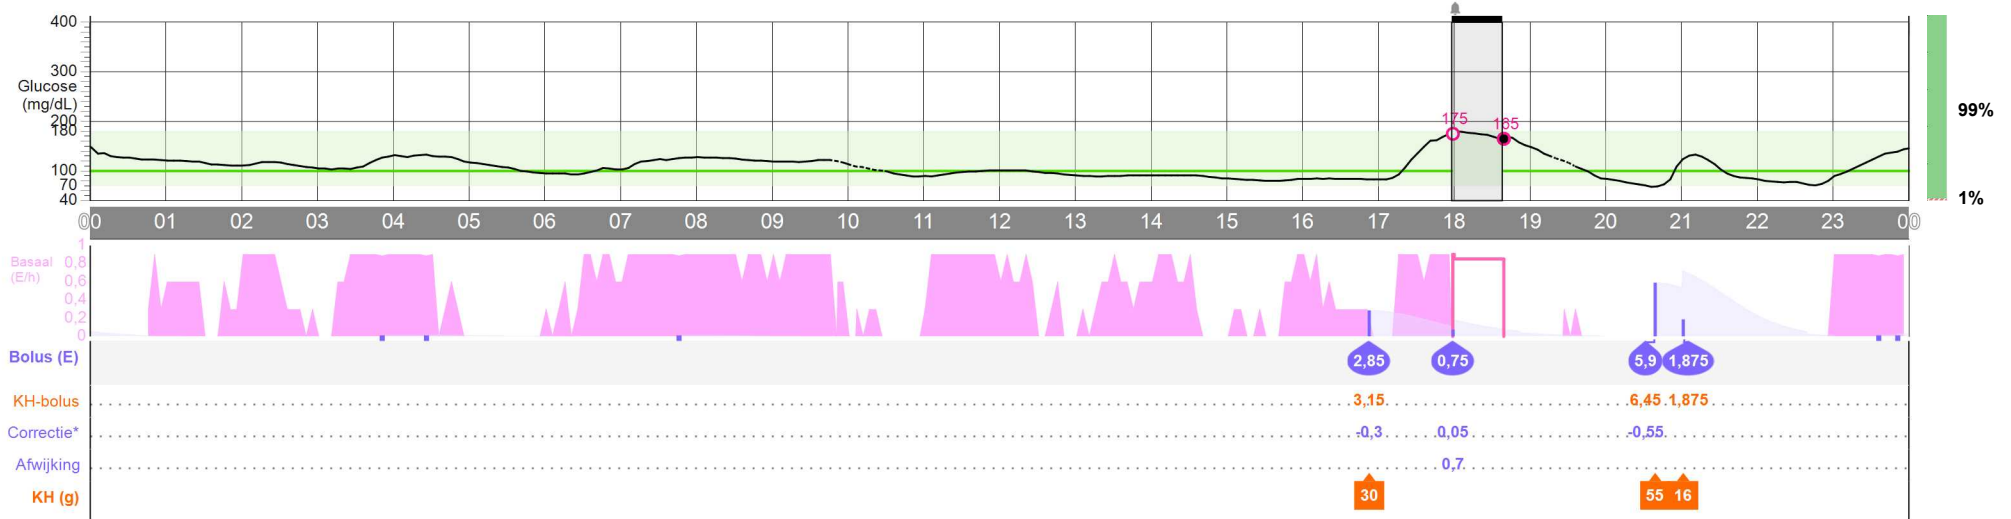

Donderdag 23/10


TDD 34,2E

Totaal basaal 32% | 11,0E

Totaal bolus 68% | 23,2E

{ Bolus 77% | 17,8E + Autocorrectie 23% | 5,4E }

Tijd binnen bereik

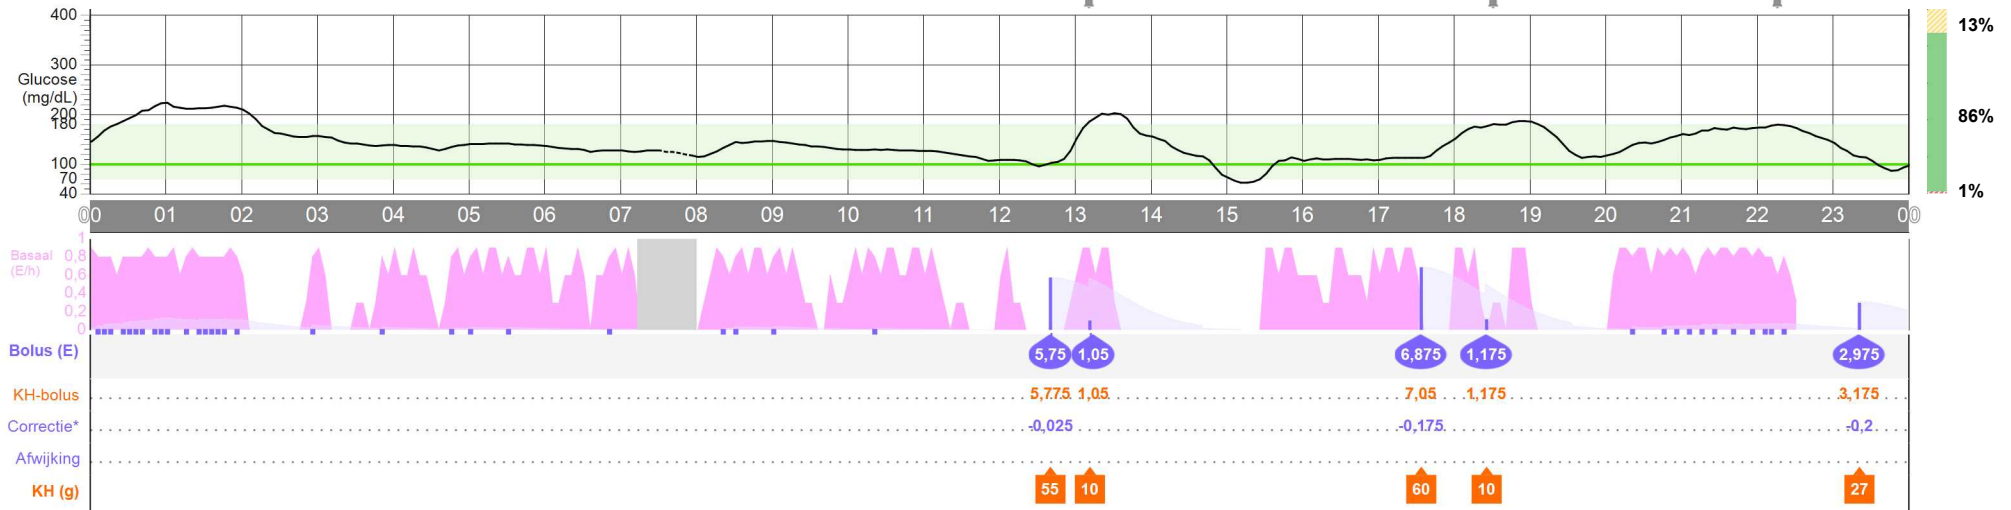

*Actieve insuline meegewogen. SmartGuard weegt SmartGuard-boluscorrectie ook mee.



Vrijdag 24/10

TDD 27,6E


Totaal basaal 38% | 10,4E

Totaal bolus 62% | 17,2E

{ Bolus 77% | 13,2E

+ Autocorrectie 23% | 4,0E }

Tijd binnen bereik

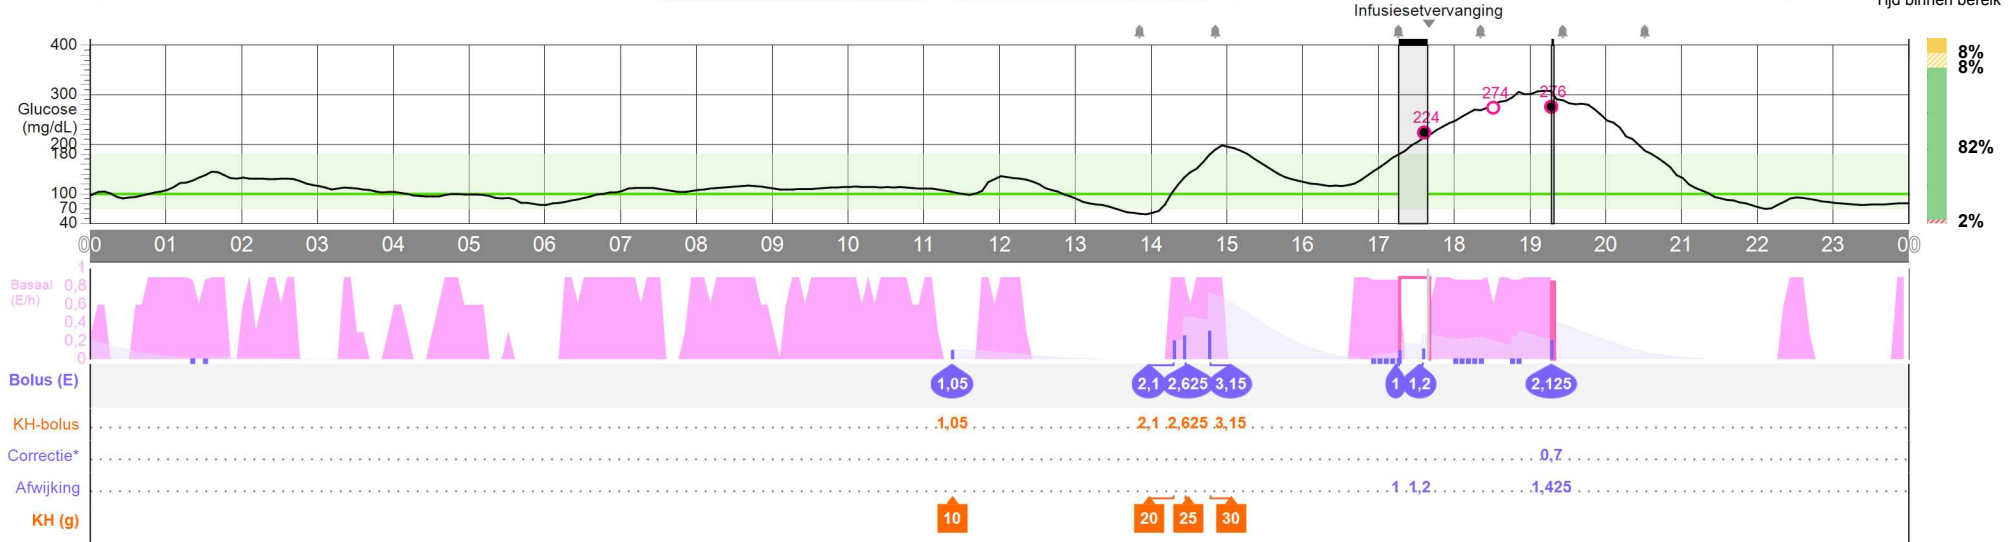

Zaterdag 25/10

TDD 28,4E

Totaal basaal 36% | 10,2E

Totaal bolus 64% | 18,2E

{ Bolus 78% | 14,2E

+ Autocorrectie 22% | 4,0E }

Tijd binnen bereik



*Actieve insuline meegewogen. SmartGuard weegt SmartGuard-boluscorrectie ook mee.



Zondag 26/10

TDD 39,3E

Totaal basaal 29% | 11,3E

Totaal bolus 71% | 28,0E

{ Bolus 67% | 18,8E + Autocorrectie 33% | 9,2E }

Tijd binnen bereik



Maandag 27/10


TDD 29,4E

Totaal basaal 37% | 11,0E

Totaal bolus 63% | 18,4E

{ Bolus 95% | 17,5E + Autocorrectie 5% | 0,9E }

Tijd binnen bereik

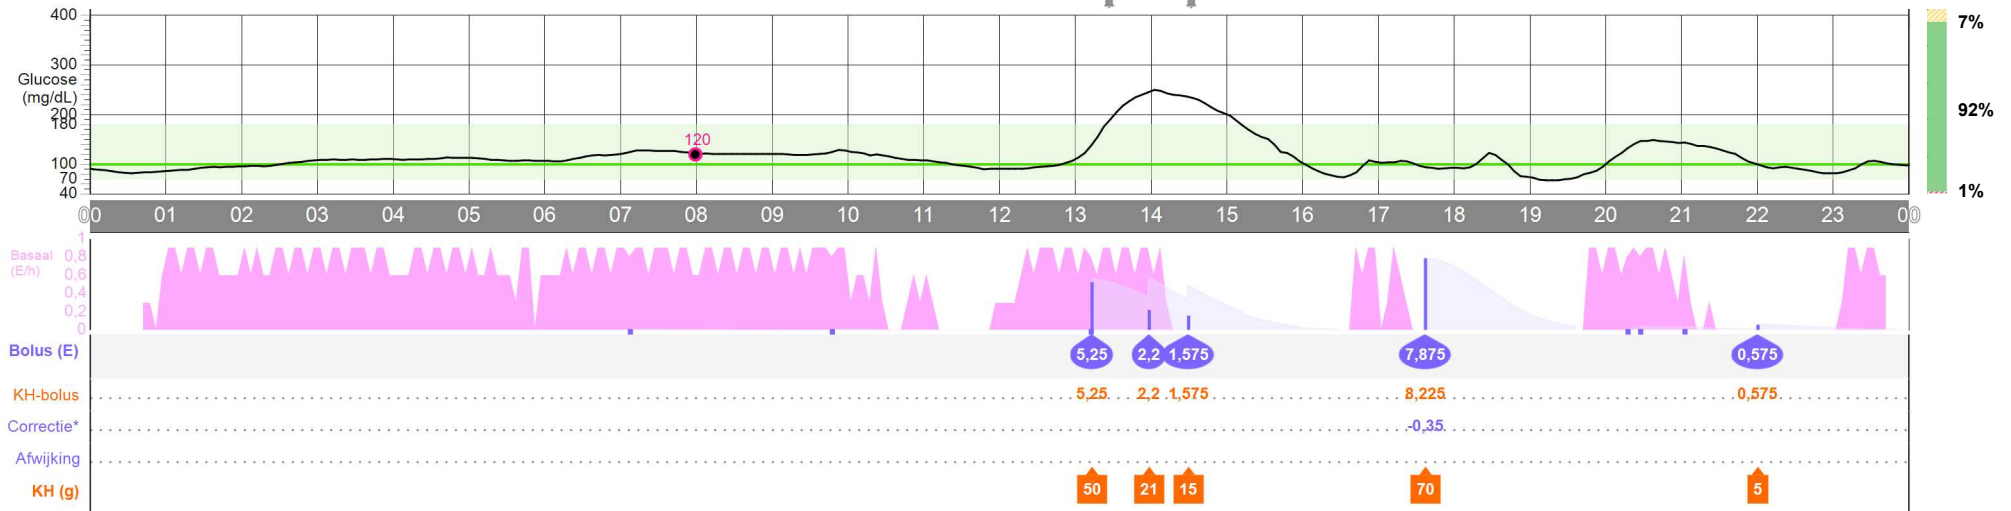

*Actieve insuline meegewogen. SmartGuard weegt SmartGuard-boluscorrectie ook mee.



Dinsdag 28/10

TDD 29,1E
Infusiesetvervanging


Totaal basaal 38% | 11,2E

Totaal bolus 62% | 17,9E

{ Bolus 85% | 15,3E

+ Autocorrectie 15% | 2,6E }

Tijd binnen bereik

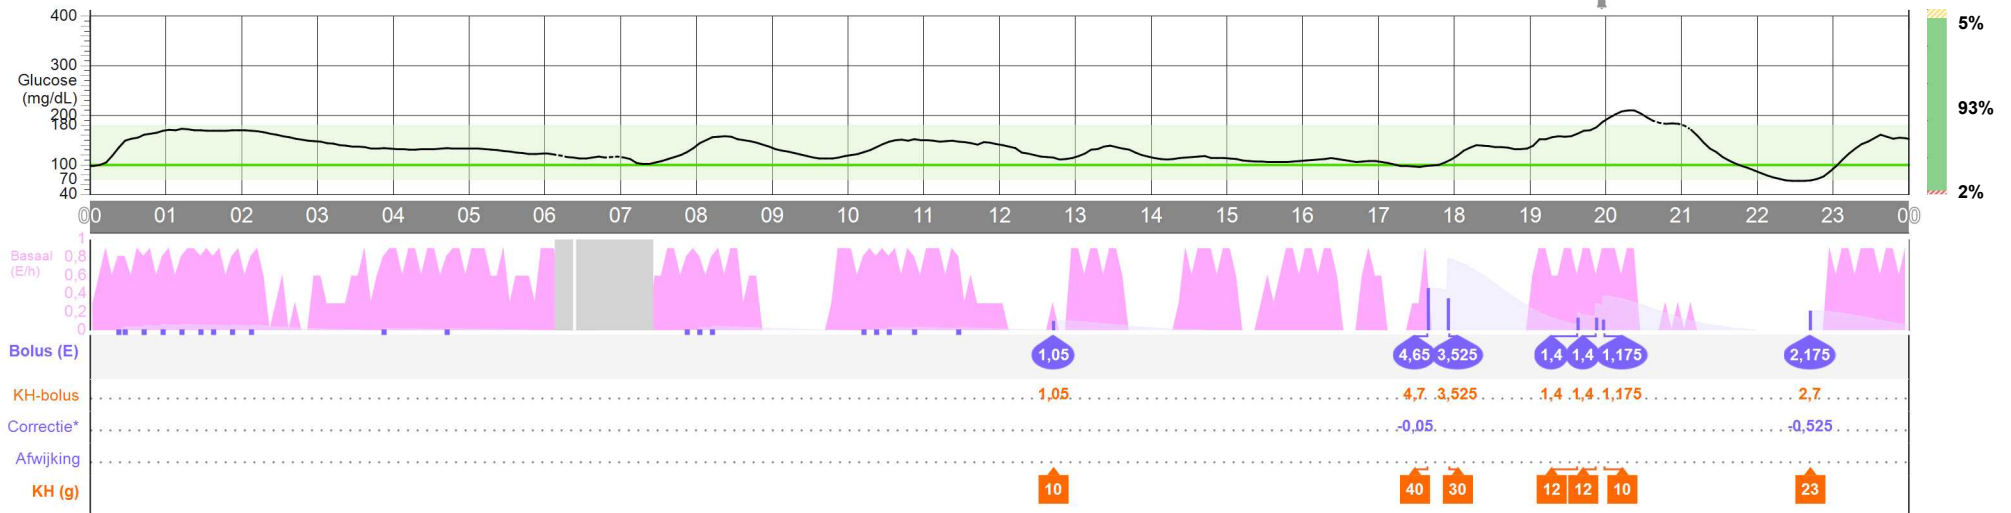

Woensdag 29/10

TDD 32,8E


Totaal basaal 25% | 8,3E

Totaal bolus 75% | 24,5E

{ Bolus 85% | 20,9E

+ Autocorrectie 15% | 3,6E }

Tijd binnen bereik

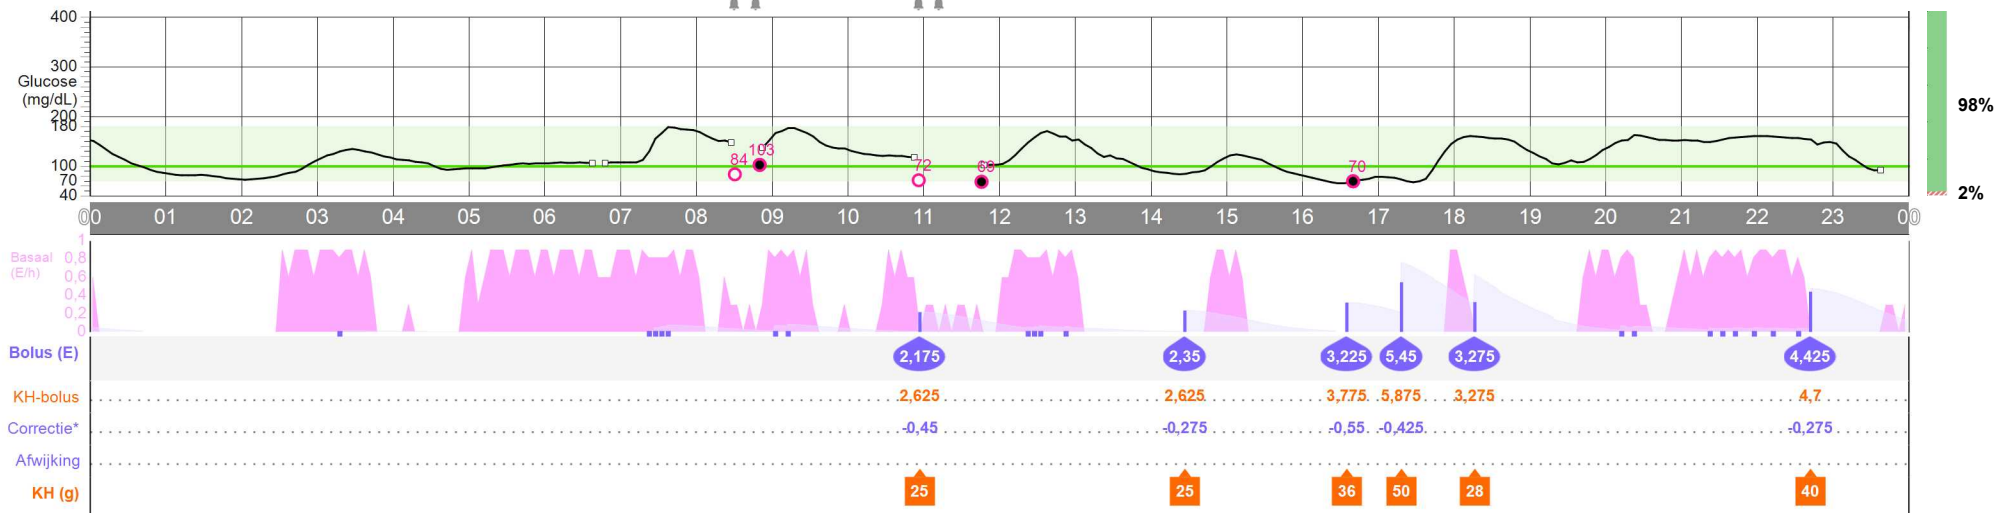

*Actieve insuline meegewogen. SmartGuard weegt SmartGuard-boluscorrectie ook mee.



Donderdag 30/10

TDD 29,3E


Totaal basaal 37% | 10,9E

Totaal bolus 63% | 18,4E
Infusiesetvervanging

{ Bolus 80% | 14,7E

+ Autocorrectie 20% | 3,7E

Tijd binnen bereik

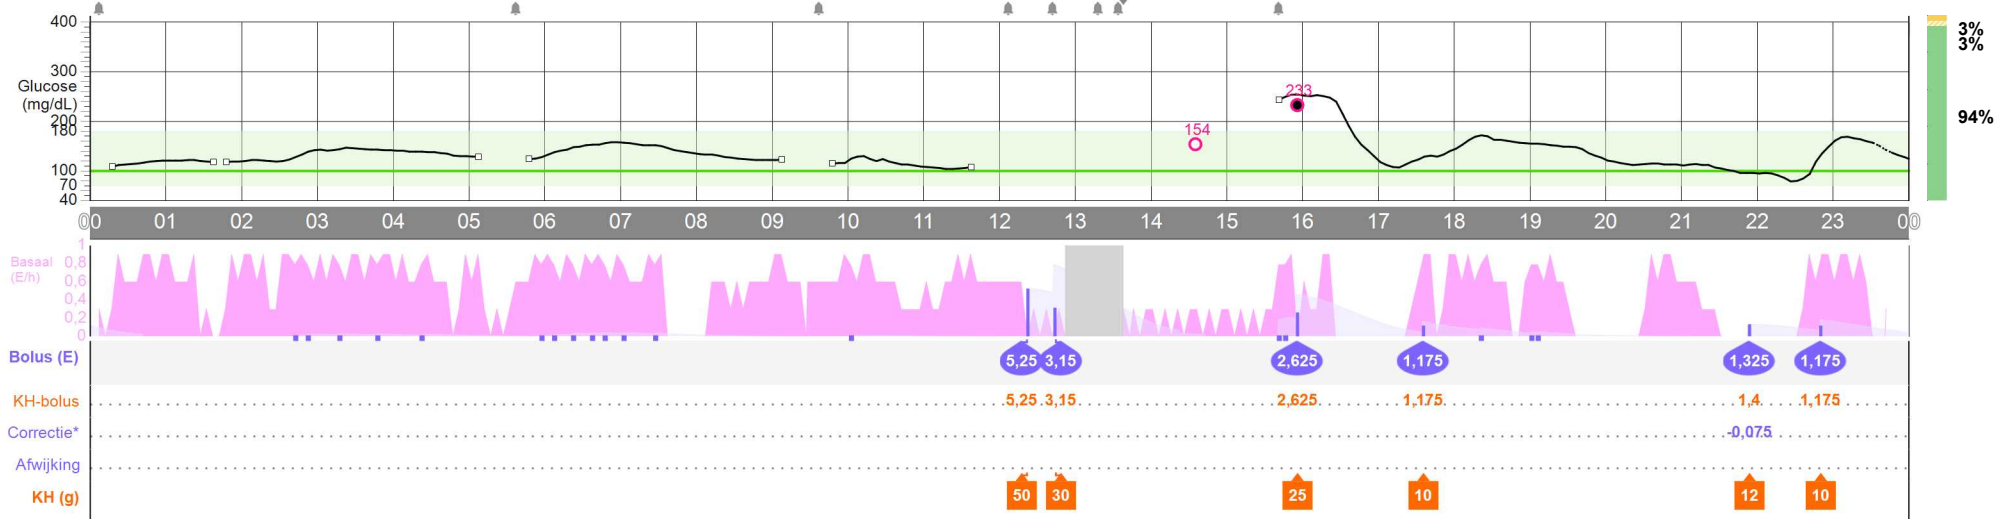

Vrijdag 31/10

TDD 37,4E

Totaal basaal 22% | 8,1E

Totaal bolus 78% | 29,3E

{ Bolus 95% | 27,8E

+ Autocorrectie 5% | 1,5E

Tijd binnen bereik



*Actieve insuline meegewogen. SmartGuard weegt SmartGuard-boluscorrectie ook mee.



Zaterdag 01/11

TDD 45,7E

Totaal basaal 19% | 8,5E

Totaal bolus 81% | 37,2E

{ Bolus 84% | 31,2E

+ Autocorrectie 16% | 6,0E

Tijd binnen bereik



Zondag 02/11

TDD 29,6E


Totaal basaal 29% | 8,6E

Totaal bolus 71% | 21,0E

{ Bolus 90% | 18,9E

+ Autocorrectie 10% | 2,1E

Tijd binnen bereik

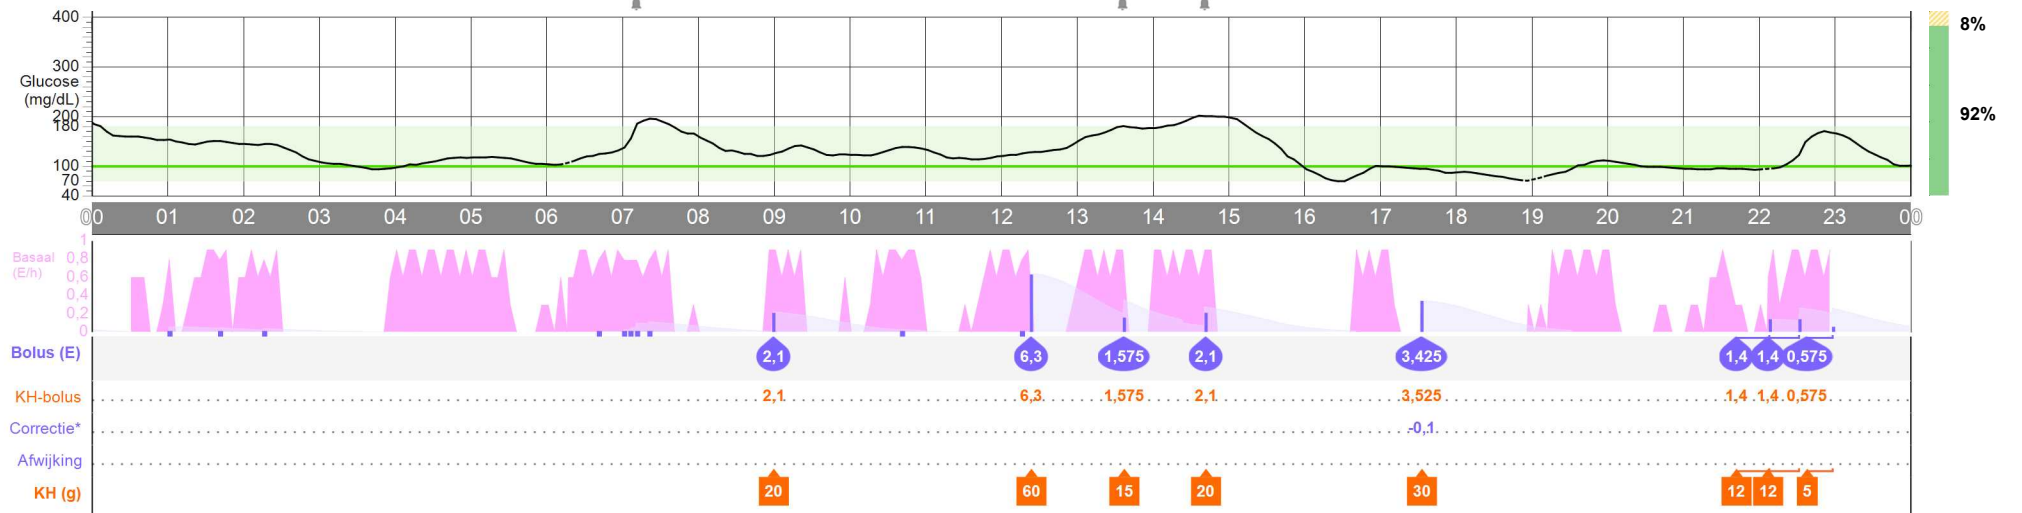

*Actieve insuline meegewogen. SmartGuard weegt SmartGuard-boluscorrectie ook mee.