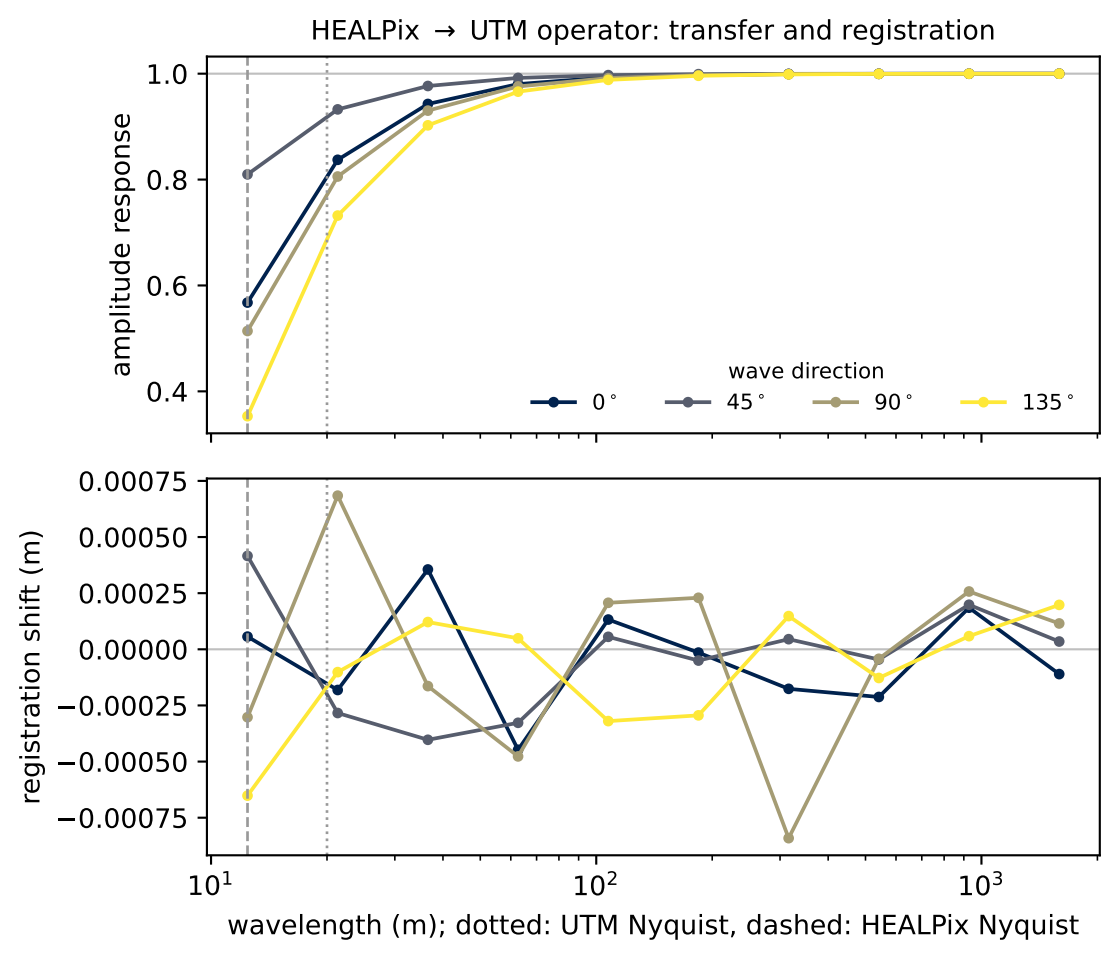
HEALPix → UTM operator: transfer and registration
amplitude response
1.0
0.8
0.6
0.4
wave direction
0°
45°
90°
135°
registration shift (m)
0.00075
0.00050
0.00025
0.00000
−0.00025
−0.00050
−0.00075
10^1
10^2
10^3
wavelength (m); dotted: UTM Nyquist, dashed: HEALPix Nyquist