X Device PRO – Línea de dispositivos

Traducción al español


Cada página muestra la diapositiva original como referencia visual, seguida de su traducción completa.



X Device PRO

WireFree. Still for professionals™ – Sin cables. Igual de profesional.


2026.08.20 · Departamento de Negocios Internacionales (해외사업부)

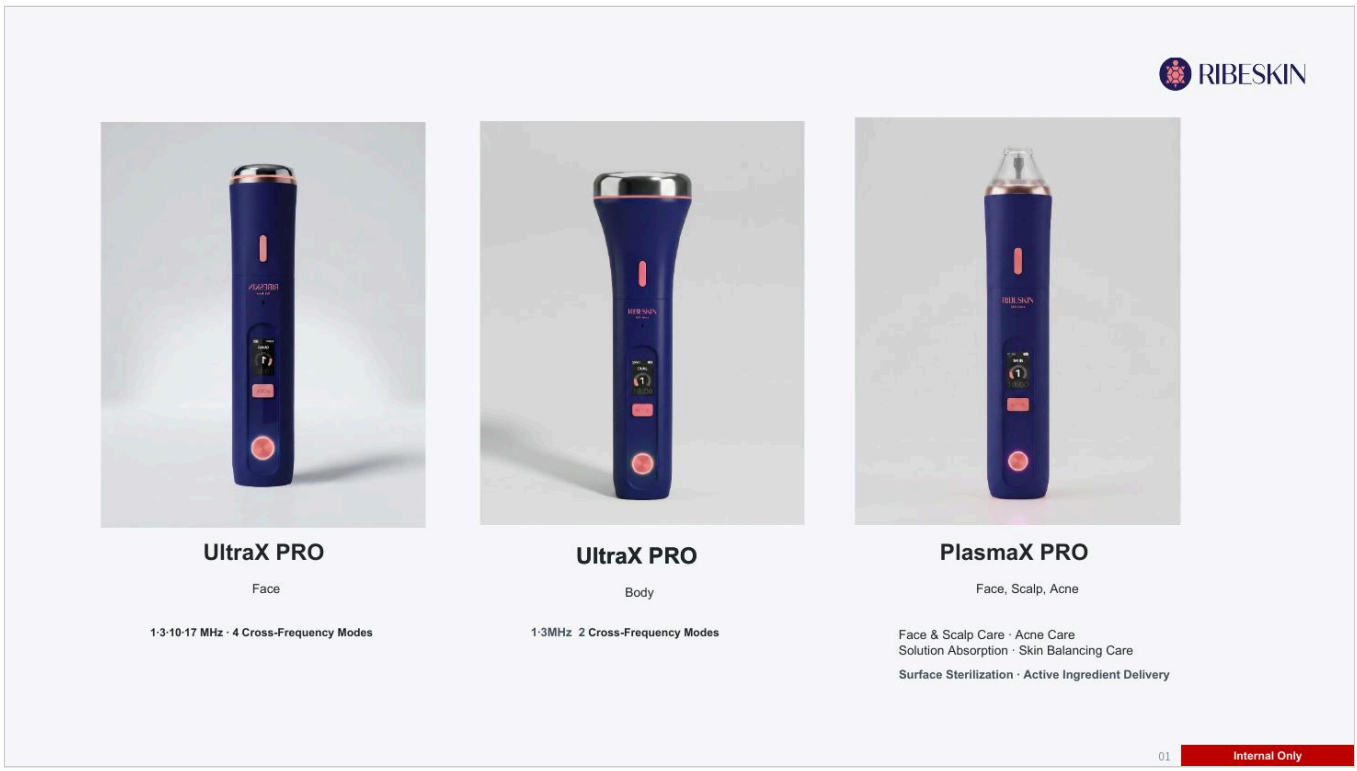

Línea de dispositivos RIBESKIN

UltraX PRO – Rostro	UltraX PRO – Cuerpo	PlasmaX PRO – Rostro, cuero cabelludo, acné
1·3·10·17 MHz · 4 modos de frecuencia cruzada	1·3 MHz · 2 modos de frecuencia cruzada	Cuidado del rostro y del cuero cabelludo · cuidado del acné · absorción de soluciones · cuidado del equilibrio de la piel · **esterilización superficial · administración de ingredientes activos**

Solo para uso interno

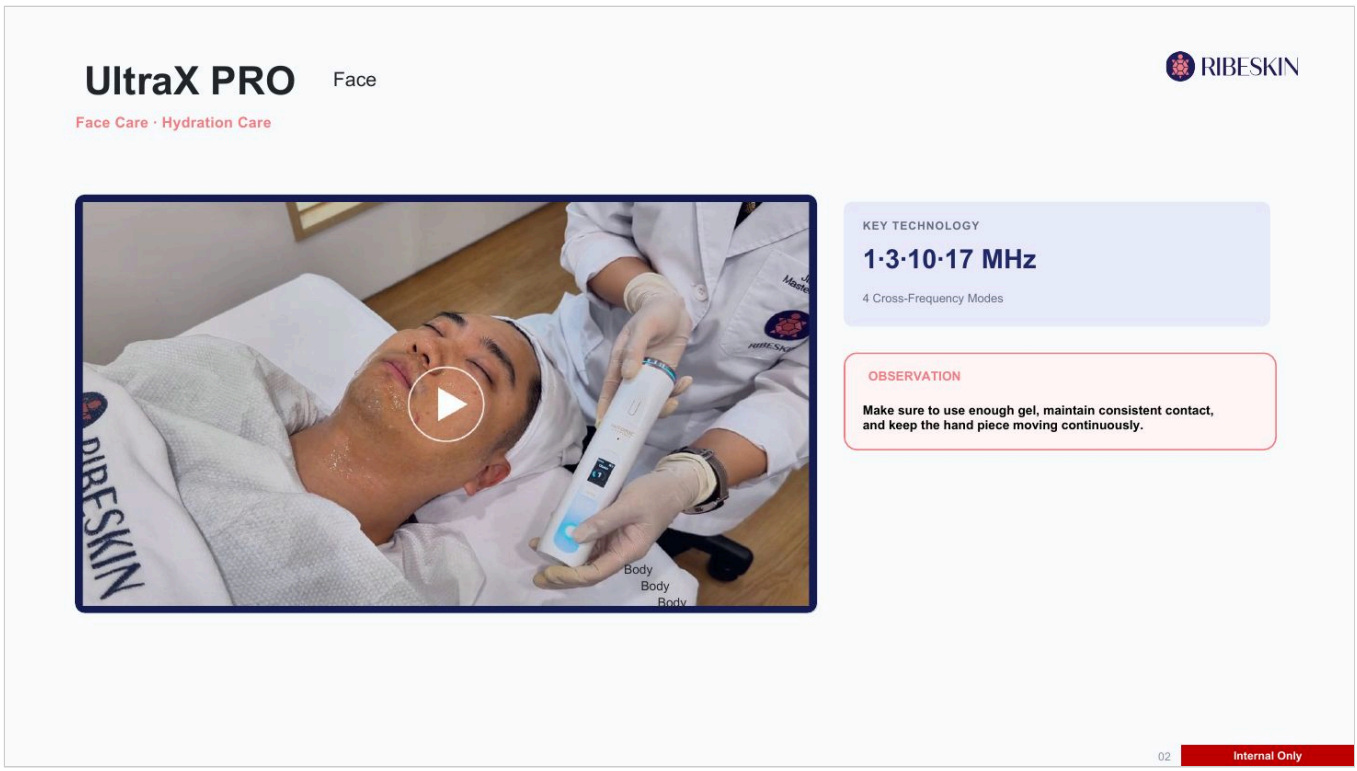


UltraX PRO – Rostro

Cuidado facial · cuidado de la hidratación

TECNOLOGÍA CLAVE: 1·3·10·17 MHz – 4 modos de frecuencia cruzada

OBSERVACIÓN: asegúrese de usar suficiente gel, mantener un contacto constante y mover la pieza de mano de forma continua.

Solo para uso interno

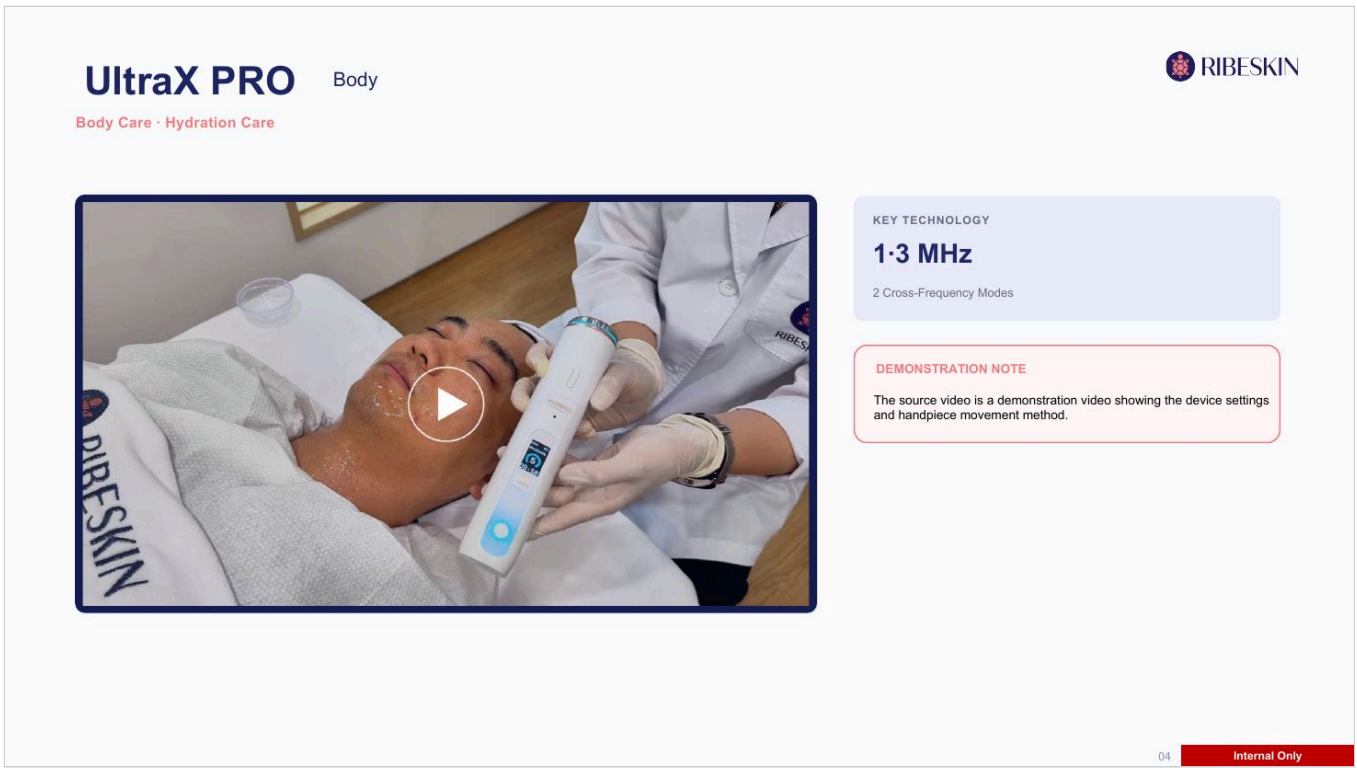

UltraX PRO – Cuerpo

Cuidado corporal · cuidado de la hidratación

TECNOLOGÍA CLAVE: 1·3 MHz – 2 modos de frecuencia cruzada

NOTA DE DEMOSTRACIÓN: el video de origen es un video de demostración que muestra la configuración del dispositivo y el método de movimiento de la pieza de mano.

Solo para uso interno




Inalámbrico (WireFREE) vs. con cable

Prueba de cavitación a 3 MHz · comparación

Qué muestra esta prueba - Compara la respuesta visible en la superficie del cabezal en la condición de 3 MHz. - Permite comprobar visualmente el estado de funcionamiento en las mismas condiciones de observación. - Sirve de apoyo para la capacitación interna y las explicaciones del producto.


Solo para uso interno

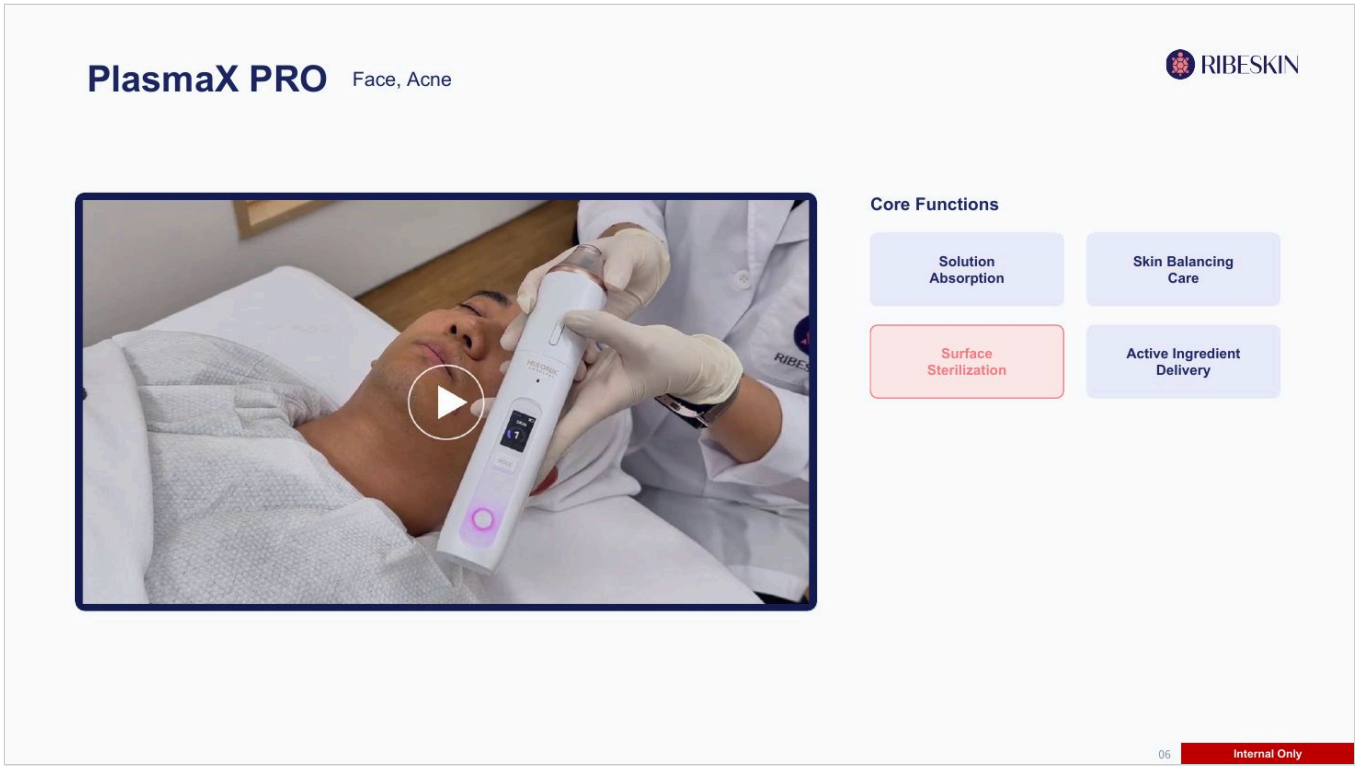

PlasmaX PRO – Rostro, acné

Funciones principales - Absorción de soluciones - Cuidado del equilibrio de la piel - Esterilización superficial - Administración de ingredientes activos

Solo para uso interno

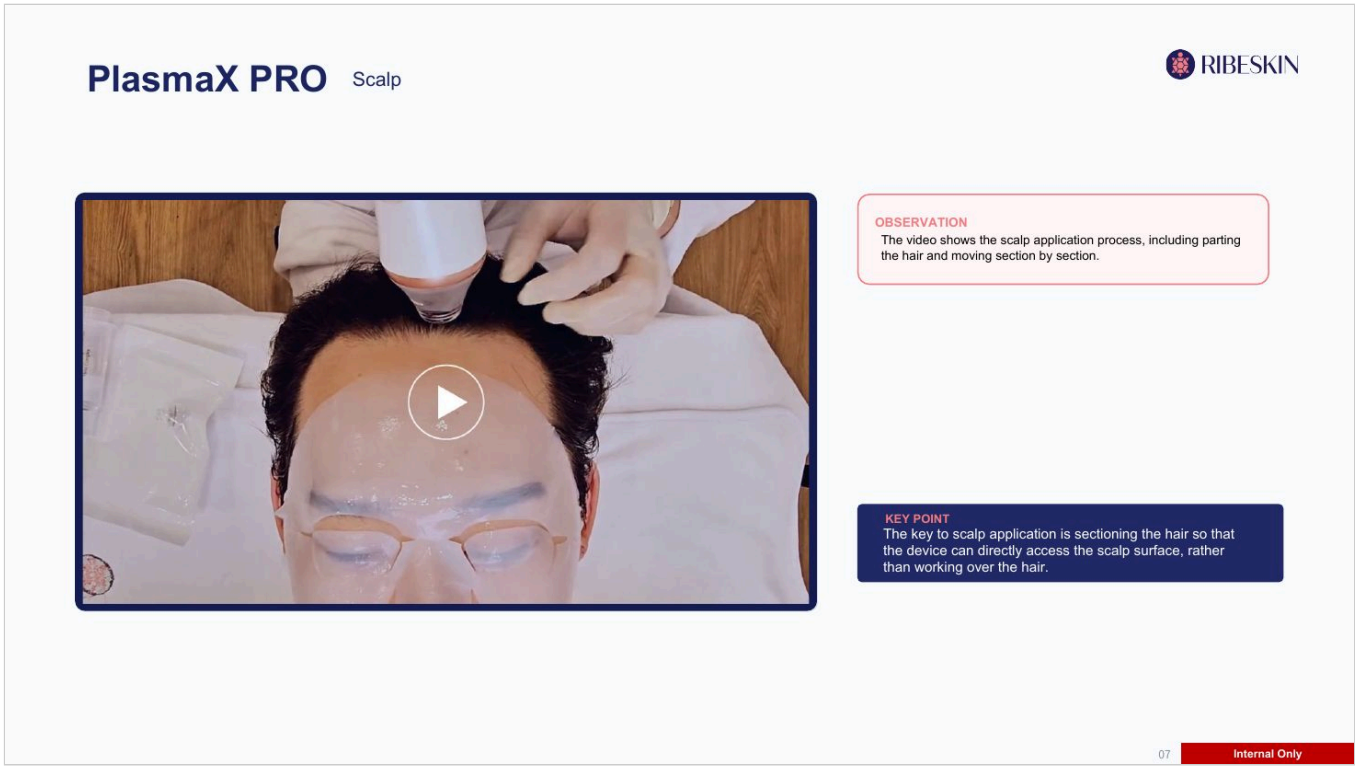

PlasmaX PRO – Cuero cabelludo

OBSERVACIÓN: el video muestra el proceso de aplicación en el cuero cabelludo, incluyendo cómo separar el cabello y avanzar sección por sección.

PUNTO CLAVE: la clave de la aplicación en el cuero cabelludo es dividir el cabello en secciones para que el dispositivo tenga acceso directo a la superficie del cuero cabelludo, en lugar de trabajar sobre el cabello.

Solo para uso interno

BEAUTY DEVICE MODES AND APPLICATION

Area	Mode	Skin Action Area	How to Use
Plasma	Skin Mode	Sterilization	Apply to bare face after cleansing
		Absorption	Absorption after applying Deepshoot or Betterfill solution
	Scalp Mode	Sterilization	First application immediately before treatment
		Absorption	Applied after Hairlopecia shooter or vial
FACE SONO	MASSAGE (3MHz)	Approx. 1-2 cm, relatively shallow tissue	After cleansing, apply moisture gel, then apply starting from the terminus to the whole face
	MOIST (10MHz)	Skin surface layer	After treatment, apply facial moisture gel After applicator treatment, apply after mask solution application
	DUAL (3,10MHz)	Middle layer + surface layer	After treatment, apply facial moisture gel After applicator treatment, apply after mask solution application
	QUAD (1,3,10,17MHz)	Deep layer → very surface layer	Can be applied before & after treatment
BODY SONO	RELAX (1MHz)	Approx. 3-5 cm deep	Circulation massage on body concern area after cleansing
	DRAINAGE	Approx. 1-2 layers	Lymphatic drainage
	DUAL	Deep layer + middle layer	Can be applied before & after treatment

Modos y aplicación de los dispositivos de belleza

Área	Modo	Zona de acción en la piel	Modo de uso
Plasma	Modo piel	Esterilización	Aplicar sobre el rostro limpio, después de la limpieza
	Modo piel	Absorción	Absorción después de aplicar la solución Deepshoot o Betterfill
	Modo cuero cabelludo	Esterilización	Primera aplicación, inmediatamente antes del tratamiento
	Modo cuero cabelludo	Absorción	Se aplica después del shooter o vial Hairlopecia
FACE SONO (rostro)	MASSAGE (3 MHz)	Aprox. 1–2 cm, tejido relativamente superficial	Después de la limpieza, aplicar gel hidratante y luego aplicar comenzando desde el extremo hacia todo el rostro
	MOIST (10 MHz)	Capa superficial de la piel	Después del tratamiento, aplicar gel hidratante facial. Después del tratamiento con aplicador, aplicar tras colocar la solución de mascarilla
	DUAL (3, 10 MHz)	Capa media + capa superficial	Después del tratamiento, aplicar gel hidratante facial. Después del tratamiento con aplicador, aplicar tras colocar la solución de mascarilla
	QUAD (1, 3, 10, 17 MHz)	Capa profunda → capa muy superficial	Puede aplicarse antes y después del tratamiento
BODY SONO (cuerpo)	RELAX (1 MHz)	Aprox. 3–5 cm de profundidad	Masaje circulatorio en la zona corporal a tratar, después de la limpieza
	DRAINAGE (drenaje)	Aprox. 1–2 capas	Drenaje linfático
	DUAL	Capa profunda + capa media	Puede aplicarse antes y después del tratamiento

PLASMA FOR SKIN : RECOMMENDED PROTOCOL

Device	Efficacy	Indication	Recommended Level (Lv1~3)	Recommended Ribeskin Treatment	Treatment Steps						
					Step 1: Cleansing	Main Treatment (Device + Ribeskin Treatment)			Step 5: Mask	Step 6: Regenerating Cream	Step 7: Sunscreen
						Step 2	Step 3	Step 4			
Plasma Skin	Skin surface sterilization (balance care) Active ingredient delivery (solution absorption)	Radiance & Hydration	Skin type Intensity control (Lv1~2 recommended)	CO2 + Deepshoot HA	AHA Cleansing	Plasma 1st Sterilization	CO2	Deepshoot HA (applicator) + Plasma 2nd Absorption	Deepshoot Mask	EP + After Gel & Cream	Self Protection
		Elasticity & Regeneration		CO2 + Deepshoot AA / Betterfill 56+		Plasma 1st Sterilization		Deepshoot AA (applicator) + Plasma 2nd Absorption	Deepshoot Mask	EP + After Gel & Cream	Self Protection
		Brightening		CO2 + Deepshoot LUMI		Plasma 1st Sterilization	CO2	Deepshoot LUMI (applicator) + Plasma 2nd Absorption	Deepshoot Mask	EP + After Gel & Cream	Self Protection
		Elasticity & Wrinkles		CO2 + Betterfill Collagen		Plasma 1st Sterilization		Betterfill Collagen (Turtle Pin) Plasma 2nd Absorption	Deepshoot Mask	Epiderm Gel & Cream	Self Protection
		Regeneration & Trouble		CO2 + Betterfill Exo		Plasma 1st Sterilization		Betterfill Exo (Turtle Pin) Plasma 2nd Absorption	Deepshoot Mask	Epiderm Gel & Cream	Self Protection
		Brightening & Elasticity		CO2 + Gpeel Dual		Plasma 1st Sterilization	CO2	Bubble Toner - Gpeel Dual	Gpeel Mask	Actoin Cream	Barrier Protection
		Pores & Trouble		CO2 + Exosome		Plasma 1st Sterilization	CO2	Deepshoot HA (applicator) + Plasma 2nd Absorption	Deepshoot Mask	EP + After Gel & Cream	Self Protection


Plasma para la piel: protocolo recomendado

- **Dispositivo:** Plasma Skin
- **Eficacia:** esterilización de la superficie de la piel (cuidado del equilibrio); administración de ingredientes activos (absorción de soluciones)
- **Nivel recomendado (Lv1–3):** control de intensidad según el tipo de piel (se recomienda Lv1–2)
- **Paso 1 – Limpieza:** limpieza con AHA (en todos los casos)
- **Pasos 2–4:** tratamiento principal (dispositivo + tratamiento Ribeskin)

Indicación	Tratamiento Ribeskin recomendado	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5: Mascarilla	Paso 6: Crema regeneradora	Paso 7: Protector solar
Luminosidad e hidratación	CO2 + Deepshoot HA	Plasma: 1.ª esterilización	CO2	Deepshoot HA (aplicador) + Plasma: 2.ª absorción	Mascarilla Deepshoot	EP + After Gel y crema	Self Protection
Elasticidad y regeneración	CO2 + Deepshoot AA / Betterfill 56+	Plasma: 1.ª esterilización		Deepshoot AA (aplicador) + Plasma: 2.ª absorción	Mascarilla Deepshoot	EP + After Gel y crema	Self Protection
Aclarado	CO2 + Deepshoot LUMI	Plasma: 1.ª esterilización	CO2	Deepshoot LUMI (aplicador) + Plasma: 2.ª absorción	Mascarilla Deepshoot	EP + After Gel y crema	Self Protection
Elasticidad y arrugas	CO2 + Betterfill Collagen	Plasma: 1.ª esterilización		Betterfill Collagen (Turtle Pin) + Plasma: 2.ª absorción	Mascarilla Deepshoot	Epiderm Gel y crema	Self Protection

Indicación	Tratamiento Ribeskin recomendado	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5: Mascarilla	Paso 6: Crema regeneradora	Paso 7: Protector solar
Regeneración y brotes	CO2 + Betterfill Exo	Plasma: 1.ª esterilización		Betterfill Exo (Turtle Pin) + Plasma: 2.ª absorción	Mascarilla Deepshoot	Epiderm Gel y crema	Self Protection
Aclarado y elasticidad	CO2 + Gpeel Dual	Plasma: 1.ª esterilización	CO2	Bubble Toner – Gpeel Dual	Mascarilla Gpeel	Crema Actoin	Barrier Protection
Poros y brotes	CO2 + Exosoma	Plasma: 1.ª esterilización	CO2	Deepshoot HA (aplicador) + Plasma: 2.ª absorción	Mascarilla Deepshoot	EP + After Gel y crema	Self Protection

(Los nombres de productos —Deepshoot, Betterfill, Gpeel, Self Protection, Barrier Protection, etc.— se mantienen como marcas.)

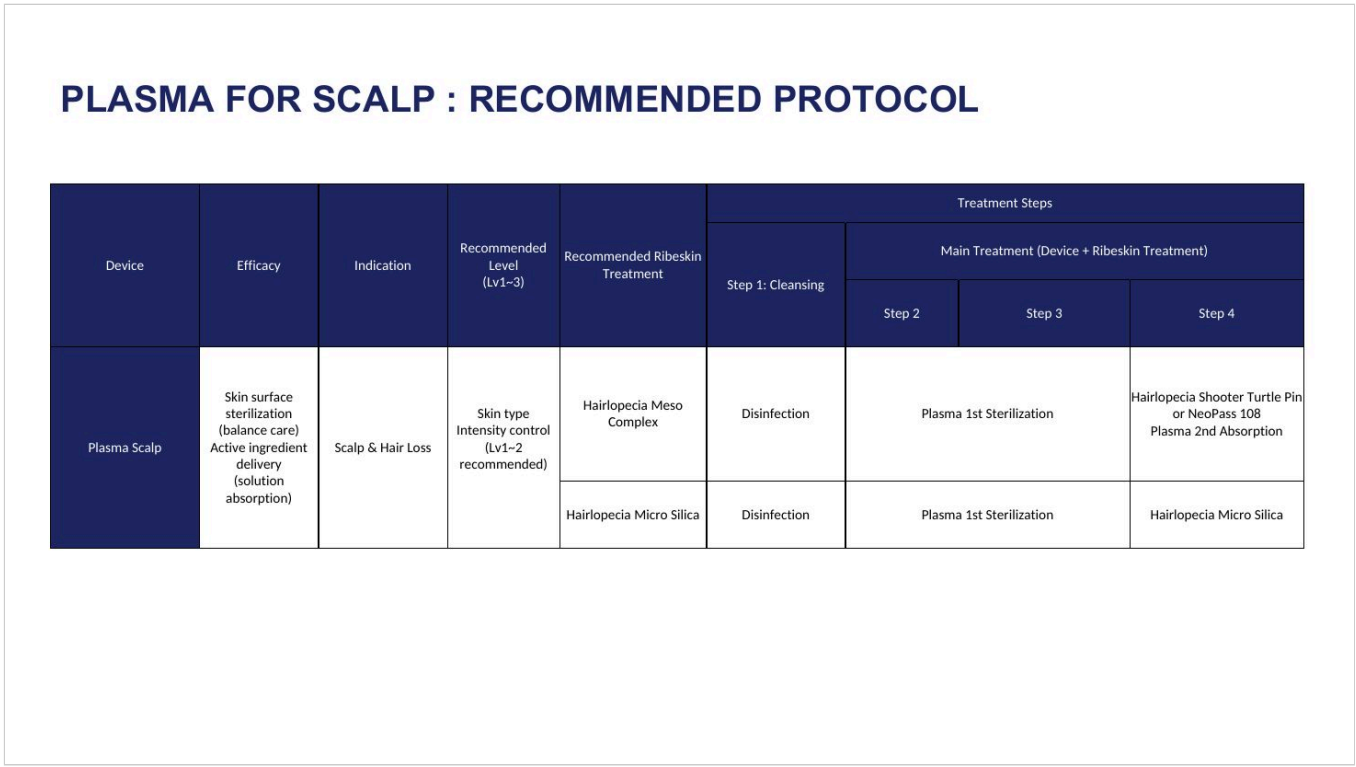


PLASMA FOR SCALP : RECOMMENDED PROTOCOL

Device	Efficacy	Indication	Recommended Level (Lv1~3)	Recommended Ribeskin Treatment	Treatment Steps			
					Step 1: Cleansing	Main Treatment (Device + Ribeskin Treatment)		
						Step 2	Step 3	Step 4
Plasma Scalp	Skin surface sterilization (balance care) Active ingredient delivery (solution absorption)	Scalp & Hair Loss	Skin type Intensity control (Lv1~2 recommended)	Hairlopecia Meso Complex	Disinfection	Plasma 1st Sterilization		Hairlopecia Shooter Turtle Pin or NeoPass 108 Plasma 2nd Absorption
				Hairlopecia Micro Silica	Disinfection	Plasma 1st Sterilization		Hairlopecia Micro Silica

Plasma para el cuero cabelludo: protocolo recomendado

- **Dispositivo:** Plasma Scalp
- **Eficacia:** esterilización de la superficie de la piel (cuidado del equilibrio); administración de ingredientes activos (absorción de soluciones)
- **Indicación:** cuero cabelludo y caída del cabello
- **Nivel recomendado (Lv1–3):** control de intensidad según el tipo de piel (se recomienda Lv1–2)

Tratamiento Ribeskin recomendado	Paso 1: Limpieza	Pasos 2–3	Paso 4
Hairlopecia Meso Complex	Desinfección	Plasma: 1.ª esterilización	Hairlopecia Shooter con Turtle Pin o NeoPass 108 + Plasma: 2.ª absorción
Hairlopecia Micro Silica	Desinfección	Plasma: 1.ª esterilización	Hairlopecia Micro Silica

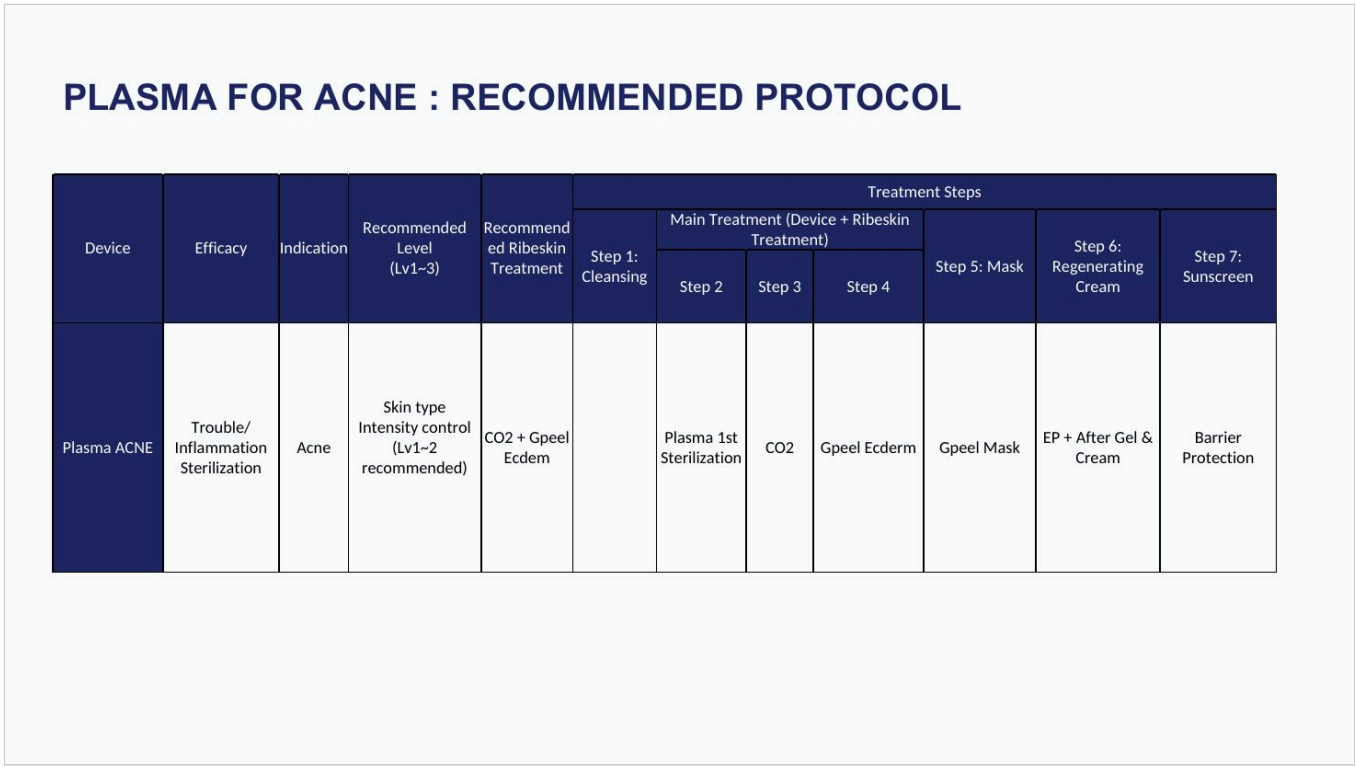

PLASMA FOR ACNE : RECOMMENDED PROTOCOL

Device	Efficacy	Indication	Recommended Level (Lv1~3)	Recommended Ribeskin Treatment	Treatment Steps						
					Step 1: Cleansing	Main Treatment (Device + Ribeskin Treatment)			Step 5: Mask	Step 6: Regenerating Cream	Step 7: Sunscreen
						Step 2	Step 3	Step 4			
Plasma ACNE	Trouble/ Inflammation Sterilization	Acne	Skin type Intensity control (Lv1~2 recommended)	CO2 + Gpeel Ecdem		Plasma 1st Sterilization	CO2	Gpeel Ecderm	Gpeel Mask	EP + After Gel & Cream	Barrier Protection

Plasma para el acné: protocolo recomendado

Campo	Detalle
Dispositivo	Plasma ACNE
Eficacia	Esterilización de brotes/inflamación
Indicación	Acné
Nivel recomendado (Lv1–3)	Control de intensidad según el tipo de piel (se recomienda Lv1–2)
Tratamiento Ribeskin recomendado	CO2 + Gpeel Ecdem
Paso 1: Limpieza	(sin indicar)
Paso 2	Plasma: 1.ª esterilización
Paso 3	CO2
Paso 4	Gpeel Ecderm
Paso 5: Mascarilla	Mascarilla Gpeel
Paso 6: Crema regeneradora	EP + After Gel y crema
Paso 7: Protector solar	Barrier Protection

SONO FOR FACE AND BODY : RECOMMENDED PROTOCOL

Device	Efficacy	Indication	Recommended Level (Lv1~3)	Recommended Ribeskin Treatment	Treatment Steps						
					Step 1: Cleansing	Main Treatment (Device + Ribeskin Treatment)			Step 5: Mask	Step 6: Regenerating Cream	Step 7: Sunscreen
						Step 2	Step 3	Step 4			
FACE SONO Face	Massage (3MHz) / MOIST (10MHz) / Dual (3,10MHz) / QUAD (1,3,10,17MHz)	Facial Swelling & Circulation	3MHz	CO2 - Circulation	AHA Cleansing	Ultrasound Massage (3MHz)	CO2	Along lymph node direction: neck-jaw-cheekbone-forehead-cheek-jaw-neck	Soothing Gel + Mask	Cover Cream	Self Protection
		Erythema Relief	Selectable Lv.3~5	Applicator Treatment - Erythema Improvement	AHA Cleansing	Applied After Ultrasound Gel Application		Applicator (Turtle Pin)	NRX Mask	Ectoin Cream	Self Protection
		Pain Relief		Gpeel Treatment - Pain Relief	AHA Cleansing	Applied After Ultrasound Gel Application		Bubble Toner - Gpeel Dual & Ecdem	Gpeel Mask	Ectoin Cream	Barrier Protection
BODY SONO Body	Relax (1MHz) / Drainage (3MHz) / Dual (1,3MHz)	Swelling & Slimming	R -> D	CO2 Body - Abdomen & Arms & Legs	AHA Cleansing	Ultrasound Relax (1MHz)	CO2	Ultrasound Drainage (3MHz)	Soothing Gel & Body Mask	Cover Cream	

SONO para rostro y cuerpo: protocolo recomendado

FACE SONO (rostro) – Eficacia: Massage (3 MHz) / MOIST (10 MHz) / Dual (3, 10 MHz) / QUAD (1, 3, 10, 17 MHz)

Indicación	Nivel	Tratamiento Ribeskin	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5: Mascarilla	Paso 6: Crema	Paso 7: Protector
Hinchazón facial y circulación	3 MHz	CO2 – Circulación	Limpieza AHA	Masaje ultrasónico (3 MHz)	CO2	Siguiendo la dirección de los ganglios linfáticos: cuello – mandíbula – pómulo – frente – mejilla – mandíbula – cuello	Gel calmante + mascarilla	Cover Cream	Self Protection
Alivio del eritema	Seleccionable Lv.3–5	Tratamiento con aplicador – mejora del eritema	Limpieza AHA	Se aplica después de colocar el gel para ultrasonido (pasos 2–3)		Aplicador (Turtle Pin)	Mascarilla NRX	Crema Ectoin	Self Protection
Alivio del dolor	Seleccionable Lv.3–5	Tratamiento Gpeel – alivio del dolor	Limpieza AHA	Se aplica después de colocar el gel para ultrasonido		Bubble Toner – Gpeel Dual y Ecdem	Mascarilla Gpeel	Crema Ectoin	Barrier Protection

Indicación	Nivel	Tratamiento Ribeskin	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5: Mascarilla	Paso 6: Crema	Paso 7: Protector
				(pasos 2–3)					

BODY SONO (cuerpo) – Eficacia: Relax (1 MHz) / Drainage (3 MHz) / Dual (1, 3 MHz)

Indicación	Nivel	Tratamiento Ribeskin	Paso 1	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5: Mascarilla	Paso 6: Crema	Paso 7
Hinchazón y reducción de medidas	R → D (Relax → Drainage)	CO2 corporal – abdomen, brazos y piernas	Limpieza AHA	Ultrasonido Relax (1 MHz)	CO2	Ultrasonido Drainage (3 MHz)	Gel calmante y mascarilla corporal	Cover Cream	–

PLASMA SKIN+SONO+RIBESKIN : RECOMMENDED PROTOCOL


Device	Efficacy	Indication	Recommended Level (Lv1~3)	Recommended Ribeskin Treatment	Treatment Steps						
					Step 1: Cleansing	Main Treatment (Device + Ribeskin Treatment)			Step 5: Mask	Step 6: Regenerating Cream	Step 7: Sunscreen
						Step 2	Step 3	Step 4			
Plasma Skin + Ultrasound	Plasma Sterilization Ultrasound Circulation + Soothing	CO2			AHA Cleansing	Plasma Sterilization	Ultrasound Massage (3MHz)	CO2 + Ultrasound (Moist or Dual)	CO2 Soothing Gel	Cover Cream	Self Protection
		CO2 + Deepshoot (AA, HA, LUMI)			AHA Cleansing	Plasma Sterilization	Ultrasound Massage (3MHz)	CO2 + Deepshoot (applicator) + Plasma Absorption Ultrasound (Moist or Dual)	Deepshoot Mask	Ectoin Cream Soothing Gel + SOS Cover Cream	Self Protection Barrier Protection
		CO2 + Betterfill (56+, Exo, Collagen)			AHA Cleansing	Plasma Sterilization	Ultrasound Massage (3MHz)	CO2 + Deepshoot (applicator) + Plasma Absorption Ultrasound (Moist or Dual)	Deepshoot Mask	Ectoin Cream Soothing Gel + SOS Cover Cream	Self Protection Barrier Protection
		Gpeel Dual			AHA Cleansing	Plasma 1st Sterilization	QUAD (1,3,10,17MHz)	Gpeel Dual	Gpeel Mask	Ectoin Cream	Self Protection
		Gpeel Ecdem			AHA Cleansing	Plasma Sterilization	Dual (3,10MHz)	Gpeel Ecdem	Gpeel Mask	SOS Cover Cream	Barrier Protection
		CO2 + Gpeel Dual			AHA Cleansing	Plasma Sterilization	Ultrasound Massage (3MHz)	CO2 + Gpeel Dual	Gpeel Mask	Ectoin Cream	Self Protection
		CO2 + Gpeel Ecdem			AHA Cleansing	Plasma Sterilization	Ultrasound Massage (3MHz)	CO2 + Gpeel Ecdem	Gpeel Mask	SOS Cover Cream	Barrier Protection

Plasma Skin + SONO + Ribeskin: protocolo recomendado

- **Dispositivo:** Plasma Skin + ultrasonido
- **Eficacia:** esterilización con plasma; circulación con ultrasonido + efecto calmante

Indicación / tratamiento Ribeskin	Paso 1: Limpieza	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5: Mascarilla	Paso 6: Crema regeneradora	Paso 7: Protector solar
CO2	Limpieza AHA	Esterilización con plasma	Masaje ultrasónico (3 MHz)	CO2 + ultrasonido (Moist o Dual)	Gel calmante CO2	Cover Cream	Self Protection
CO2 + Deepshoot (AA, HA, LUMI)	Limpieza AHA	Esterilización con plasma	Masaje ultrasónico (3 MHz)	CO2 + Deepshoot (aplicador) + absorción con plasma + ultrasonido (Moist o Dual)	Mascarilla Deepshoot	Crema Ectoin / Gel calmante + SOS Cover Cream	Self Protection / Barrier Protection
CO2 + Betterfill (56+, Exo, Collagen)	Limpieza AHA	Esterilización con plasma	Masaje ultrasónico (3 MHz)	CO2 + Deepshoot (aplicador) + absorción con plasma + ultrasonido (Moist o Dual)	Mascarilla Deepshoot	Crema Ectoin / Gel calmante + SOS Cover Cream	Self Protection / Barrier Protection
Gpeel Dual	Limpieza AHA	Plasma: 1.ª esterilización	QUAD (1, 3, 10, 17 MHz)	Gpeel Dual	Mascarilla Gpeel	Crema Ectoin	Self Protection
Gpeel Ecdem	Limpieza AHA	Esterilización con plasma	Dual (3, 10 MHz)	Gpeel Ecdem	Mascarilla Gpeel	SOS Cover Cream	Barrier Protection


Indicación / tratamiento Ribeskin	Paso 1: Limpieza	Paso 2	Paso 3	Paso 4	Paso 5: Mascarilla	Paso 6: Crema regeneradora	Paso 7: Protector solar
CO2 + Gpeel Dual	Limpieza AHA	Esterilización con plasma	Masaje ultrasónico (3 MHz)	CO2 + Gpeel Dual	Mascarilla Gpeel	Crema Ectoin	Self Protection
CO2 + Gpeel Ecdem	Limpieza AHA	Esterilización con plasma	Masaje ultrasónico (3 MHz)	CO2 + Gpeel Ecdem	Mascarilla Gpeel	SOS Cover Cream	Barrier Protection

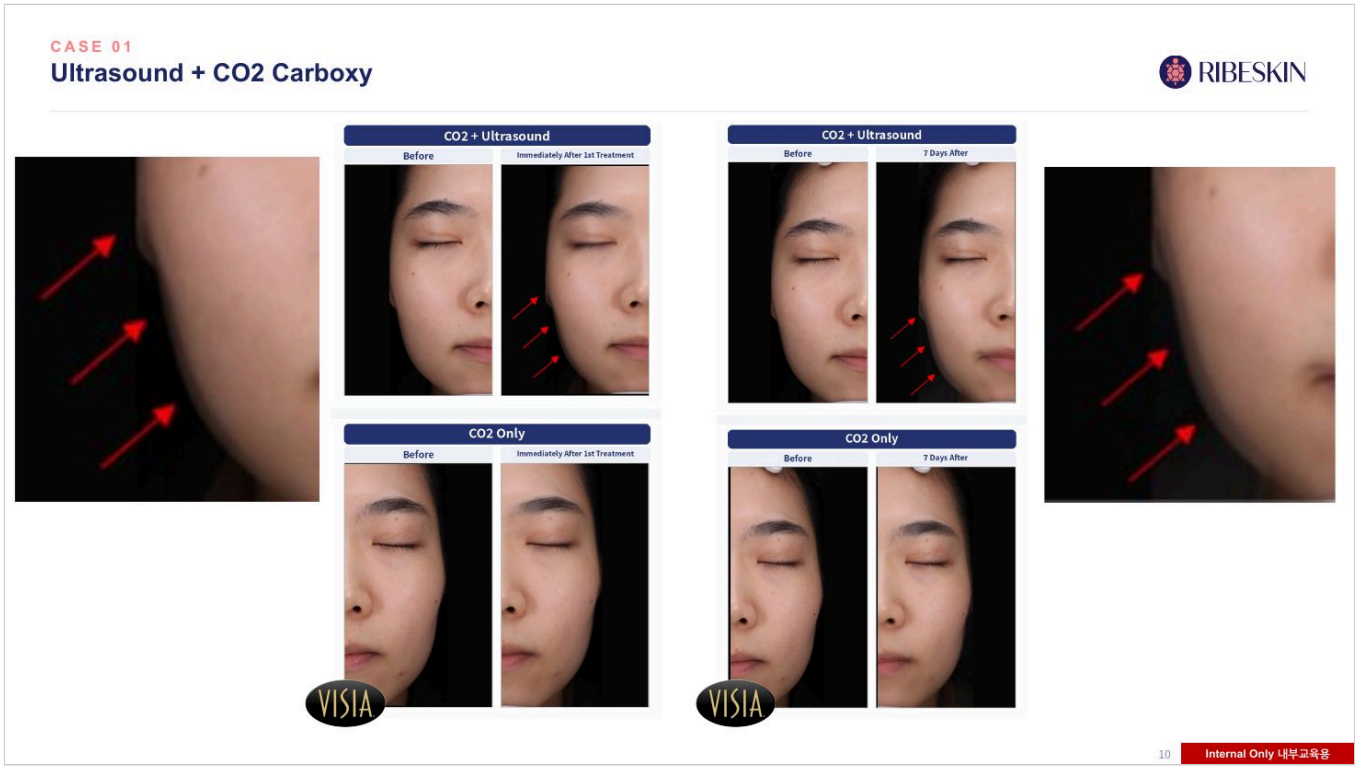

CASO 01 – Ultrasonido + CO2 Carboxi

CO2 + ultrasonido	CO2 solo
Antes → **inmediatamente después del 1.er tratamiento** (las flechas señalan la mejora del contorno mandibular)	Antes → inmediatamente después del 1.er tratamiento
Antes → **7 días después**	Antes → 7 días después

Imágenes tomadas con el sistema VISIA. Solo para uso interno (내부교육용 = para capacitación interna).

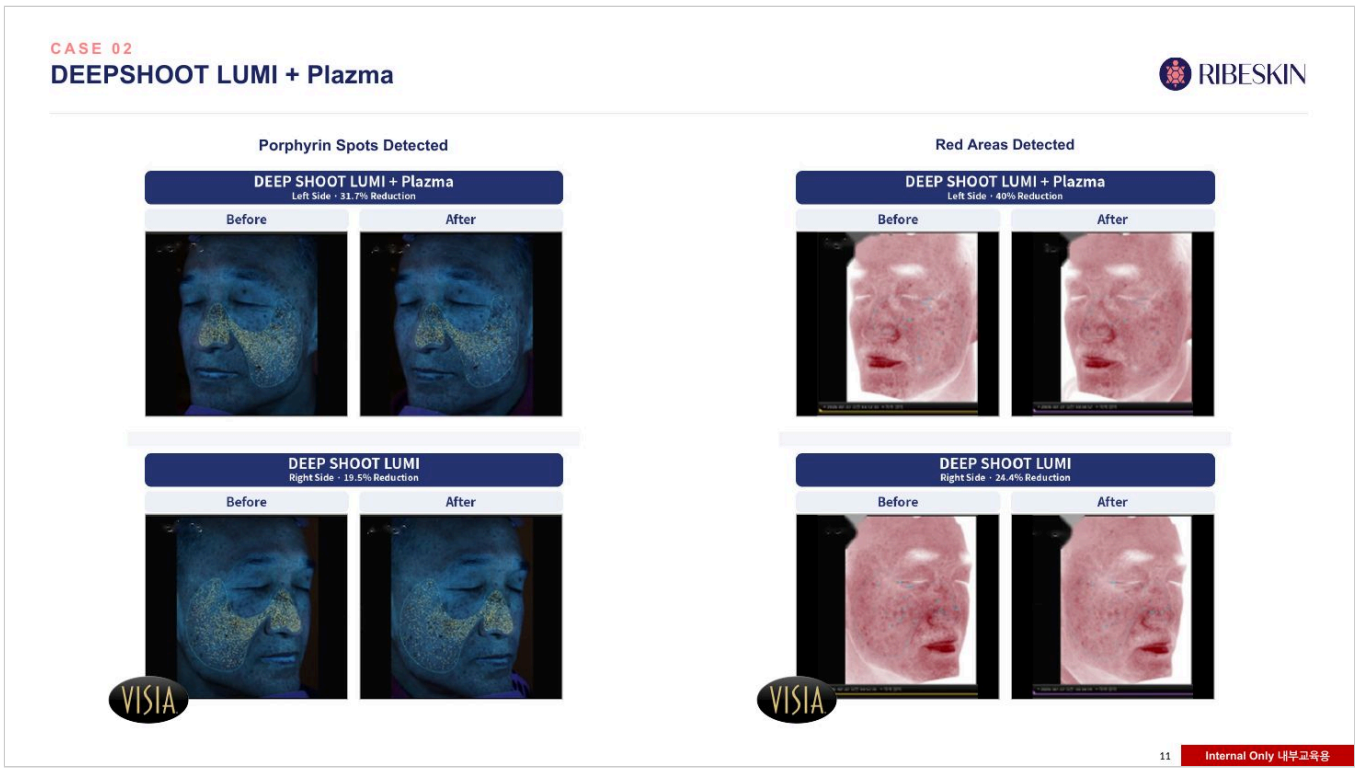


CASO 02 – DEEPSHOOT LUMI + Plasma

Manchas de porfirina detectadas - **DEEP SHOOT LUMI + Plasma** – lado izquierdo: **reducción del 31.7 %** (antes / después) - **DEEP SHOOT LUMI** solo – lado derecho: **reducción del 19.5 %** (antes / después)

Zonas rojas detectadas - **DEEP SHOOT LUMI + Plasma** – lado izquierdo: **reducción del 40 %** (antes / después) - **DEEP SHOOT LUMI** solo – lado derecho: **reducción del 24.4 %** (antes / después)

Imágenes tomadas con el sistema VISIA. Solo para uso interno.

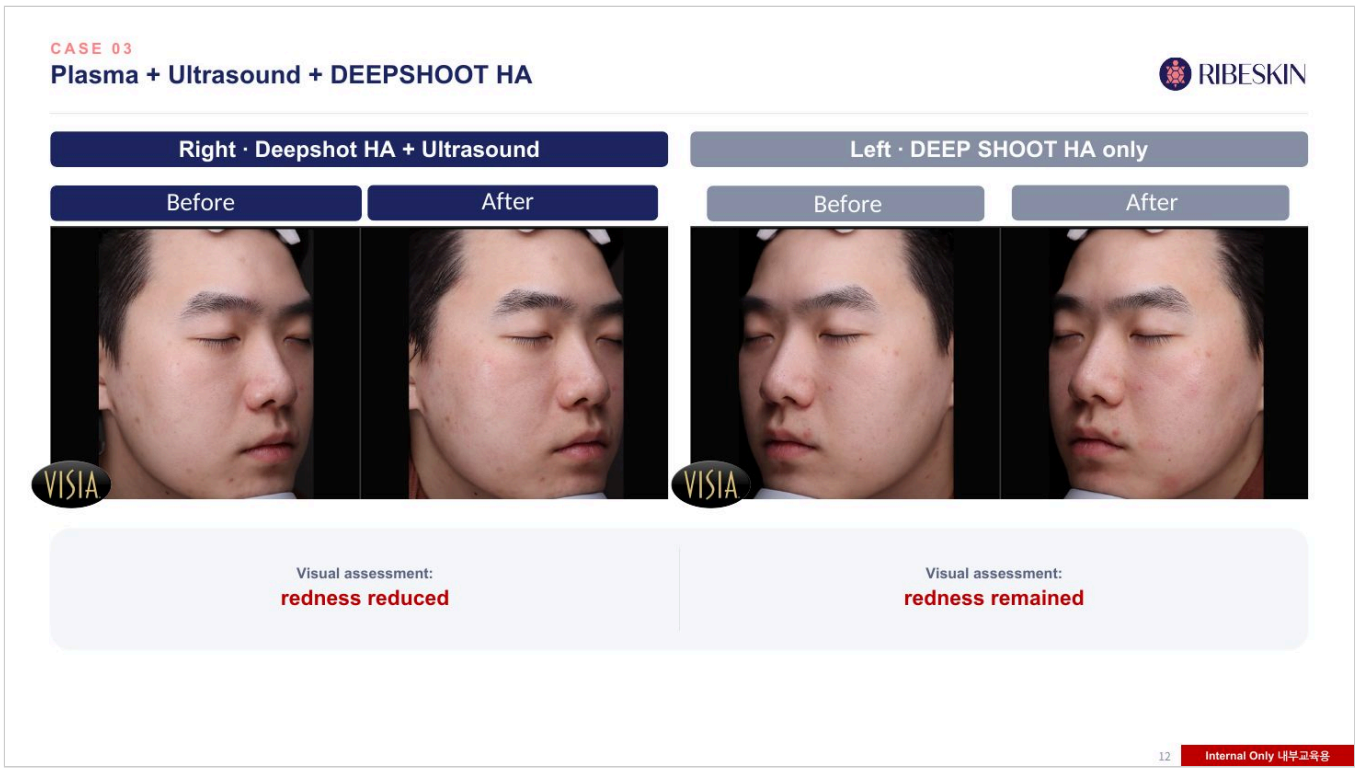

CASO 03 – Plasma + ultrasonido + DEEPSHOOT HA

- **Lado derecho · Deepshoot HA + ultrasonido** (antes / después) – Evaluación visual: **enrojecimiento reducido**.
- **Lado izquierdo · solo DEEP SHOOT HA** (antes / después) – Evaluación visual: **el enrojecimiento persistió**.


Solo para uso interno.



CASO 04 – Ultrasonido (edema y textura de la piel)

- **Lado derecho · reducción del edema en la línea mandibular** (antes / después)
- Mejora de la línea mandibular – **1 sesión**

Solo para uso interno.

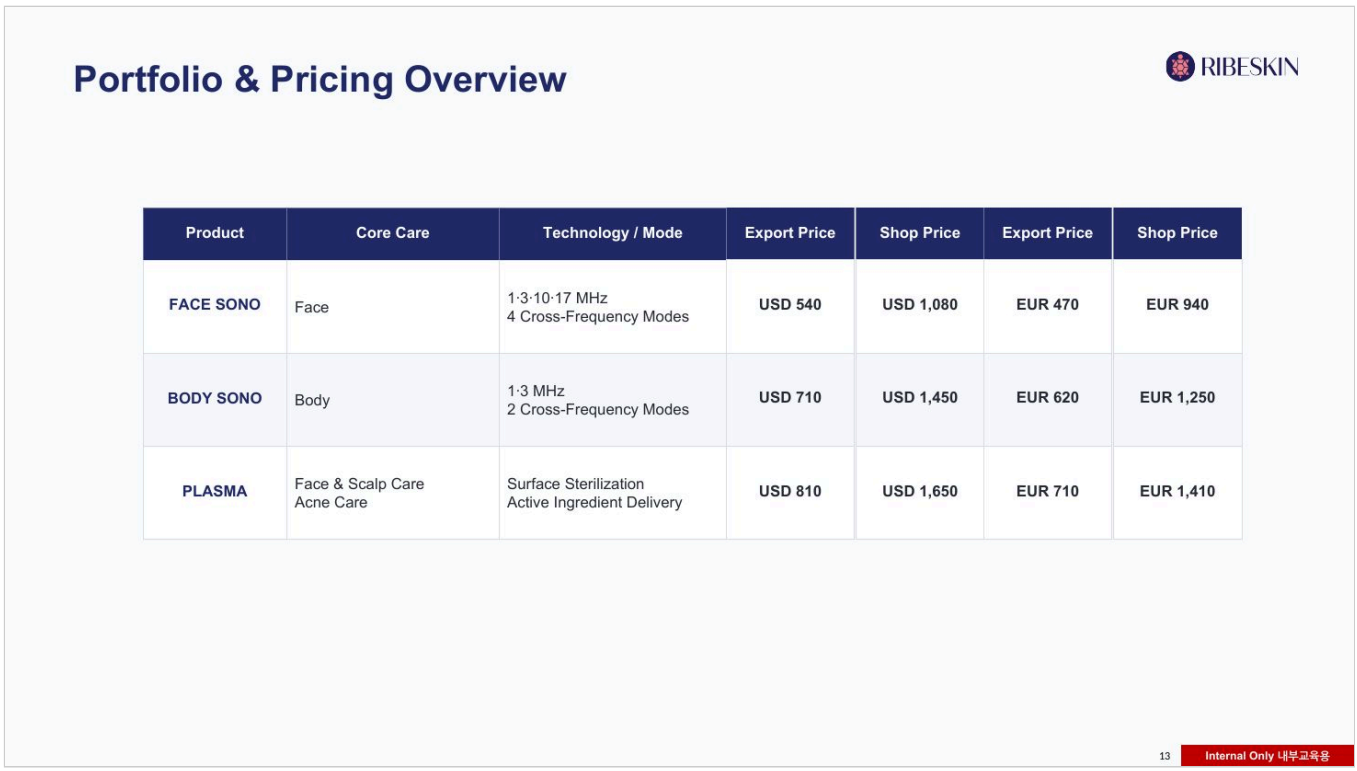

Resumen del portafolio y precios

Producto	Cuidado principal	Tecnología / modo	Precio de exportación (USD)	Precio en tienda (USD)	Precio de exportación (EUR)	Precio en tienda (EUR)
FACE SONO	Rostro	1·3·10·17 MHz, 4 modos de frecuencia cruzada	USD 540	USD 1,080	EUR 470	EUR 940
BODY SONO	Cuerpo	1·3 MHz, 2 modos de frecuencia cruzada	USD 710	USD 1,450	EUR 620	EUR 1,250
PLASMA	Cuidado del rostro y del cuero cabelludo; cuidado del acné	Esterilización superficial; administración de ingredientes activos	USD 810	USD 1,650	EUR 710	EUR 1,410

Solo para uso interno (para capacitación interna).