GETS MEDICAL
Ingeniería en Soluciones Médicas

AUTORIZACIÓN MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS N°: Q-2511

CERTIFICADO DE CONTROL DE CALIDAD

N°: 59-10.2025-GM-XM

OTORGADO A:

SISTEMAS MÉDICOS SIME CUMBAYÁ

Av. Interoceánica, Quito-Cumbayá. Paseo San Francisco; Piso 1.

QUITO-ECUADOR

EQUIPO: MAMÓGRAFO SENOGRAPHE PRISTINA 3D

GETSMEDICAL S.A. presenta el siguiente informe de control de calidad del equipo de radiodiagnóstico médico: **MAMÓGRAFO**, Marca: **General Electric**, Modelo: **SENOGRAPHE PRISTINA 3D**, Serie: **758669BU6** de la sucursal **Cumbayá** de **SISTEMAS MÉDICOS SIME**.

El equipo de mamografía se encuentra dentro del rango permitido de las medidas de KV, mA, TIEMPO DE EXPOSICIÓN Y DENSIDAD DE CONTRASTE.

Se determina que el equipo se encuentra dentro de las condiciones aceptables según el control de calidad del fabricante y esta apto para el radiodiagnóstico médico.

FECHA DE EMISIÓN: 2-OCT-2025
FECHA DE VIGENCIA: 2-OCT-2026
REFERENCIA: INF.TEC-059-10.2025-GM-XM

Ronnie Alexander Ordonez Pesantez
Time Stamping Security Data

Ing. Ronnie Ordóñez
GETSMEDICAL S.A.
SERVICIO TÉCNICO

022 277 419
www.getsmed.com
Edificio Noruega Piso 2 Ofi. 203
Calle Noruega y 6 de Diciembre

INFORME

1. DATOS DE LICENCIA INSTITUCIONAL

LICENCIA INSTITUCIONAL - OPERACIÓN - C	
MEM Nº Q-2511	Fecha de expedición: 05-07-2022 Fecha de expiración: 04-07-2026
INSTITUCIÓN:	**GETS TECNOLOGÍA MÉDICA GETSMEDICAL S.A.**
RUC:	1793144543001
REPRESENTANTE LEGAL:	PESANTEZ JÁCOME LUIS DARIO
PRÁCTICA:	INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
DIRECCIÓN:	AV. 6 DE DICIEMBRE E10-88 Y NORUEGA
PROVINCIA:	PICHINCHA
CIUDAD:	QUITO
TELÉFONO:	(02) 2277419
GETS TECNOLOGÍA MÉDICA GETSMEDICAL S.A., está autorizado para dar servicio en la práctica de Instalación y Mantenimiento	

2. DATOS DEL CLIENTE

SISTEMAS MÉDICOS SIME	
INSTITUCIÓN:	**SISTEMAS MÉDICOS SIME – CUMBAYÁ** **QUITO – ECUADOR**
RUC:	1792110491001
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRÉS LIMAICO SARMIENTO
DIRECCIÓN:	Av. Interoceánica, Quito-Cumbayá. Paseo San Francisco; Piso 1
PROVINCIA:	PICHINCHA
CANTÓN:	QUITO
TELÉFONO:	(02) 501 9400

3. RESULTADOS DE LAS MEDICIONES REALIZADAS

GETSMEDICAL S.A. informa que, al momento de la revisión del presente equipo cumple con:

RADIODIAGNÓSTICO MÉDICO		EQUIPO:	TUBO DE RX:
TOMÓGRAFO	**MARCA:**	GENERAL ELECTRIC	GENERAL ELECTRIC ARTEMIS
	MODELO:	SENOGRAPHE PRISTINA 3D	5505708
	SERIE:	758669BU6	157791TX5

INSPECCIÓN GENERAL			
SUBSISTEMA	FUNCIÓN	APRUEBA	FALLA
Gantry	1. Indicador de presión. 2. Indicador de posición y angulación 3. Luz de colimador. 4. Cableado interno. 5. Panel de interfaz de usuario. 6. Paletas de compresión 7. Inspección visual de cubiertas.	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓	
Consola	1. Monitor. 2. Indicadores luminosos de exposición. 3. Panel de botones exploración. 4. Teclado y mouse.	✓ ✓ ✓ ✓	

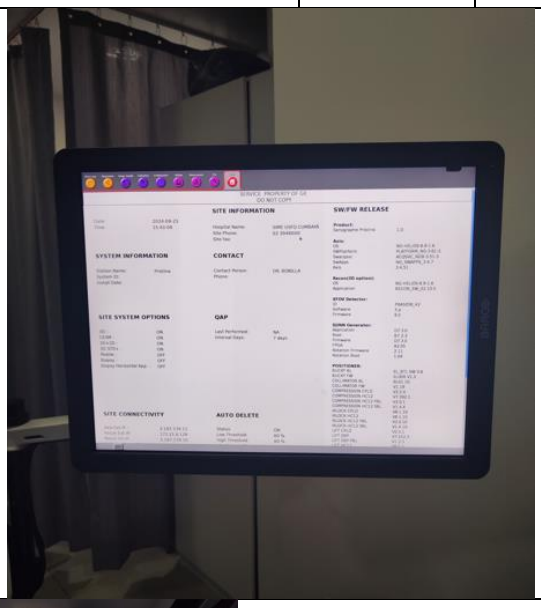

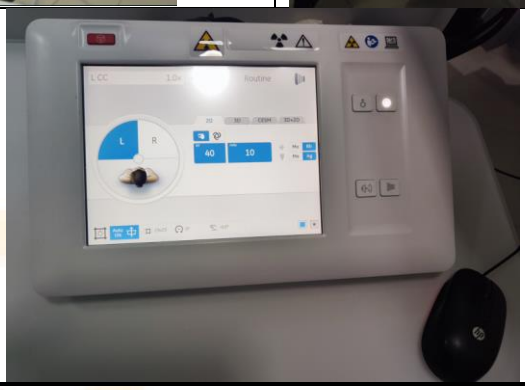

CONTROL DE CALIDAD DE IMAGEN	APRUEBA	FALLA
Control de calcificaciones	✓	
Control de densidades	✓	

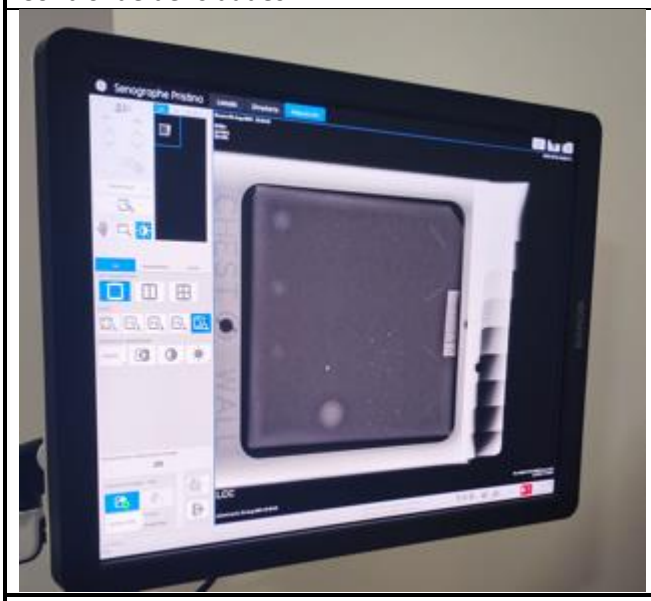

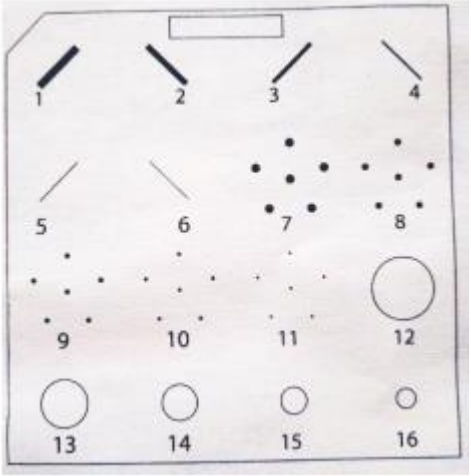

Interpretación: El equipo reconoce de forma correcta los tipos de calcificaciones y las escalas de grises presentadas en el fantoma.

EXACTITUD KV, mA, TIEMPO DE EXPOSICIÓN			
KV:			
	MEDIDA 1	**MEDIDA 2**	**MEDIDA 3**
PROGRAMADO	30 [KV]	30 [KV]	30 [KV]
MEDIDO	31.3 [KV]	30.3 [KV]	31.1 [KV]
ERROR: 3 % (Aprobado)			
mA:			
	MEDIDA 1	**MEDIDA 2**	**MEDIDA 3**
PROGRAMADO	70 [mA]	70 [mA]	70 [mA]
MEDIDO	71,42 [mA]	71,10 [mA]	70,35 [mA]
ERROR: 1.37 % (Aprobado)			
TIEMPO DE EXPOSICIÓN:			
	MEDIDA 1	**MEDIDA 2**	**MEDIDA 3**
PROGRAMADO	140 [ms]	140 [ms]	140 [ms]
MEDIDO	140 [ms]	141 [ms]	140 [ms]
ERROR: 0.24 % (Aprobado)			
Interpretación: Las medidas obtenidas de KV, mA y Tiempo de Exposición se encuentran dentro de las especificaciones dadas por el fabricante.			

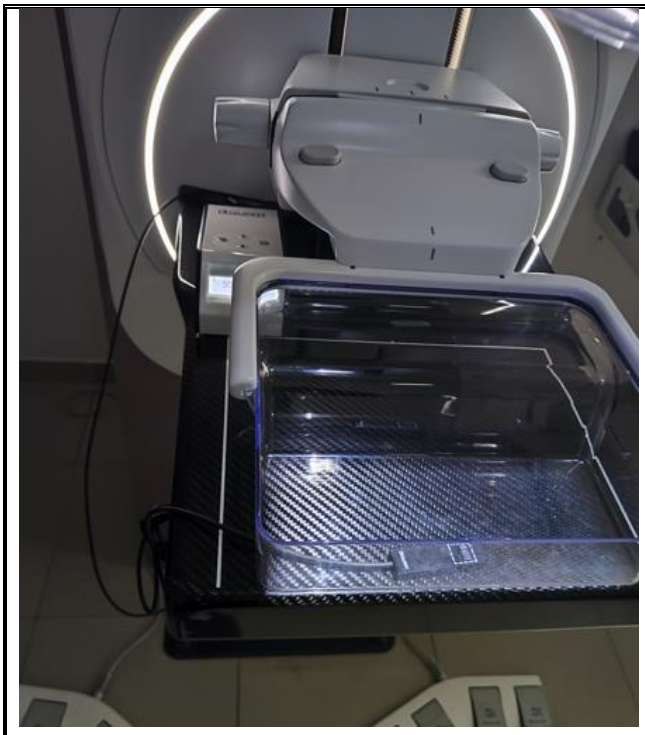

CAPA HEMIRREDUCTORA (HVL)

TÉCNICA: 35 [KVp], 10[mAs], sin filtro

	MEDIDA 1:	MEDIDA 2:	MEDIDA 3:
HVL	0,53 [mmAl]	0,54 [mmAl]	0,53 [mmAl]
Dosis	785,9 [uGy]	780,2 [uGy]	783,2 [uGy]

TÉCNICA: 35 [KVp], 10[mAs], con filtro de 0.53 [mmAl]

	MEDIDA 1:	MEDIDA 2:	MEDIDA 3:
Dosis	436,3 [uGy]	433,2[uGy]	435,6 [uGy]

Interpretación: Al colocar el filtro de aluminio indicado en la medición se obtiene el valor de dosis de radiación a la mitad del valor de dosis sin filtro.

4. Anexos.

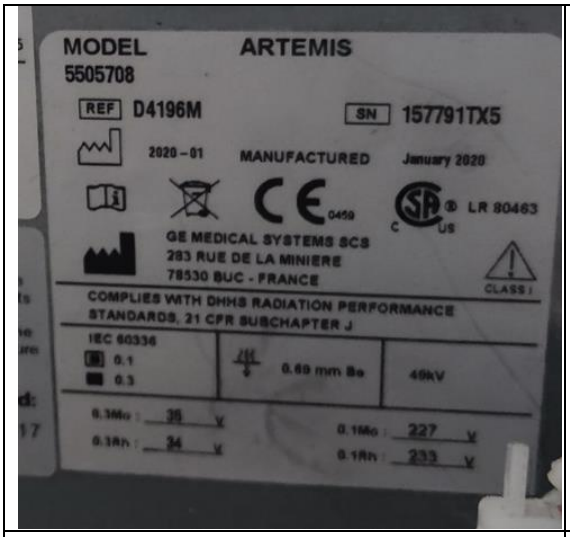	
Fig. 1 Etiqueta del tubo de rayos x	**Fig. 2 Etiqueta del equipo**