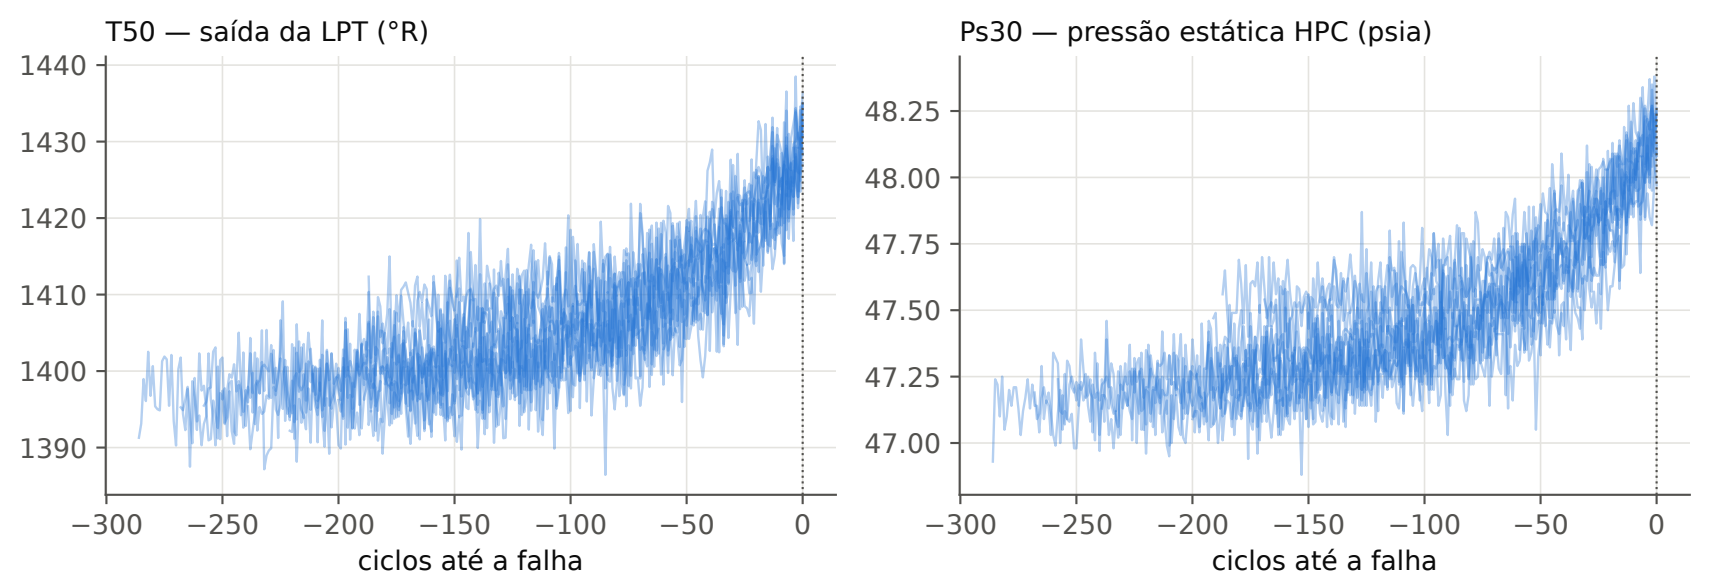
T50 — saída da LPT (°R)
1440
1430
1420
1410
1400
1390
−300
−250
−200
−150
−100
−50
0
ciclos até a falha
Ps30 — pressão estática HPC (psia)
48.25
48.00
47.75
47.50
47.25
47.00
−300
−250
−200
−150
−100
−50
0
ciclos até a falha