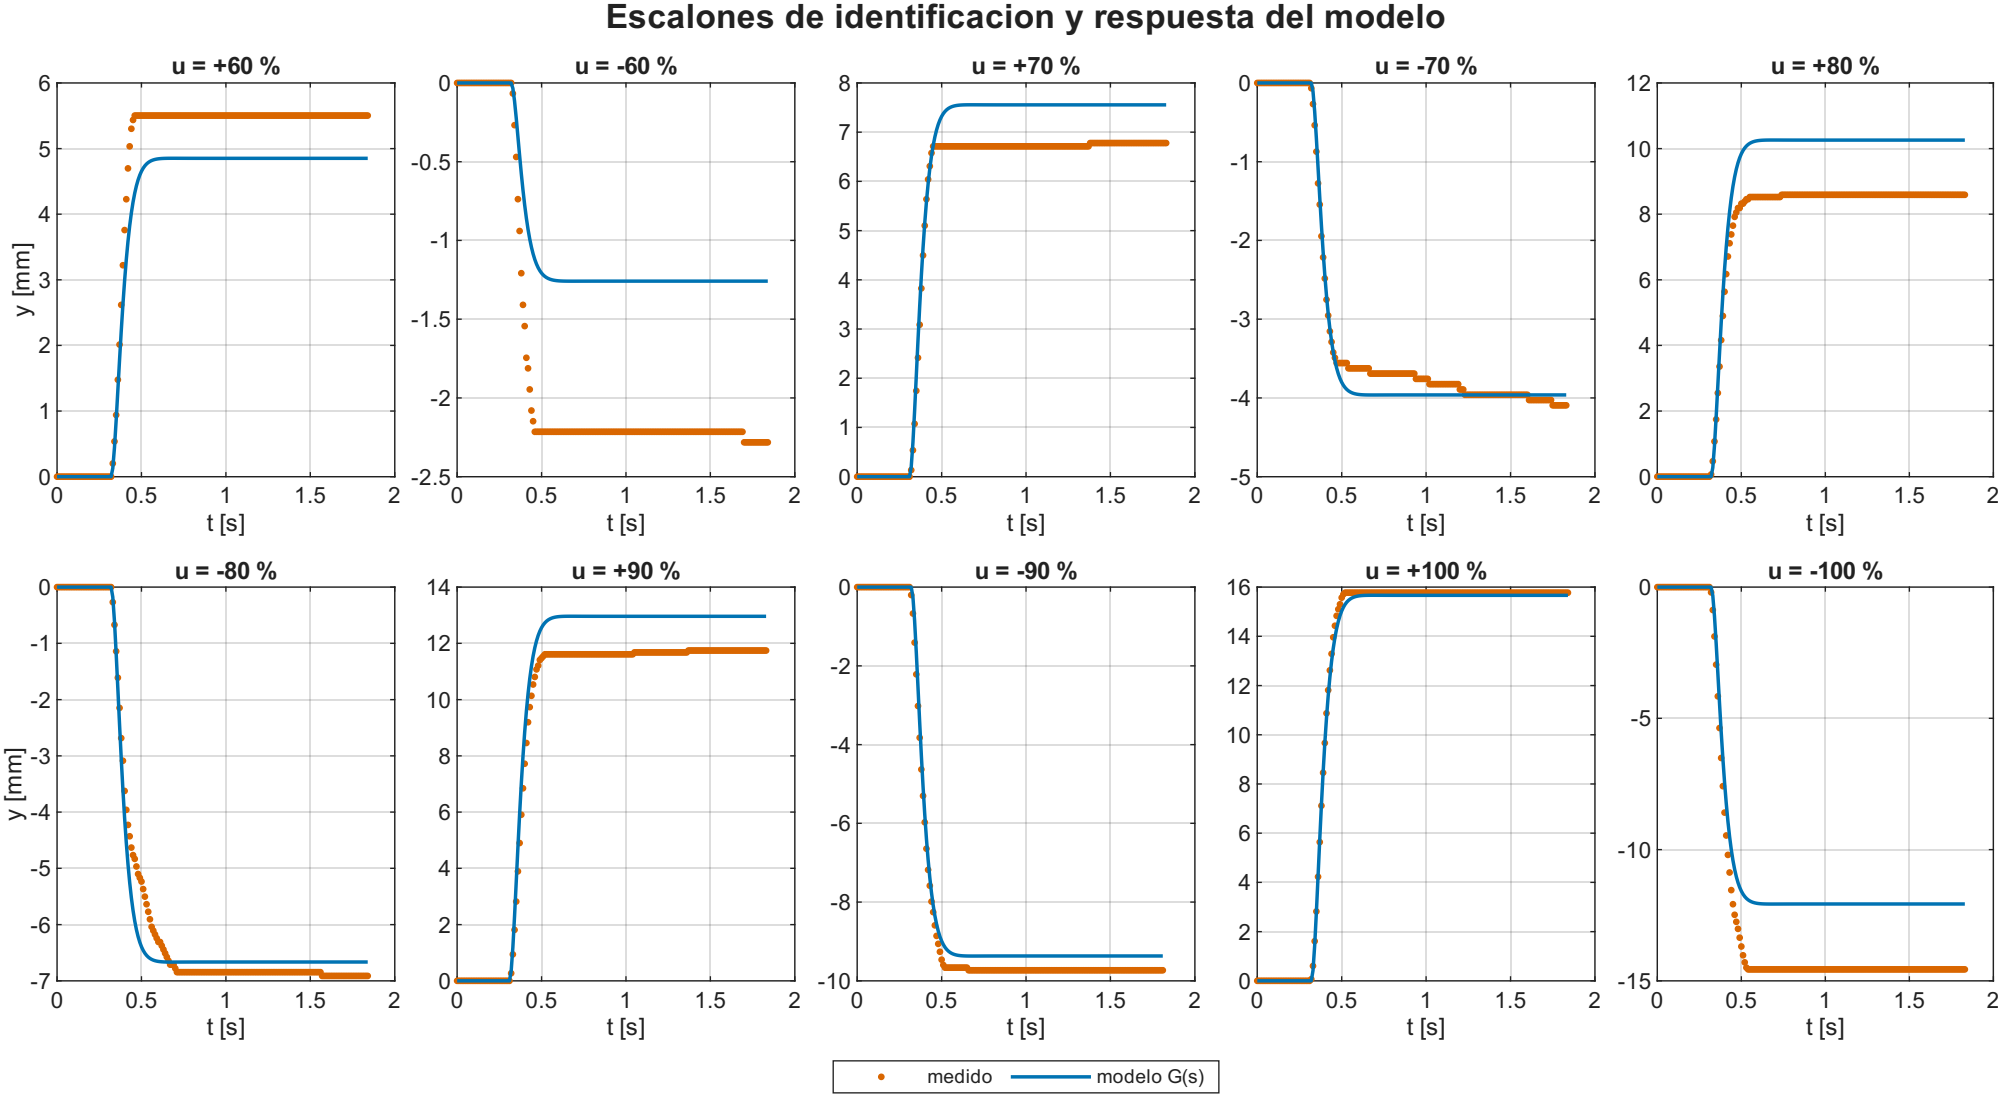

Escalones de identificacion y respuesta del modelo
u = +60 %
u = -60 %
u = +70 %
u = -70 %
u = +80 %
u = -80 %
u = +90 %
u = -90 %
u = +100 %
u = -100 %
y [mm]
t [s]
medido
modelo G(s)