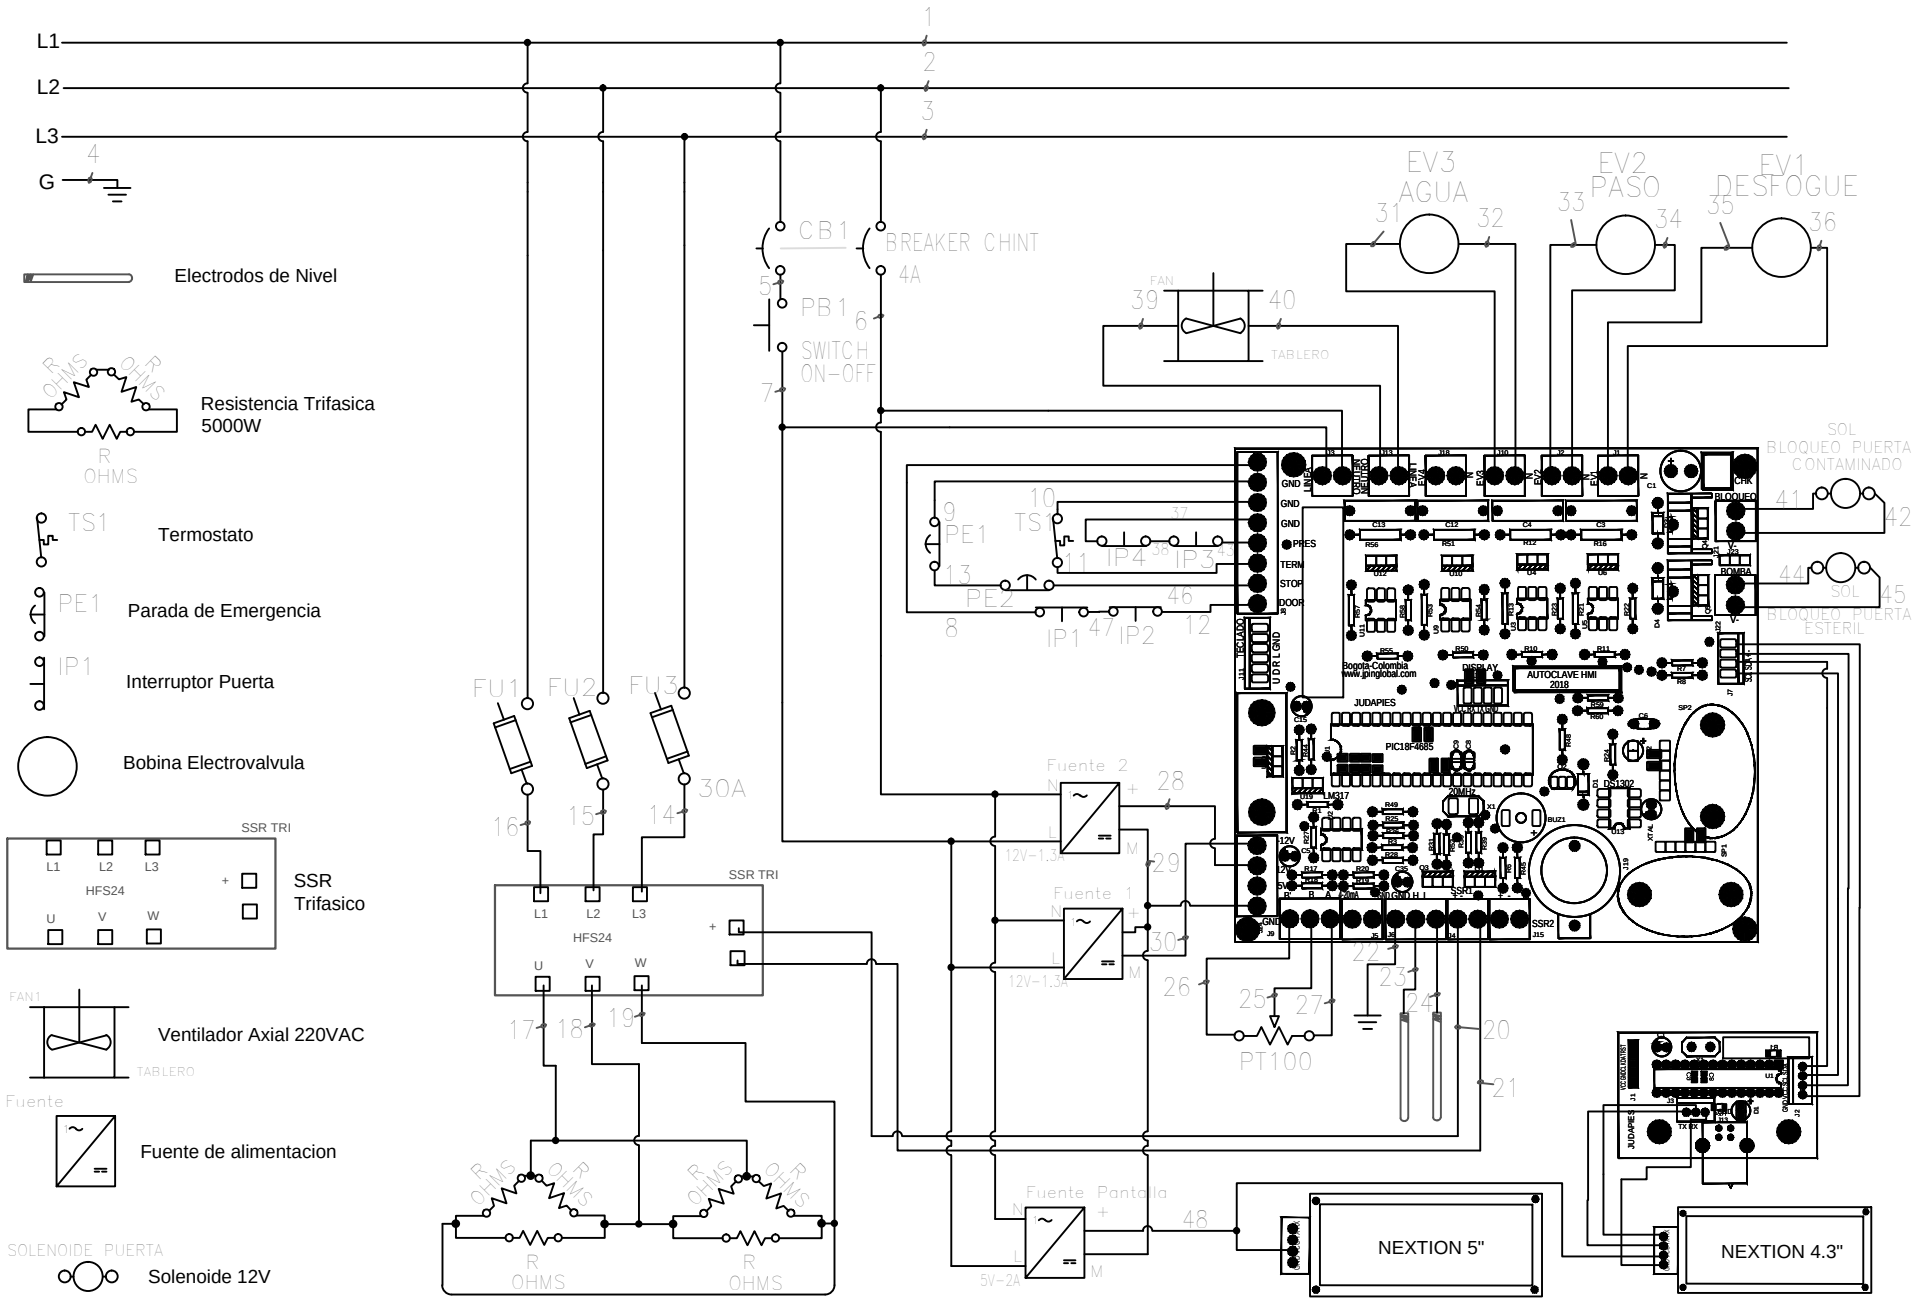

CABLE ELECTROVALVULAS: Encauchetado 2X18 Centelsa
CABLE RESISTENCIA: Cable con recubrimiento en FV AWG #10
CABLE SENSORES NIVEL: Cable con recubrimiento en FV AWG #18
CONEXIONES DC y AC TARJETA: Cable vehicular centelsa AWG#18 (Linea 1:Negro, Linea 2: Blanco, Linea 3:Rojo GND:Negro, +VDC:Rojo, -VDC:Blanco)
CABLE DE ALIMENTACION: Encauchetado 4X10 Centelsa
Cable Termostato,Parada de emergencia,Interruptor de puerta: Encauchetado 2X18 Centelsa
Conexiones no mostradas en este plano, debe referirse a esquema electronico
IP1 Y IP2 son los interruptores de la puerta del lado CONTAMINADO E IP3 e IP4 son los del lado esteril

Conectar Manguera Sensor de presión en puerto +

NOTA: Cablear de acuerdo a potencia de cada conexión.

NOMBRE: Conexiones Autoclave 120L Horizontal Doble Puerta

DIBUJÓ: JUDAPIES

REVISÓ:

FECHA:

HOJA 1 DE 1

PLANO Nº:

JP INGLOBAL

La información aqui contenida es propiedad intelectual de JP INGLOBAL. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización