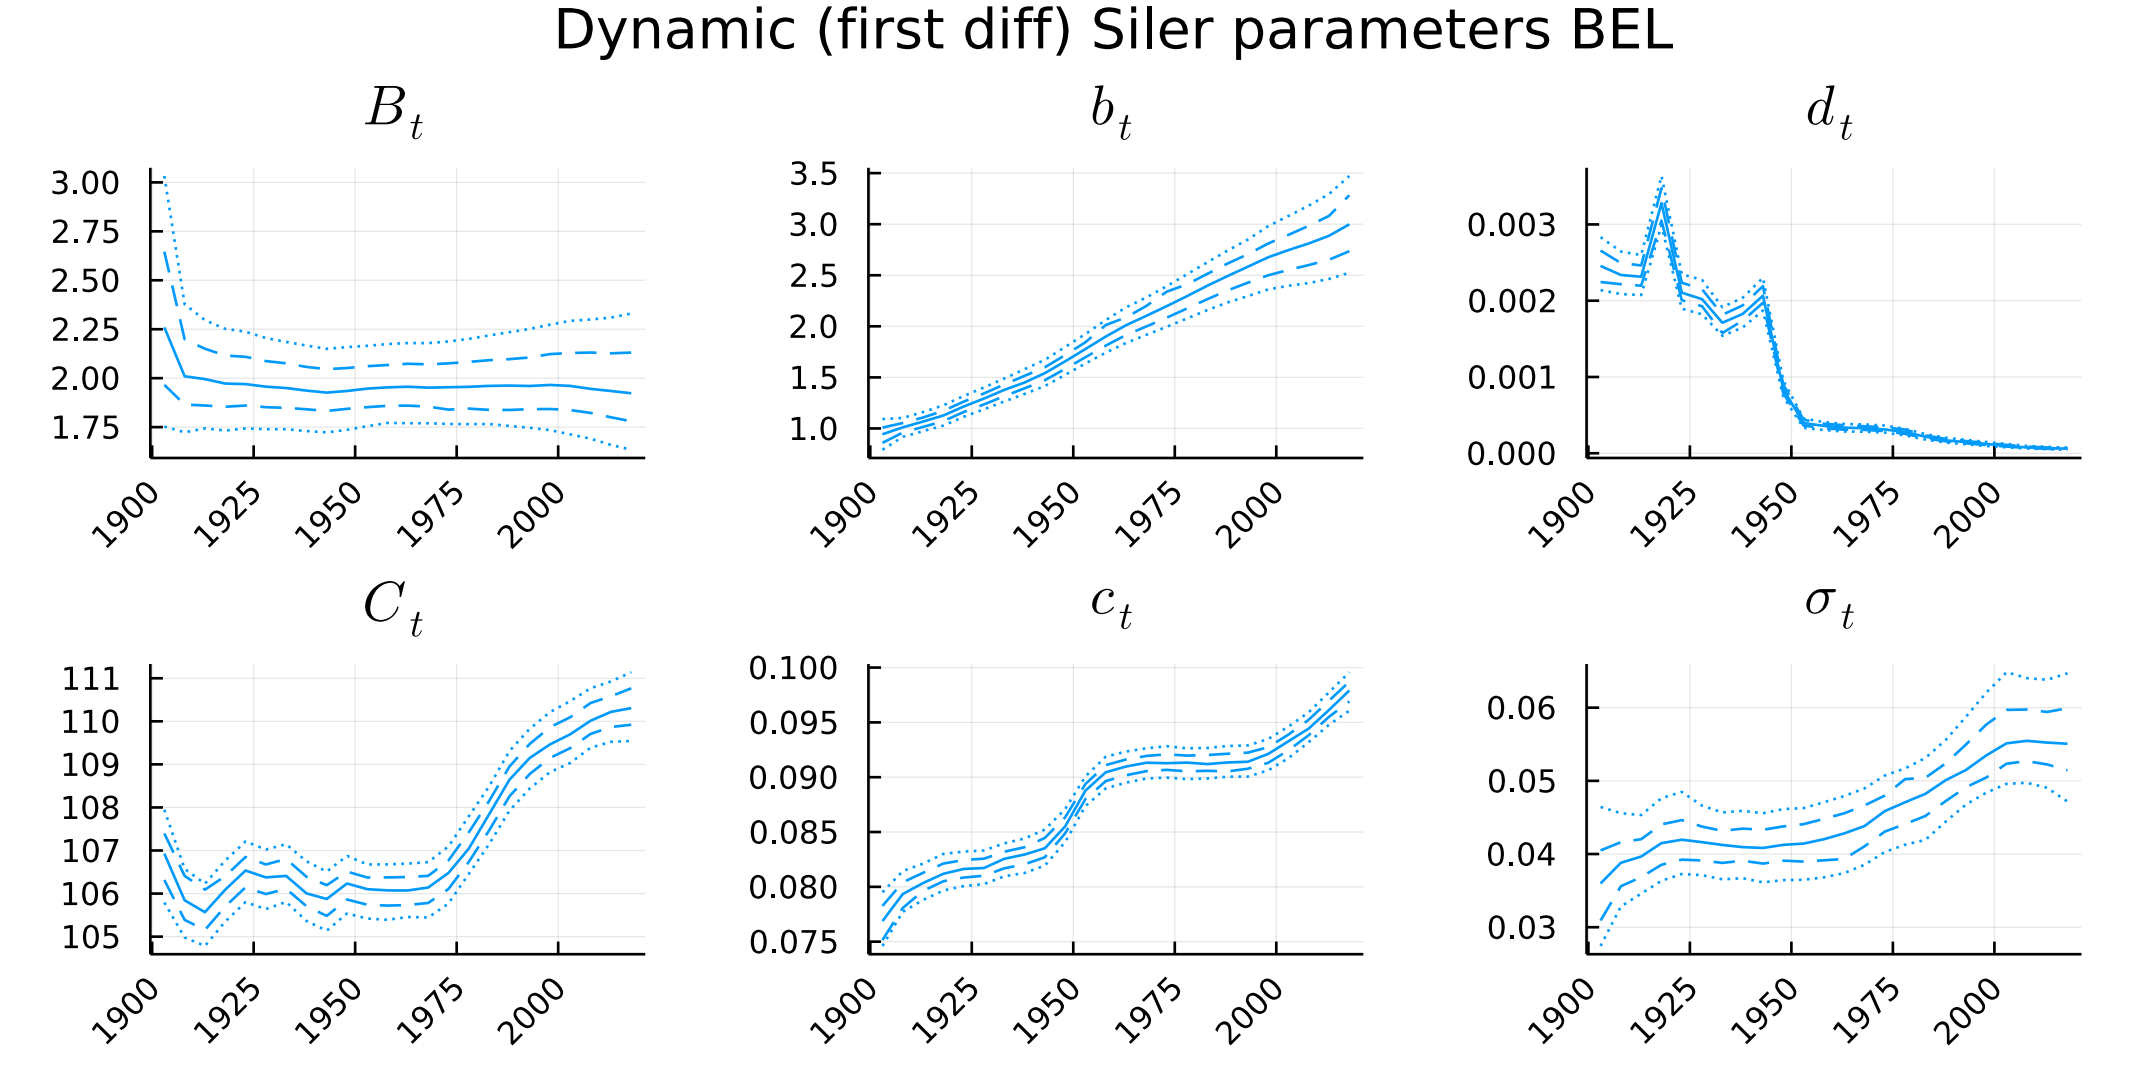
Dynamic (first diff) Siler parameters BEL
B_t
b_t
d_t
C_t
c_t
σ_t
3.00
2.75
2.50
2.25
2.00
1.75
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.003
0.002
0.001
0.000
111
110
109
108
107
106
105
0.100
0.095
0.090
0.085
0.080
0.075
0.06
0.05
0.04
0.03
1900
1925
1950
1975
2000