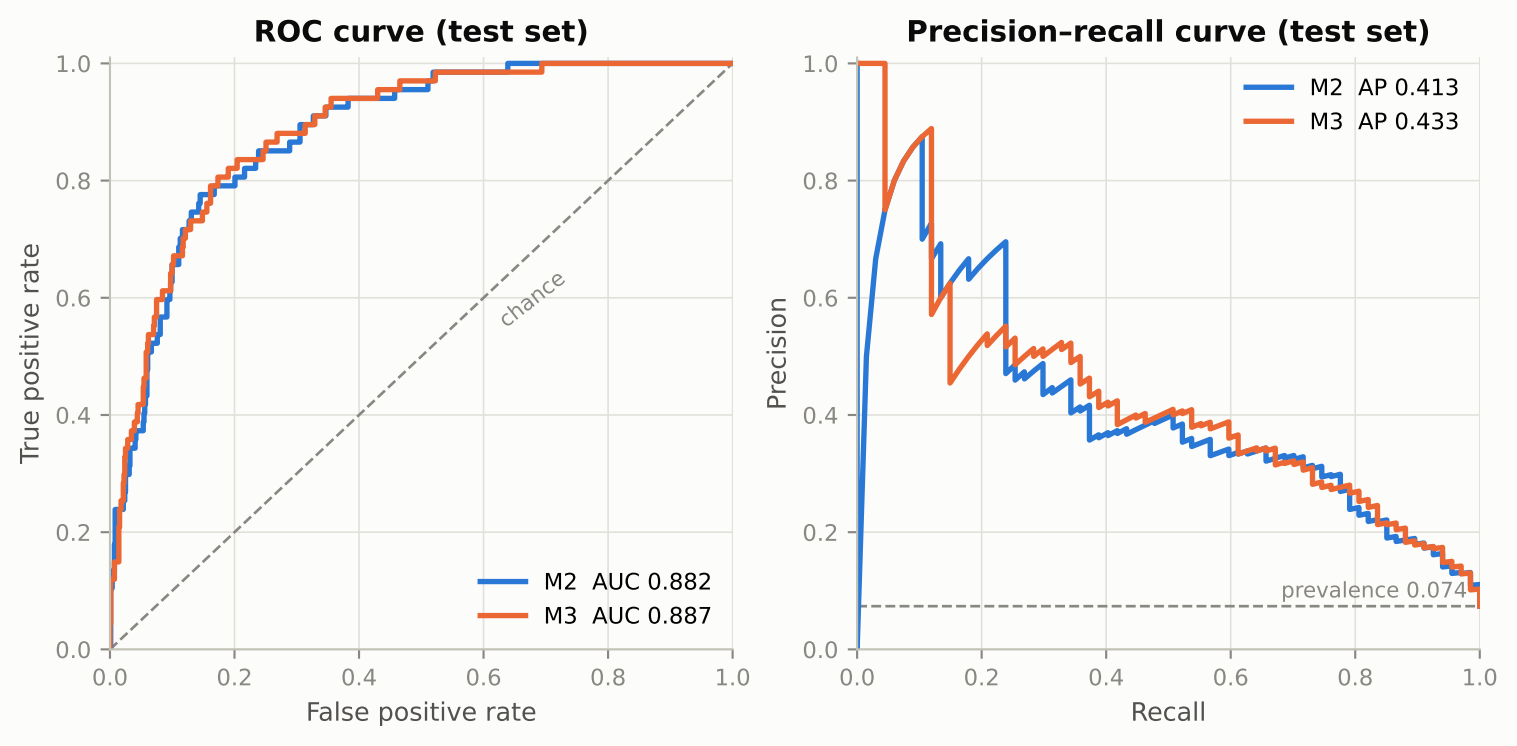
ROC curve (test set)
True positive rate
False positive rate
chance
M2 AUC 0.882
M3 AUC 0.887
Precision–recall curve (test set)
Precision
Recall
M2 AP 0.413
M3 AP 0.433
prevalence 0.074