
Aide au tri des radiographies pulmonaires · rapport d'analyse

Prototype de recherche, non validé cliniquement.
Cet outil aide à ordonner la lecture des radiographies ; il ne pose aucun diagnostic et ne remplace pas la lecture par un médecin.

Date et heure de l'analyse	03/10/2026 à 07:05:42
Référence	—
Système	v4, recadrage sur les poumons · CNN + CBAM
Seuils	du développement, non calibrés localement : verte si score < −1,30, rouge si score > −0,84
Image	1726 × 1505 pixels · empreinte 623c975f6cec114e
Durée de l'analyse	11,1 s

▲ Zone rouge : lecture prioritaire recommandée

Le score est au-dessus du seuil haut. Au réglage utilisé, au plus 10 % des radios NORMAL de l'échantillon de réglage tombaient dans cette zone. Ce n'est pas un diagnostic.

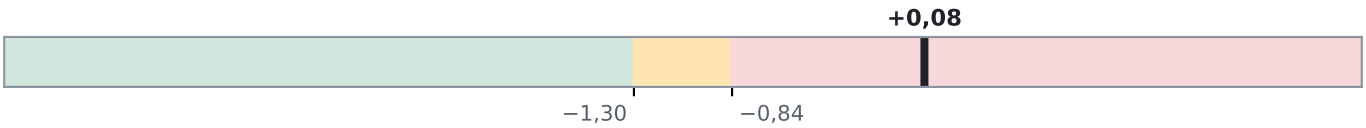

Score moyen des 3 modèles : +0,08 (chaque modèle : −0,04 ; +0,71 ; −0,42 ; écart-type 0,47). Un score plus élevé signifie plus de signes évocateurs de pneumonie pour ce modèle.


Aucune alerte de sécurité.

Seuils du développement, non calibrés localement. Le décalage entre centres d'imagerie fausse ces seuils (notebooks 14 et 15) : ne pas s'y fier tant qu'une calibration locale n'a pas été faite.

Radiographie analysée



Où le modèle a regardé (Grad-CAM) · contour jaune : poumons

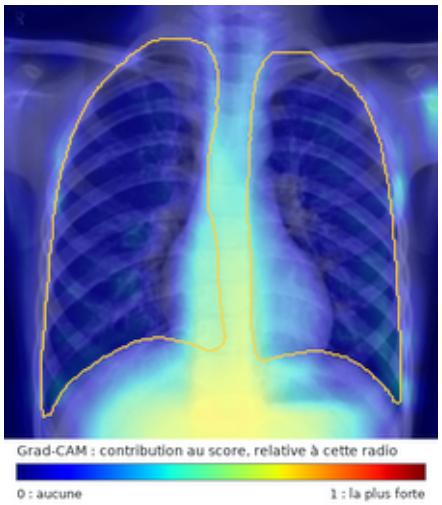

Attention spatiale du CBAM



Les cartes montrent les zones qui ont le plus pesé dans le score de cette radio ; elles ne prouvent pas la présence d'une lésion.

Au notebook 16 (v4), environ la moitié de la carte Grad-CAM tombait dans les poumons : le modèle peut encore s'appuyer sur des repères hors des poumons, comme la lettre « R ».

Attention spatiale du CBAM sur cette radio : de 0,38 à 1,00 (moyenne 0,92 dans les poumons, 0,83 hors des poumons). Elle varie peu : le CBAM pondère peu l'espace, comme au notebook 16.