
Aide au tri des radiographies pulmonaires · rapport d'analyse

Prototype de recherche, non validé cliniquement.
Cet outil aide à ordonner la lecture des radiographies ; il ne pose aucun diagnostic et ne remplace pas la lecture par un médecin.

Date et heure de l'analyse	06/10/2026 à 03:36:58
Référence	—
Système	v4, recadrage sur les poumons · CNN + CBAM
Seuils	du développement, non calibrés localement : verte si score < −1,30, rouge si score > −0,84
Image	1968 × 1484 pixels · empreinte d75bc2d438a87815
Durée de l'analyse	7,2 s

✓ Zone verte : lecture en file standard

Le score est sous le seuil bas. Au réglage utilisé, au plus 2 % des radios PNEUMONIA de l'échantillon de réglage tombaient dans cette zone. Une zone verte n'exclut pas une pneumonie.

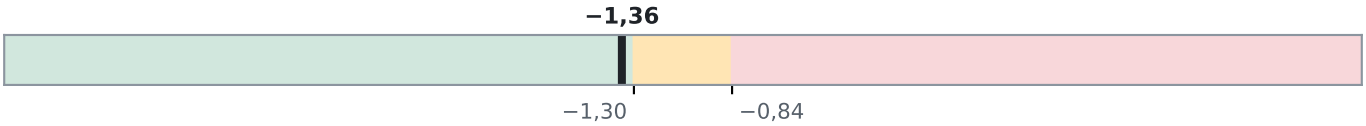

Score moyen des 3 modèles : −1,36 (chaque modèle : −1,47 ; −1,65 ; −0,96 ; écart-type 0,29). Un score plus élevé signifie plus de signes évocateurs de pneumonie pour ce modèle.


Aucune alerte de sécurité.

Seuils du développement, non calibrés localement. Le décalage entre centres d'imagerie fausse ces seuils (notebooks 14 et 15) : ne pas s'y fier tant qu'une calibration locale n'a pas été faite.

Radiographie analysée



Où le modèle a regardé (Grad-CAM) · contour jaune : poumons

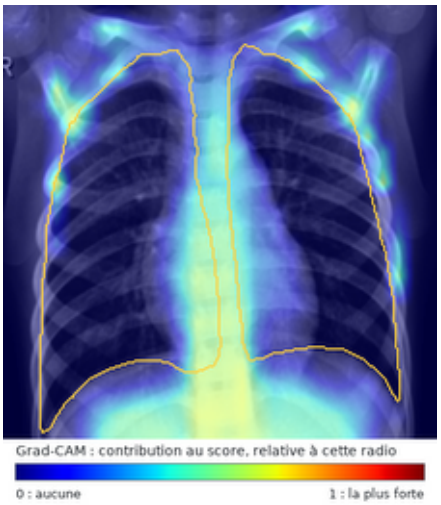

Attention spatiale du CBAM



Les cartes montrent les zones qui ont le plus pesé dans le score de cette radio ; elles ne prouvent pas la présence d'une lésion.

Au notebook 16 (v4), environ la moitié de la carte Grad-CAM tombait dans les poumons : le modèle peut encore s'appuyer sur des repères hors des poumons, comme la lettre « R ».

Ici, le modèle penche vers NORMAL : la carte montre ce qui a fait baisser le score. Pour ces radios, la carte est souvent vide ou hors des poumons (notebook 16) : ne pas l'interpréter.

Attention spatiale du CBAM sur cette radio : de 0,34 à 1,00 (moyenne 0,94 dans les poumons, 0,81 hors des poumons). Elle varie peu : le CBAM pondère peu l'espace, comme au notebook 16.