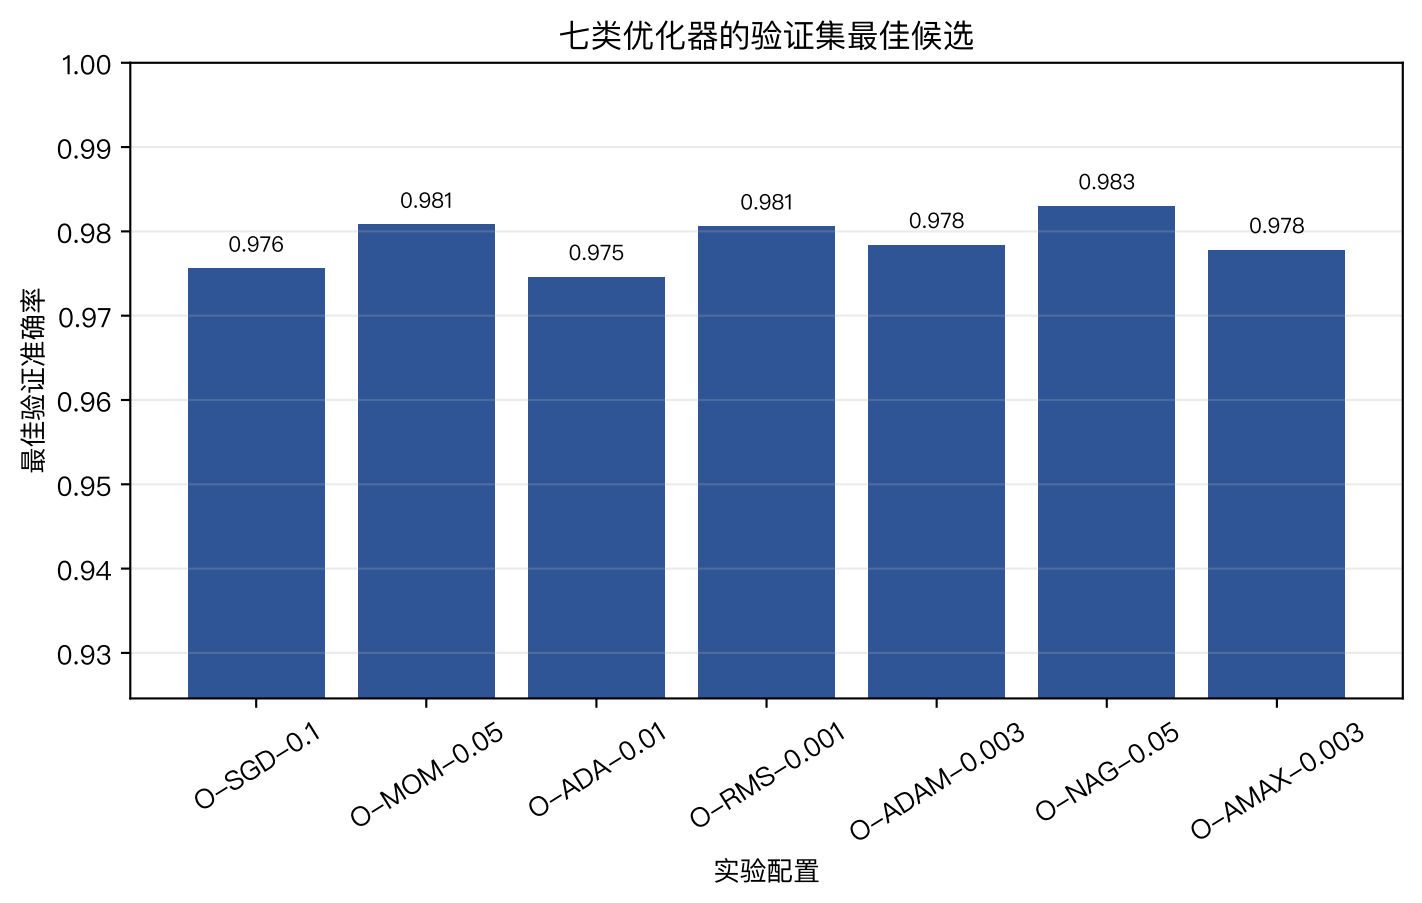
七类优化器的验证集最佳候选
1.00
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
最佳验证准确率
0.976
0.981
0.975
0.981
0.978
0.983
0.978
O–SGD–0.1
O–MOM–0.05
O–ADA–0.01
O–RMS–0.001
O–ADAM–0.003
O–NAG–0.05
O–AMAX–0.003
实验配置