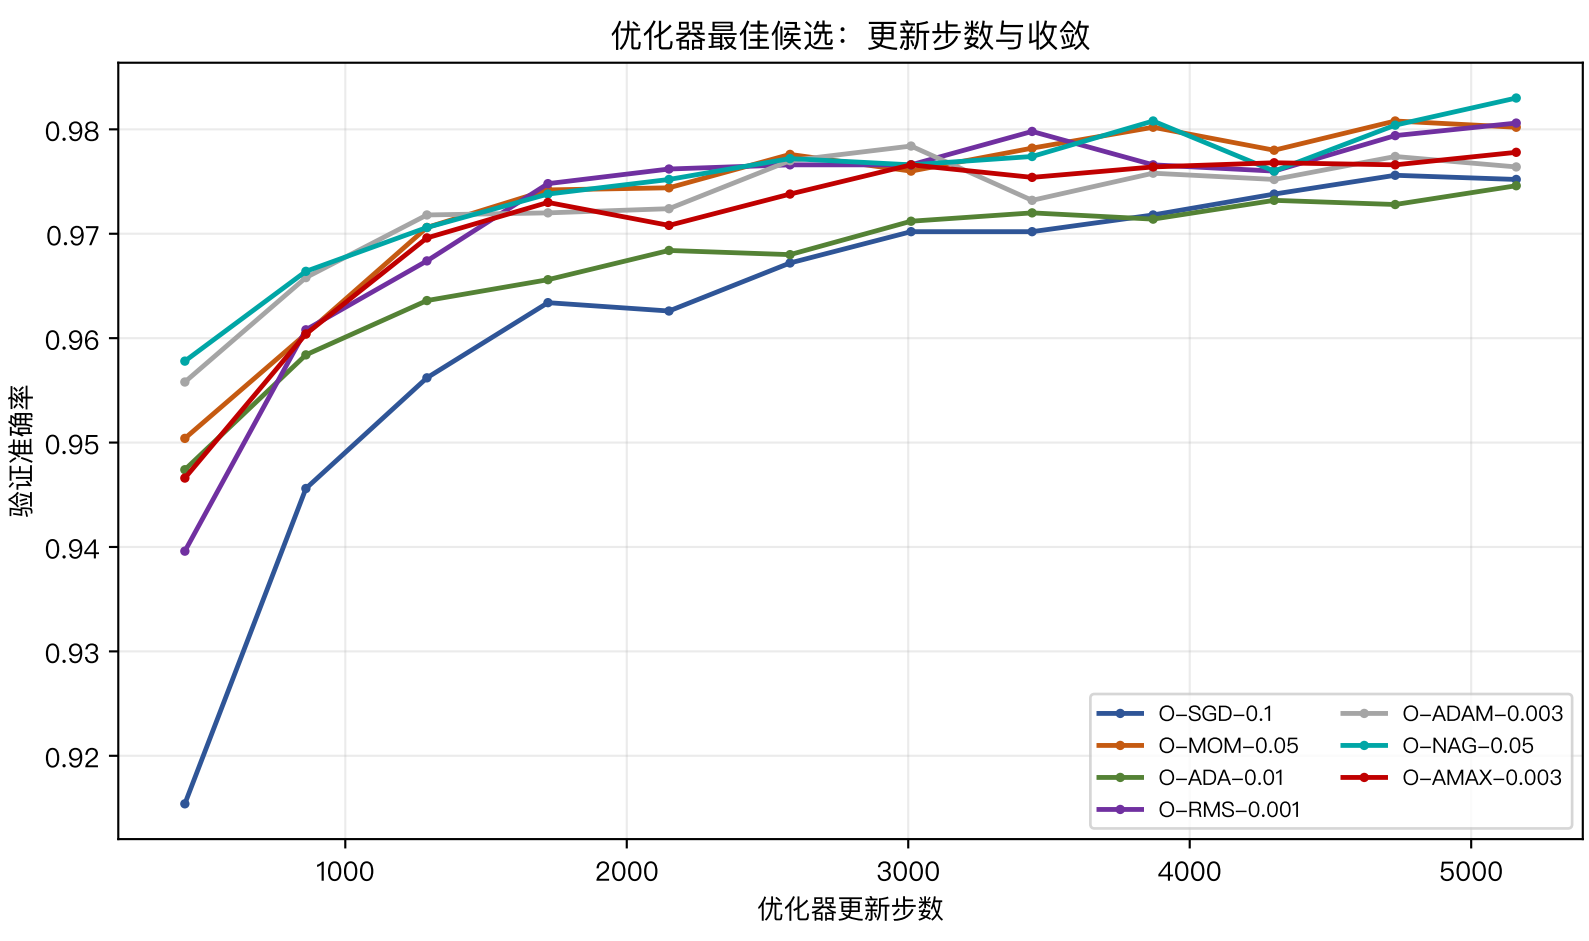
优化器最佳候选：更新步数与收敛
验证准确率
优化器更新步数
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
1000
2000
3000
4000
5000
O-SGD-0.1
O-MOM-0.05
O-ADA-0.01
O-RMS-0.001
O-ADAM-0.003
O-NAG-0.05
O-AMAX-0.003