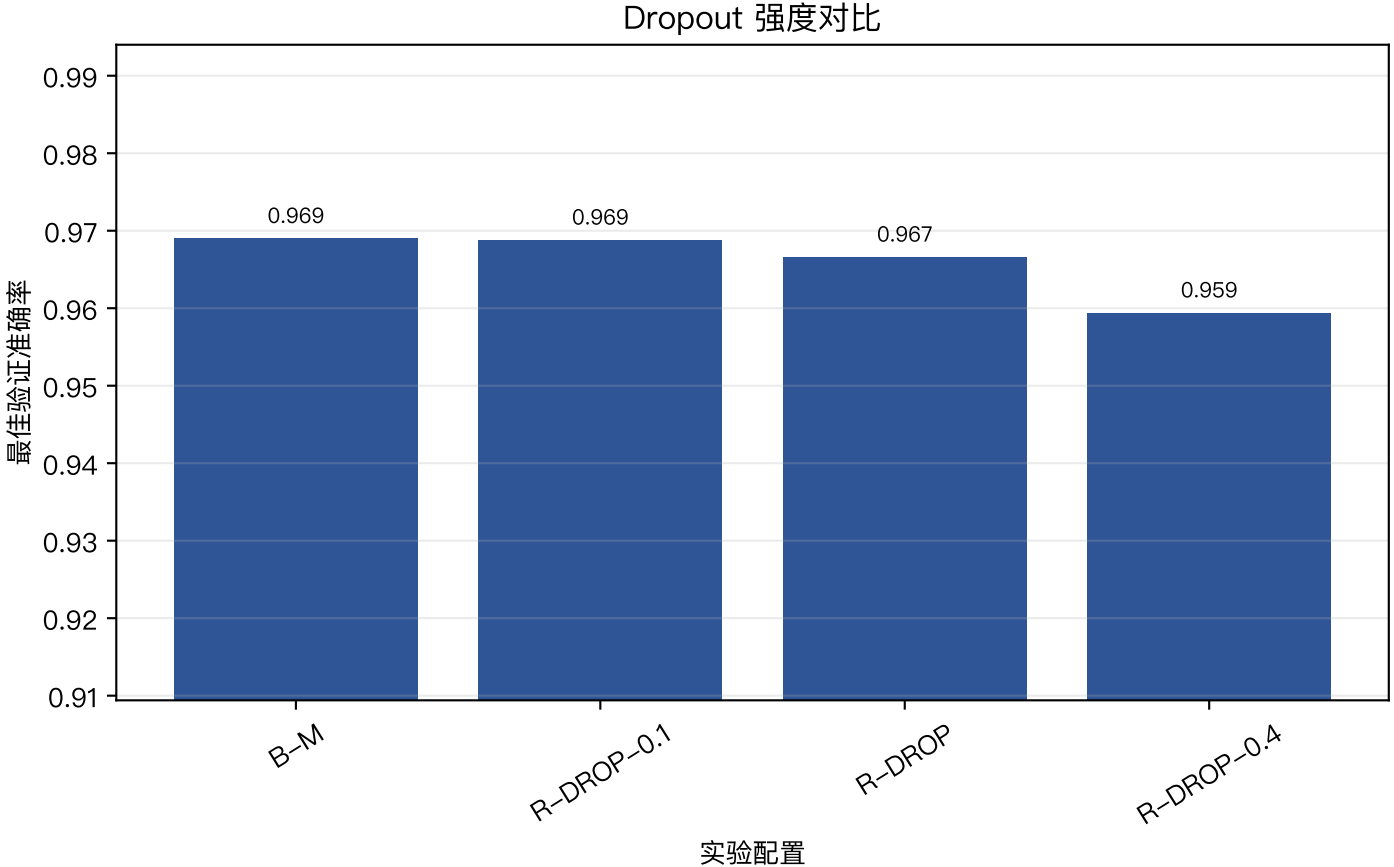
Dropout 强度对比
最佳验证准确率
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
0.91
0.969
0.969
0.967
0.959
B-M
R-DROP-0.1
R-DROP
R-DROP-0.4
实验配置