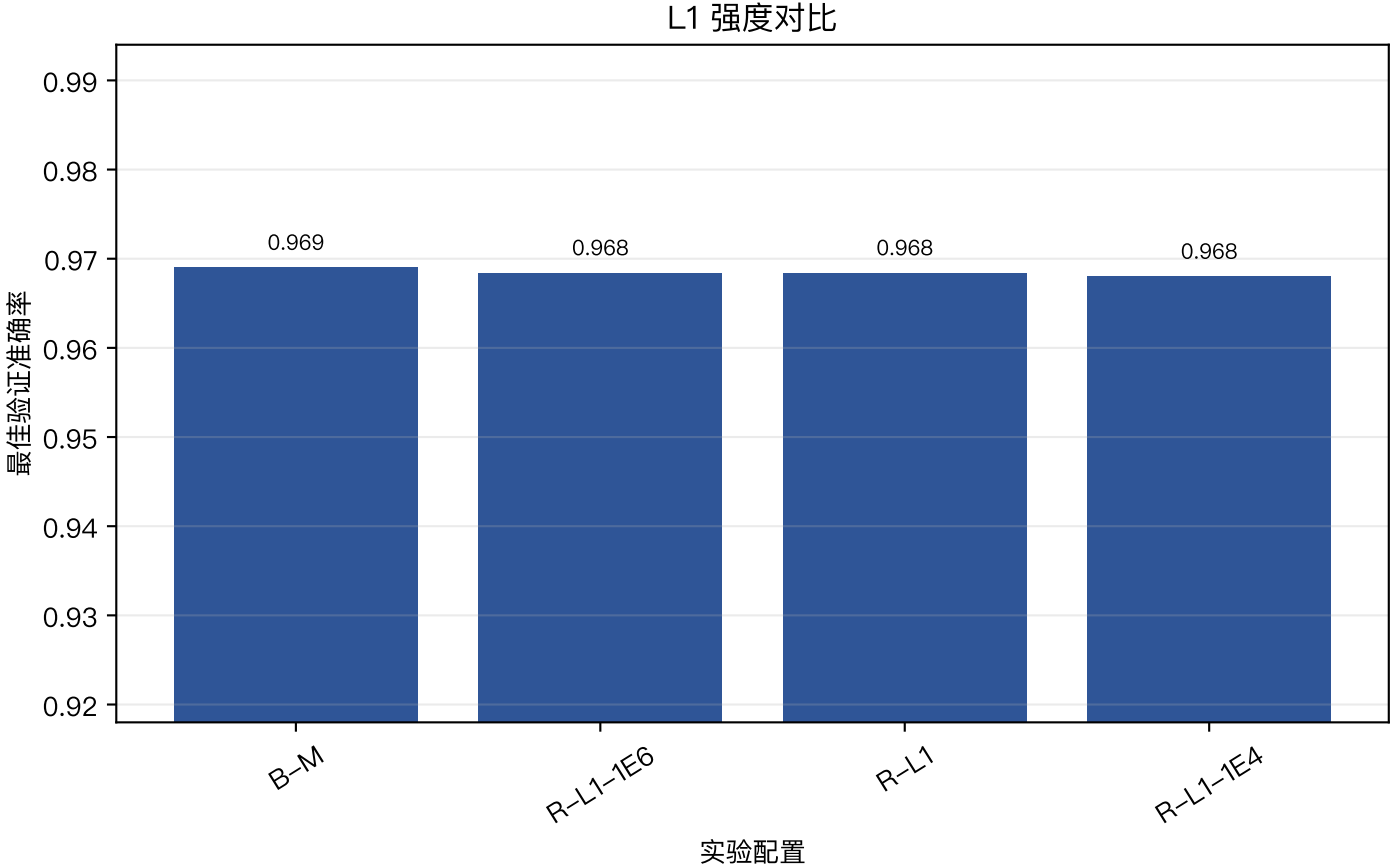
L1 强度对比
最佳验证准确率
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
0.969
0.968
0.968
0.968
B-M
R-L1-1E6
R-L1
R-L1-1E4
实验配置