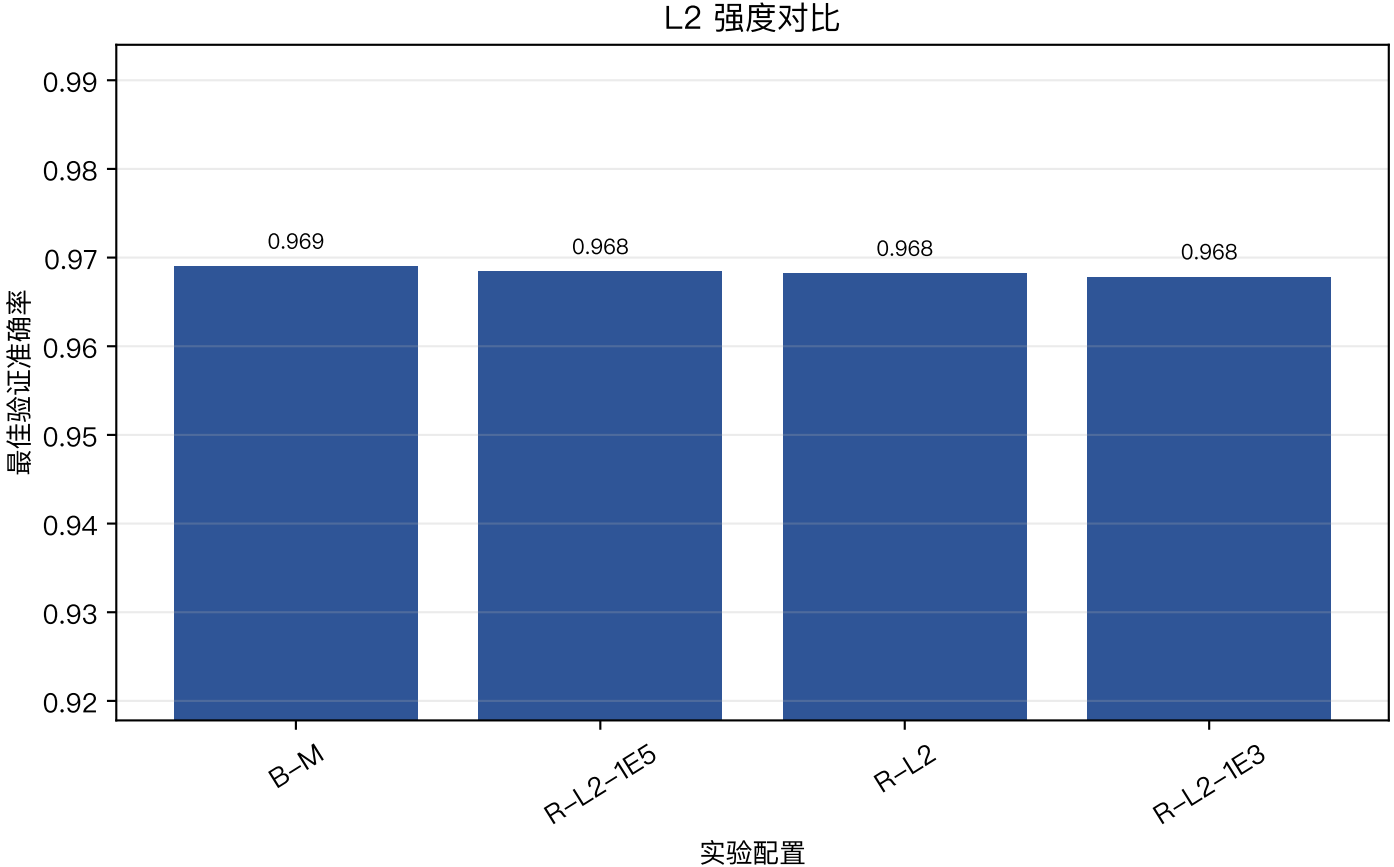
L2 强度对比
最佳验证准确率
0.99
0.98
0.97
0.96
0.95
0.94
0.93
0.92
0.969
0.968
0.968
0.968
B-M
R-L2-1E5
R-L2
R-L2-1E3
实验配置