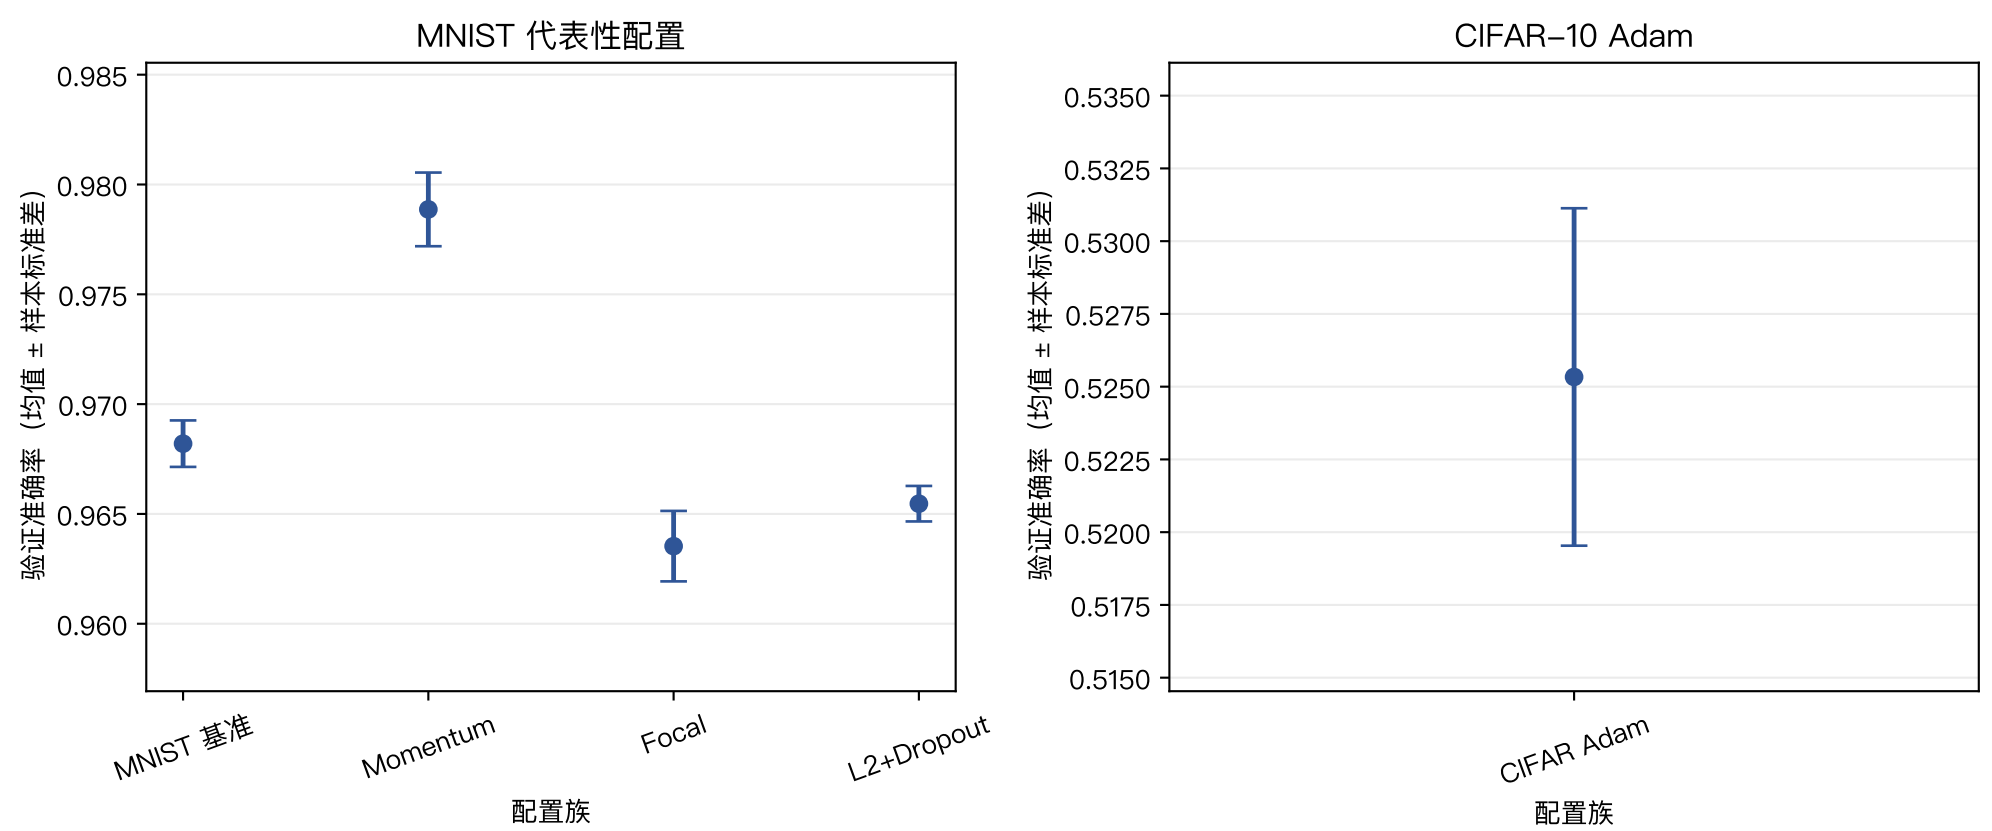
MNIST 代表性配置
验证准确率（均值 ± 样本标准差）
0.985
0.980
0.975
0.970
0.965
0.960
MNIST 基准
Momentum
Focal
L2+Dropout
配置族
CIFAR-10 Adam
验证准确率（均值 ± 样本标准差）
0.5350
0.5325
0.5300
0.5275
0.5250
0.5225
0.5200
0.5175
0.5150
CIFAR Adam
配置族