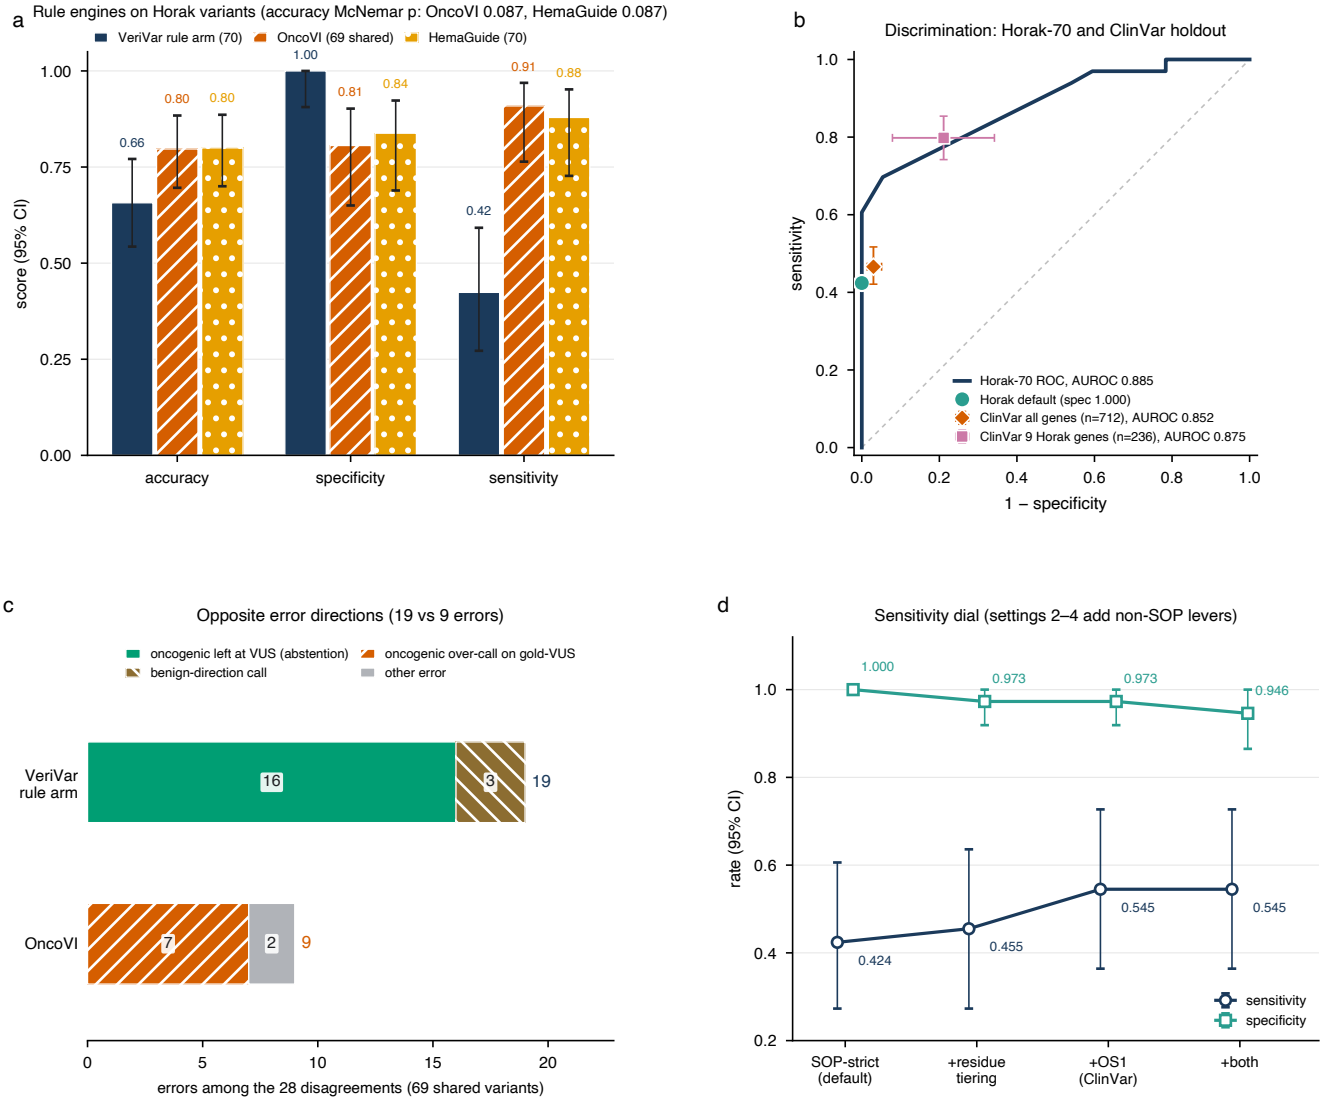
a
Rule engines on Horak variants (accuracy McNemar p: OncoVI 0.087, HemaGuide 0.087)
VeriVar rule arm (70)
OncoVI (69 shared)
HemaGuide (70)
score (95% CI)
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.66
0.80
0.80
1.00
0.81
0.84
0.42
0.91
0.88
accuracy
specificity
sensitivity
b
Discrimination: Horak-70 and ClinVar holdout
sensitivity
1 – specificity
Horak-70 ROC, AUROC 0.885
Horak default (spec 1.000)
ClinVar all genes (n=712), AUROC 0.852
ClinVar 9 Horak genes (n=236), AUROC 0.875
c
Opposite error directions (19 vs 9 errors)
oncogenic left at VUS (abstention)
oncogenic over-call on gold-VUS
benign-direction call
other error
VeriVar rule arm
16
3
19
OncoVI
7
2
9
errors among the 28 disagreements (69 shared variants)
d
Sensitivity dial (settings 2–4 add non-SOP levers)
rate (95% CI)
1.000
0.973
0.973
0.946
0.424
0.455
0.545
0.545
sensitivity
specificity
SOP-strict (default)
+residue tiering
+OS1 (ClinVar)
+both