

SISTEMAS METROLÓGICOS DE OCCIDENTE S.A.S

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO No. 12465

DATOS DEL SOLICITANTE

NOMBRE DE LA EMPRESA: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E

NOMBRE DEL CONTACTO: ANGÉLICA MARÍA CAMPO MANCILLA

TELÉFONO: 5540800

DIRECCIÓN: CALLE 5 # 36-08

DATOS DEL EQUIPO BAJO PRUEBA

EQUIPO: ESFIGMOMANÓMETRO

MARCA: WELCH ALLYN

MODELO: NO IDENTIFICADO

SERIE: 180125073705

ACTIVO: K05221

UBICACIÓN: CIRUGÍA HOMBRES

FECHA DE RECEPCIÓN: 29/10/2019

FECHA DE CALIBRACIÓN: 29/10/2019

CONDICIONES AMBIENTALES

TEMPERATURA INICIAL: 23,1 °C

TEMPERATURA FINAL: 23,3 °C

HUMEDAD INICIAL: 58,8 %HR

HUMEDAD FINAL: 63,0 %HR

LUGAR DE CALIBRACIÓN: EN SITIO

SISTEMAS METROLÓGICOS DE OCCIDENTE S.A.S

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO No. 12465

MÉTODO DE CALIBRACIÓN

Para la calibración del esfigmomanómetro se empleó el método de comparación directa con un manómetro patrón de referencia, siguiendo los lineamientos para determinar los errores máximos permisibles de la indicación del manómetro, prueba A.1. de la Recomendación Internacional R 16-1 Edición 2002 (E): Non-invasive mechanical sphygmomanometers de la ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE METROLOGÍA LEGAL (OIML).

TRAZABILIDAD DEL PATRÓN

NOMBRE: SIMULADOR MULTIPARÁMETRO

FABRICANTE: FLUKE BIOMEDICAL

MODELO: PROSIM 8

SERIE: 2846038

LABORATORIO CERTIFICADOR: SET AND GAD (Acreditación NVLAP LAB CODE: 201065-0)

FECHA DE CALIBRACIÓN: 2019-07-23

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN No: J12107-19

SISTEMAS METROLÓGICOS DE OCCIDENTE S.A.S


CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO No. 12465

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

MAGNITUD	VALOR NOMINAL (mmHg)	LECTURA PROMEDIO DEL EQUIPO PATRÓN (mmHg)	DESVIACIÓN ESTANDAR (mmHg)	ERROR (mmHg)	FACTOR K (95%)	INCERTIDUMBRE EXPANDIDA (mmHg)
PRESIÓN	0	0,0	0,0	0,0	2	± 1,0
	50	49,8	0,7	0,2	2	± 1,4
	100	100,7	0,3	-0,7	2	± 1,5
	150	149,8	0,4	0,2	2	± 1,7
	200	199,3	0,2	0,8	2	± 2,0
	250	248,7	0,5	1,3	2	± 2,2

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS RESULTADOS

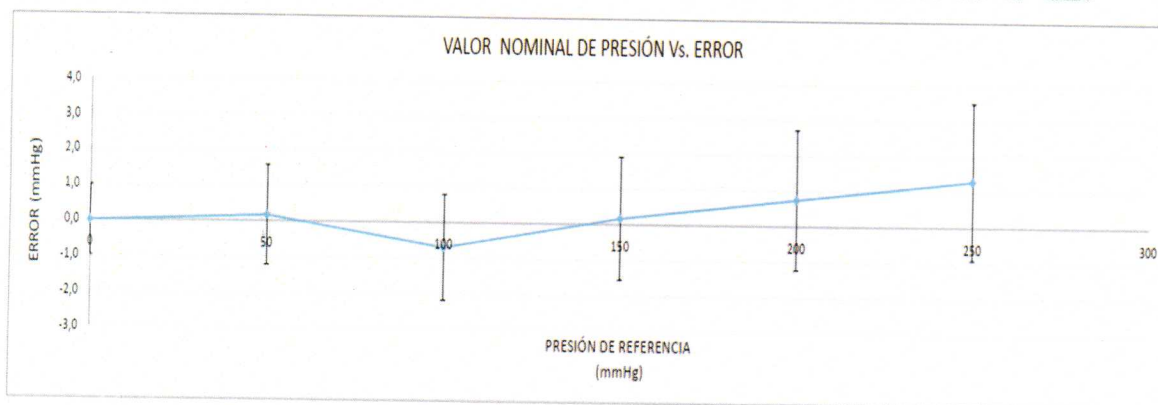

SISTEMAS METROLÓGICOS DE OCCIDENTE S.A.S

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO No. 12465

OBSERVACIONES DE LA CALIBRACIÓN

1. Para la utilización de este instrumento deben tenerse en cuenta los resultados de esta calibración, el usuario es el responsable de determinar de acuerdo a la tolerancia establecida para el proceso de medición con el instrumento, si este le es útil con los resultados emitidos en este certificado.
2. Al instrumento se le adhirió un sticker de calibración correspondiente al número de certificado de calibración.
3. Los certificados de calibración sin firma de revisado no serán válidos.
4. La incertidumbre reportada en este certificado corresponde a la incertidumbre de medición expandida que resulta al multiplicar la incertidumbre combinada con un factor de cobertura de $k=2$. Se considera que el parámetro asociado al resultado de la medición logra un nivel de confianza de aproximadamente 95%.
5. La calibración portada en este certificado es trazable a través del NIST u otro Instituto Nacional de Metrología al Sistema Internacional de Unidades (SI).
6. Los resultados contenidos en este documento, corresponden al lugar y condiciones aquí expresados y se refieren únicamente al objeto sometido a calibración.
7. Los resultados que se reportan en el certificado de calibración provienen del proveedor externo Intelmédica, certificado de calibración No. 23533.



SISTEMAS METROLÓGICOS DE OCCIDENTE S.A.S

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

CERTIFICADO No. 12465

CALIBRADO POR:

METRÓLOGO VÍCTOR RUIZ CHÁVES (PROVEEDOR INTEL MÉDICA)

AUTORIZADO POR:

ING. VIVIAN HURTADO
DIRECTORA DE LABORATORIO – SISTEMAS METROLÓGICOS DE OCCIDENTE S.A.S

FECHA DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO: 16/11/2019

****FIN DEL CERTIFICADO****