

HbA1c: Brak danych


Pompa: Paradigm Veo - 754  
Sensor: W użyciu

#744307

## Glukoza (mg/dl)


Glu z podłączonego urządzenia ● Glukoza z glukometru ■ Poza skalą ▲ Sensor — Alarm sensora 📶

Zakres docelowy ■ Limit hipoglikemii —

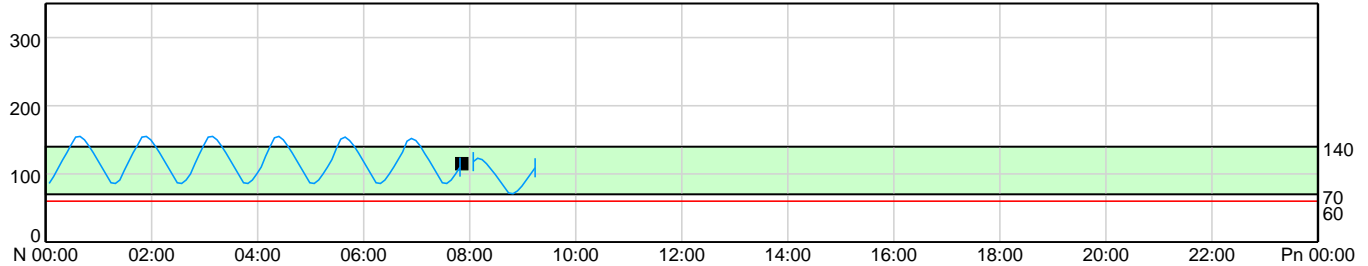


## Podawanie insuliny

Alarm pompy 📶 Bolus ■ Bolus przedłużony ■ Baza — Tymczasowa baza - - - Zatrzymanie —

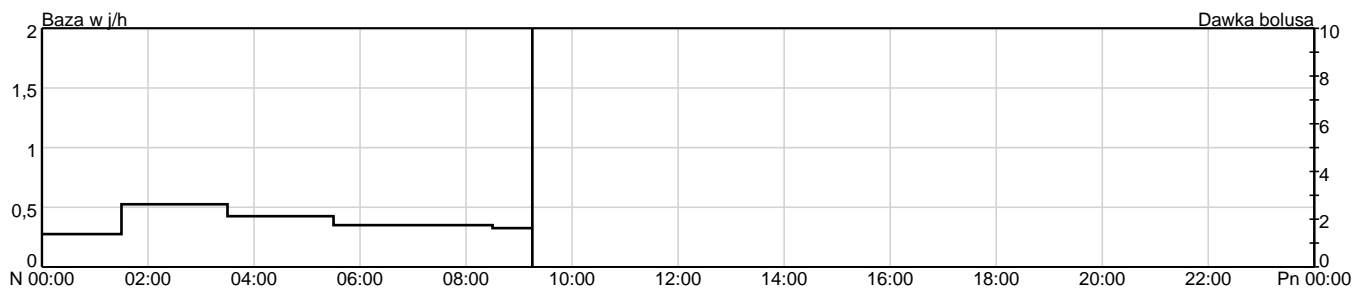

## Węglowodany i wysiłek fizyczny

Węglowodany w WW ● Inne 📶 Zdarzenia podczas wysiłku ■ ❤️

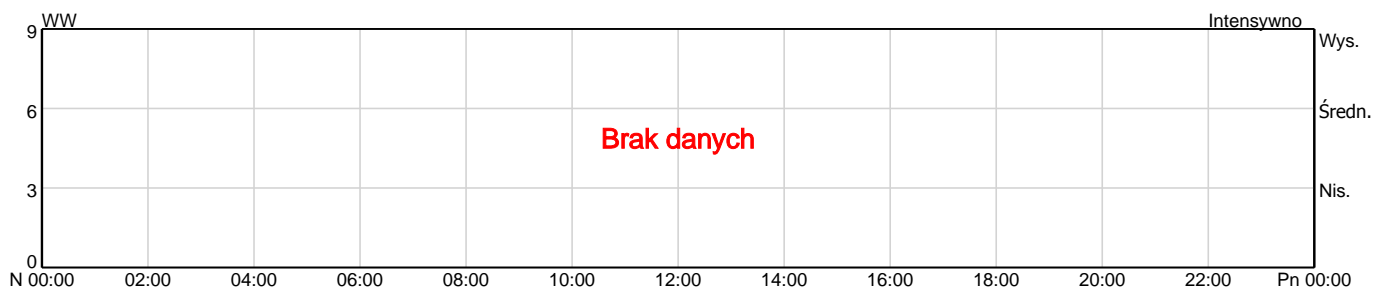

## Podsumowanie

Glukoza z glukometru/sensora	Insulina	Węglowodany	Wysiłek fizyczny
Średnia (mg/dl) 115/116	Łącznie (j) 3,62	Łącznie węglowodanów (WW) -	Łącznie minut -
Hiper (mg/dl) 115/155	Baza (j) 3,62 100%	Średnio węglowodanów (WW) -	Średnia intensywność -
Hipo (mg/dl) 115/71	Bolus (j) 0,0 0%	# posiłków -	Średnio minut -
# odczytów 1/109	Normalny (j) 0,0		# epizodów -
# pomiarów hipo 0	Przedłużony (j) 0,0		
# incydentów hipo 0	Czas zatrzymania (minuty) 0		
	Czas trwania tymczasowej bazy (minuty) 0		
	# alarmów 0		
	# wstrzyknięć 0		
	Łącznie zatrzymań 0		