


ДСК /(мВт/мг)

ТГ /%

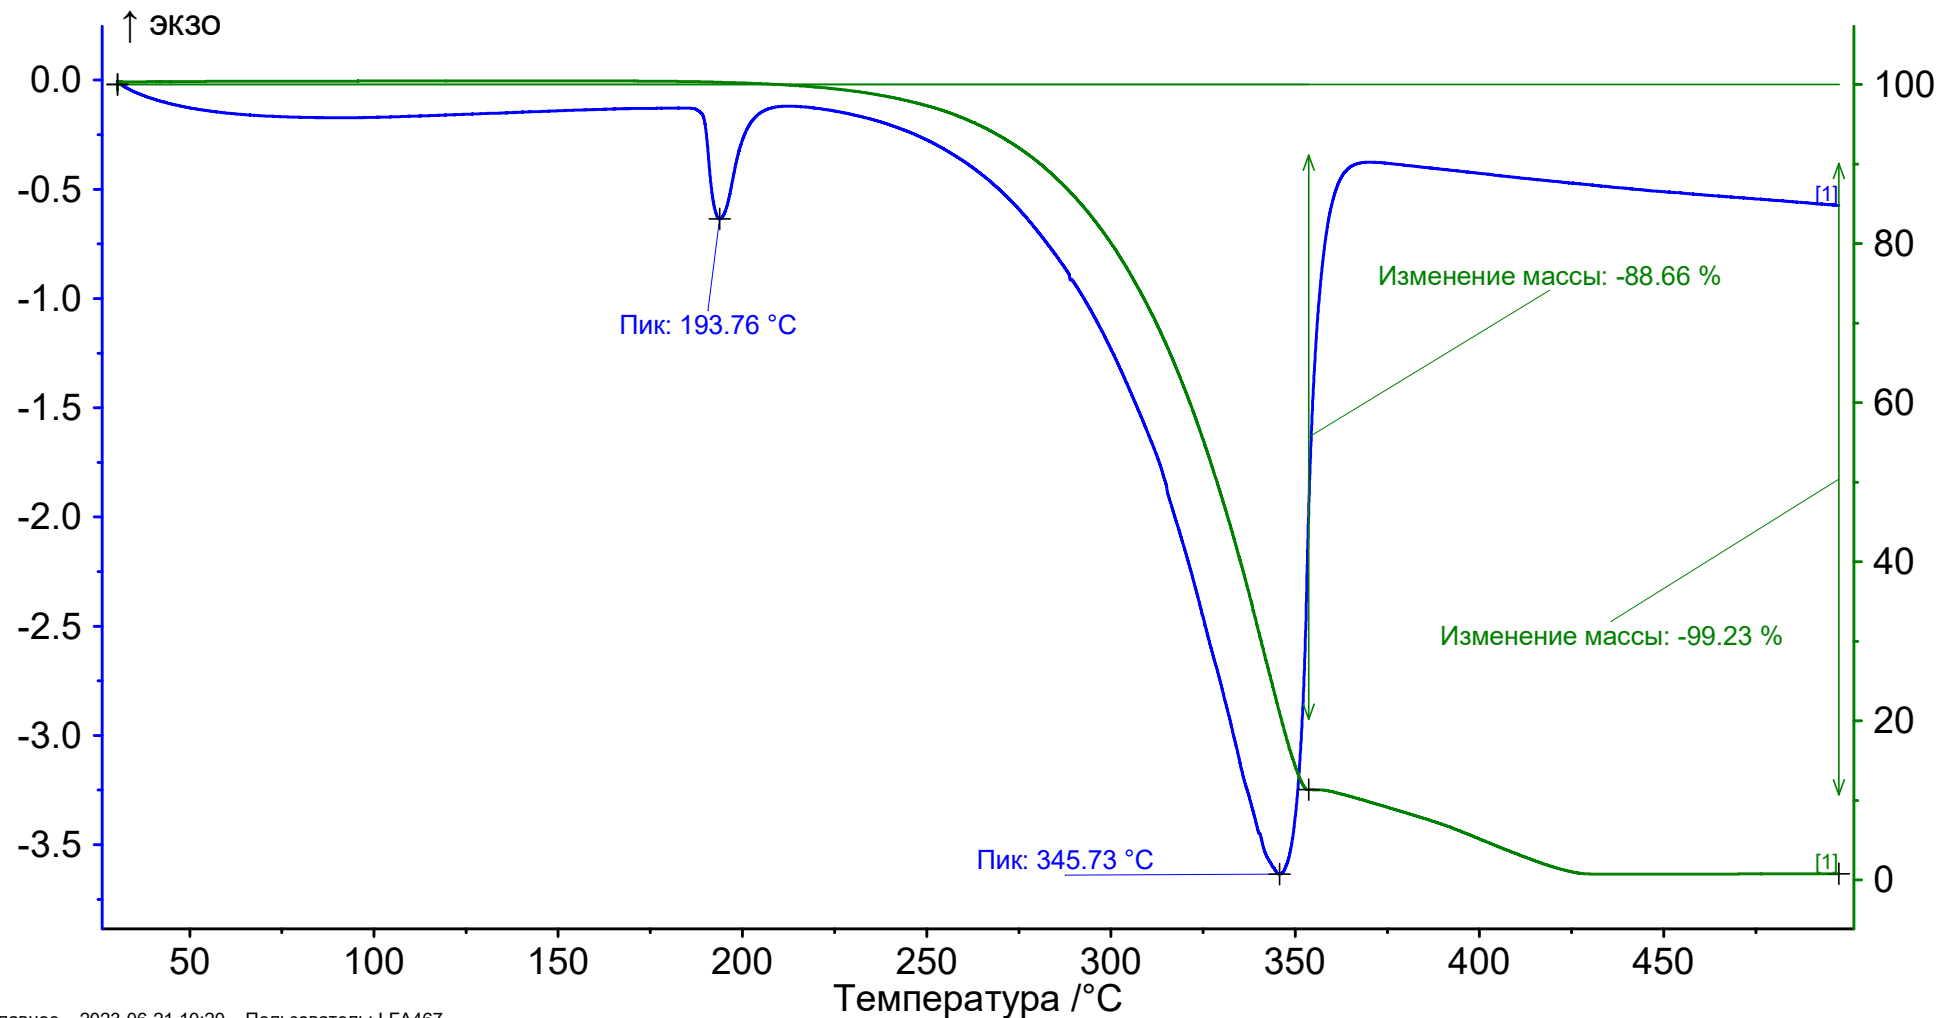

Главное 2023-06-21 10:20 Пользователь: LFA467

Прибор : NETZSCH STA 449F5 STA449F5A-0197-M

Файл : C:\NETZSCH\Proteus61\data\20.06.23_NH4Cl_5kmin_30+500_N2-120.ngb-ds5

Проект :	Материал :	Сегменты :	1/1
Код образца : NH4Cl	Файл коррекции : 10.05.23_correction for composite-5kmin_30-500C.ngb-bs5	Тигель :	DSC/TG pan Al2O3
Дата/время : 20.06.2023 10:51:28	Темп. кал./Файлы чувст. : 5kmin-N2_washer+Al2O3+cover.ngb-ts5 / 5kmin-N2_washer+Al2O3+cover.ngb-es5	Атмосфера :	N2 / N2
Лаборатория :	Диапазон : 30°C/5.0(К/мин)/500°C	ТГ корр./диап. измер. :	020/35000 мг
Оператор :	Прободерж./ТП : DSC/TG Std S / S	ДСК корр./диап. измер. :	020/5000 мкВ
Образец : 1, 29.2945 мг	Режим/тип измер. : ДСК-ТГ / образец с коррекцией		

Создано программным обеспечением NETZSCH Proteus