


ДСК /(мВт/мг)

↑ ЭКЗО

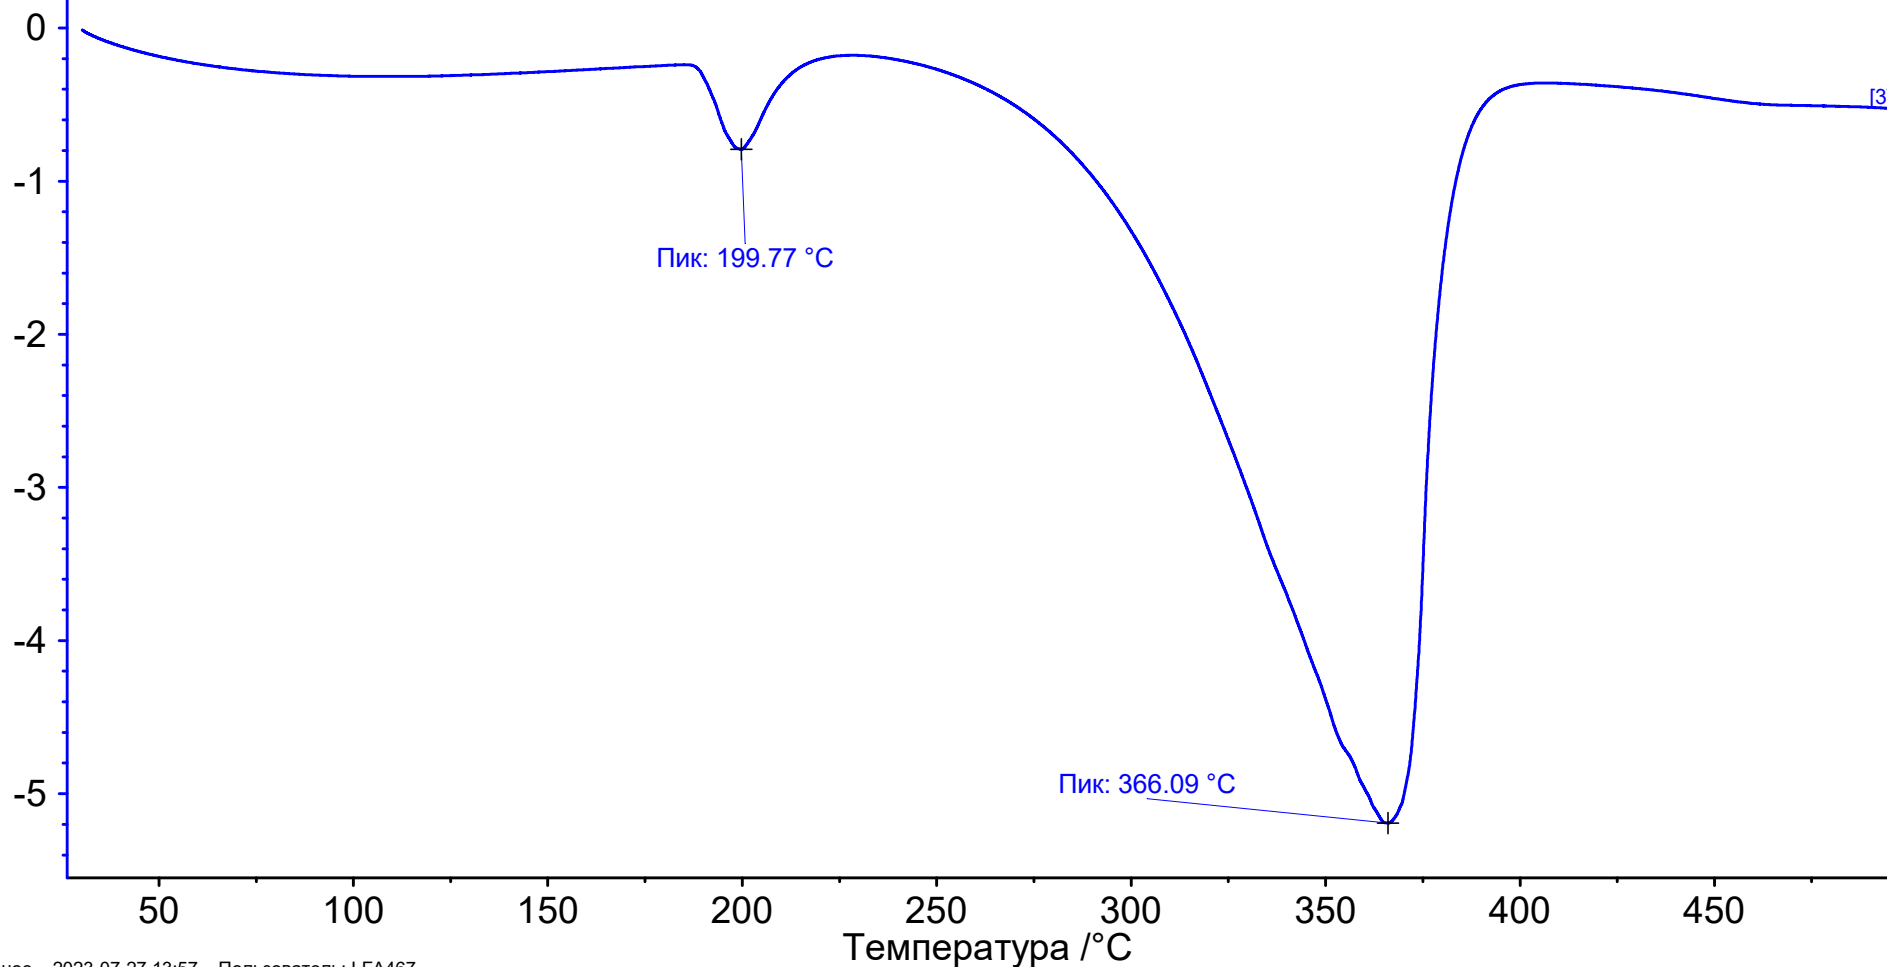

Главное 2023-07-27 13:57 Пользователь: LFA467

Прибор : NETZSCH STA 449F5 STA449F5A-0197-M

Файл : C:\NETZSCH\Proteus61\data\26.07.23_NH4Cl_XЧ_10kmin_30-500C.ngb-ds5

Проект :	Материал :	Сегменты :	1/1
Код образца : NH4Cl_XЧ	Файл коррекции : 29.04.22_correction for composite-10kmin_30+500_N2-120.ngb-bs5	Тигель :	DSC/TG pan Al2...
Дата/время : 26.07.2023 10:30:...	Темп. кал./Файлы чувст. : 10kmin-N2_washer+Al2O3+cover.ngb-ts5 / 10kmin-N2_washer+Al2O3+cover.ngb-ts5.ngb-...	Атмосфера :	N2 / N2
Лаборатория :	Диапазон : 30°C/10.0(К/мин)/500°C	ТГ корр./диап. измер. :	020/35000 мг
Оператор :	Прободерж./ТП : DSC/TG Std S / S	ДСК корр./диап. измер. :	020/5000 мкВ
Образец : 1, 23.8825 мг	Режим/тип измер. : ДСК-ТГ / образец с коррекцией		

Создано программным обеспечением NETZSCH Proteus