


ДСК /(мВт/мг)

↑ ЭКЗО

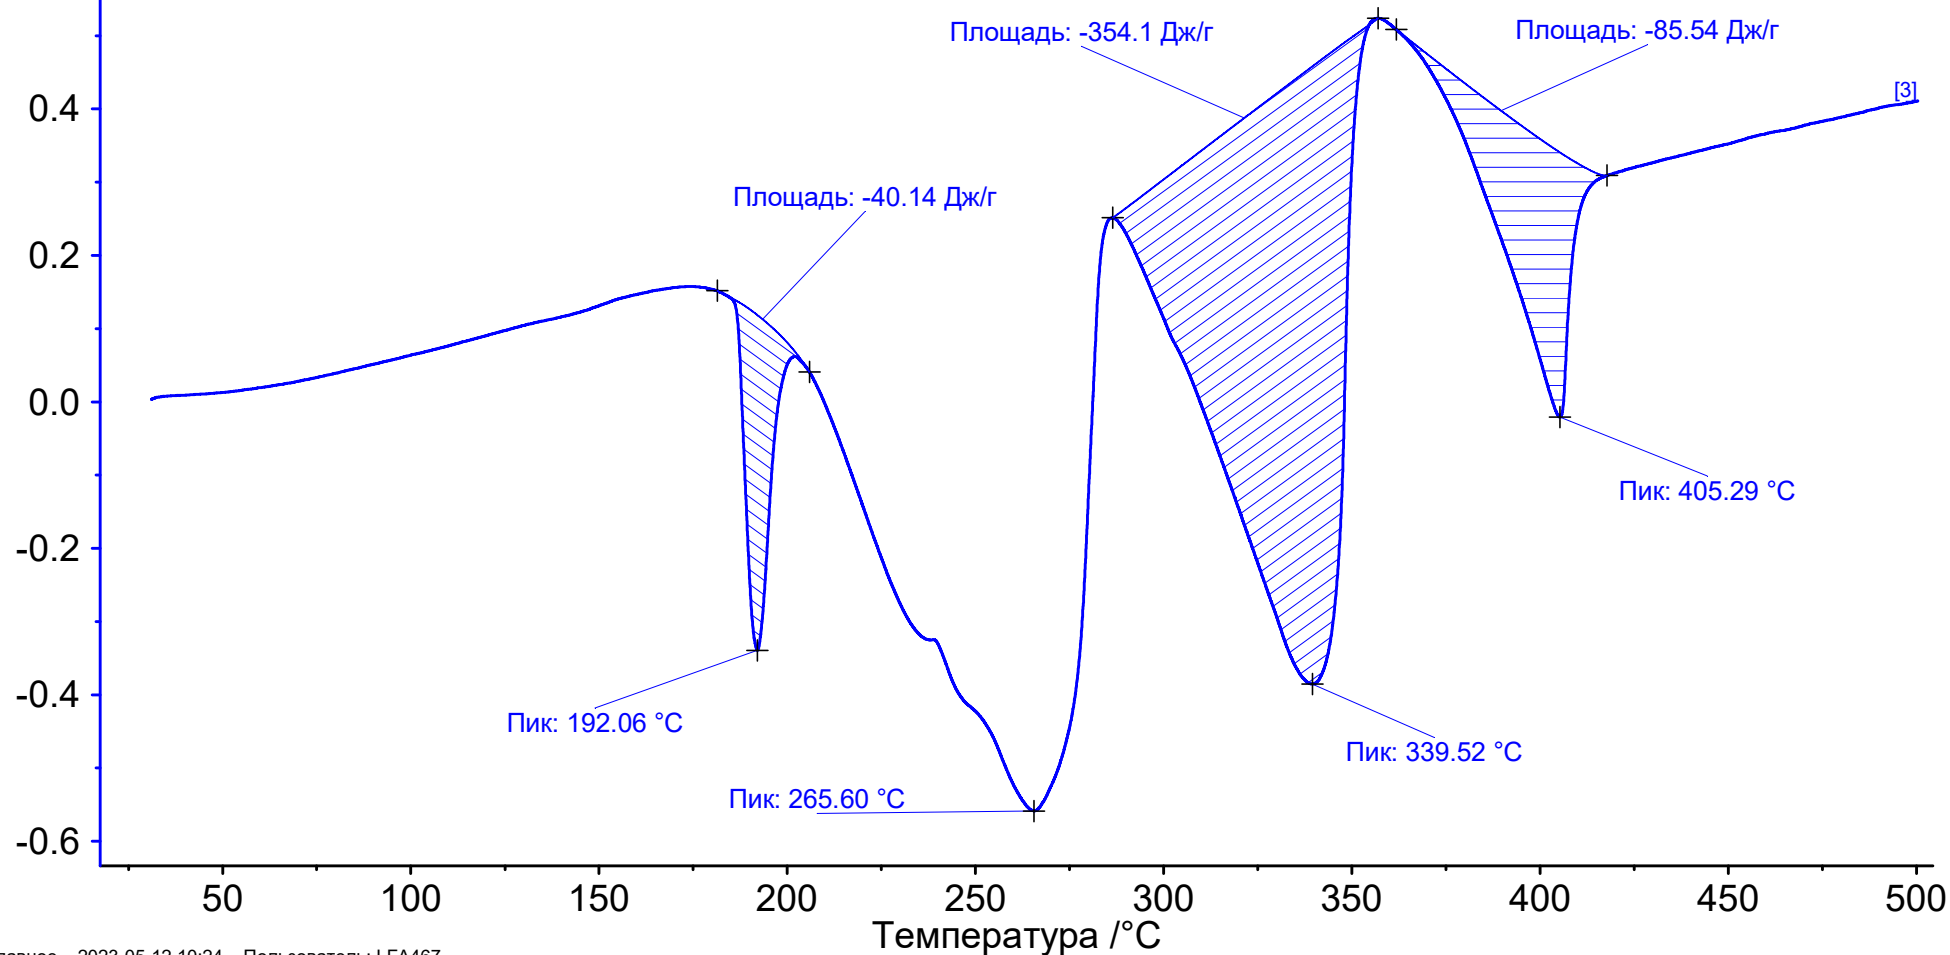

Главное 2023-05-12 10:24 Пользователь: LFA467

Прибор : NETZSCH STA 449F5 STA449F5A-0197-M

Файл : C:\NETZSCH\Proteus61\data\04.05.23_Dy_1,5+3_5kmin_30+1000_N2-120.ngb-ds5

Проект :

Материал :

Сегменты :

1/1

Код образца : Dy_1,5+3

Файл коррекции :

18.04.23_correction for composite-5kmin_30-1000C.ngb-bs5

Тигель :

DSC/TG pan Al2O3

Дата/время : 04.05.2023 11:29:49

Темп. кал./Файлы чувст. :

5kmin-N2_washer+Al2O3+cover.ngb-ts5 / 5kmin-N2_washer+Al2O3+cover.ngb-es5

Атмосфера :

N2 / N2

Лаборатория :

Диапазон :

30°C/5.0(К/мин)/1000°C

ТГ корр./диап. измер. :

720/35000 мг

Оператор :

Прободерж./ТП :

DSC/TG Std S / S

ДСК корр./диап. измер. :

720/5000 мкВ

Образец : 1, 25.0075 мг

Режим/тип измер. :

ДСК-ТГ / образец с коррекцией

Создано программным обеспечением NETZSCH Proteus