


ДСК /(мВт/мг)

↑ ЭКЗО

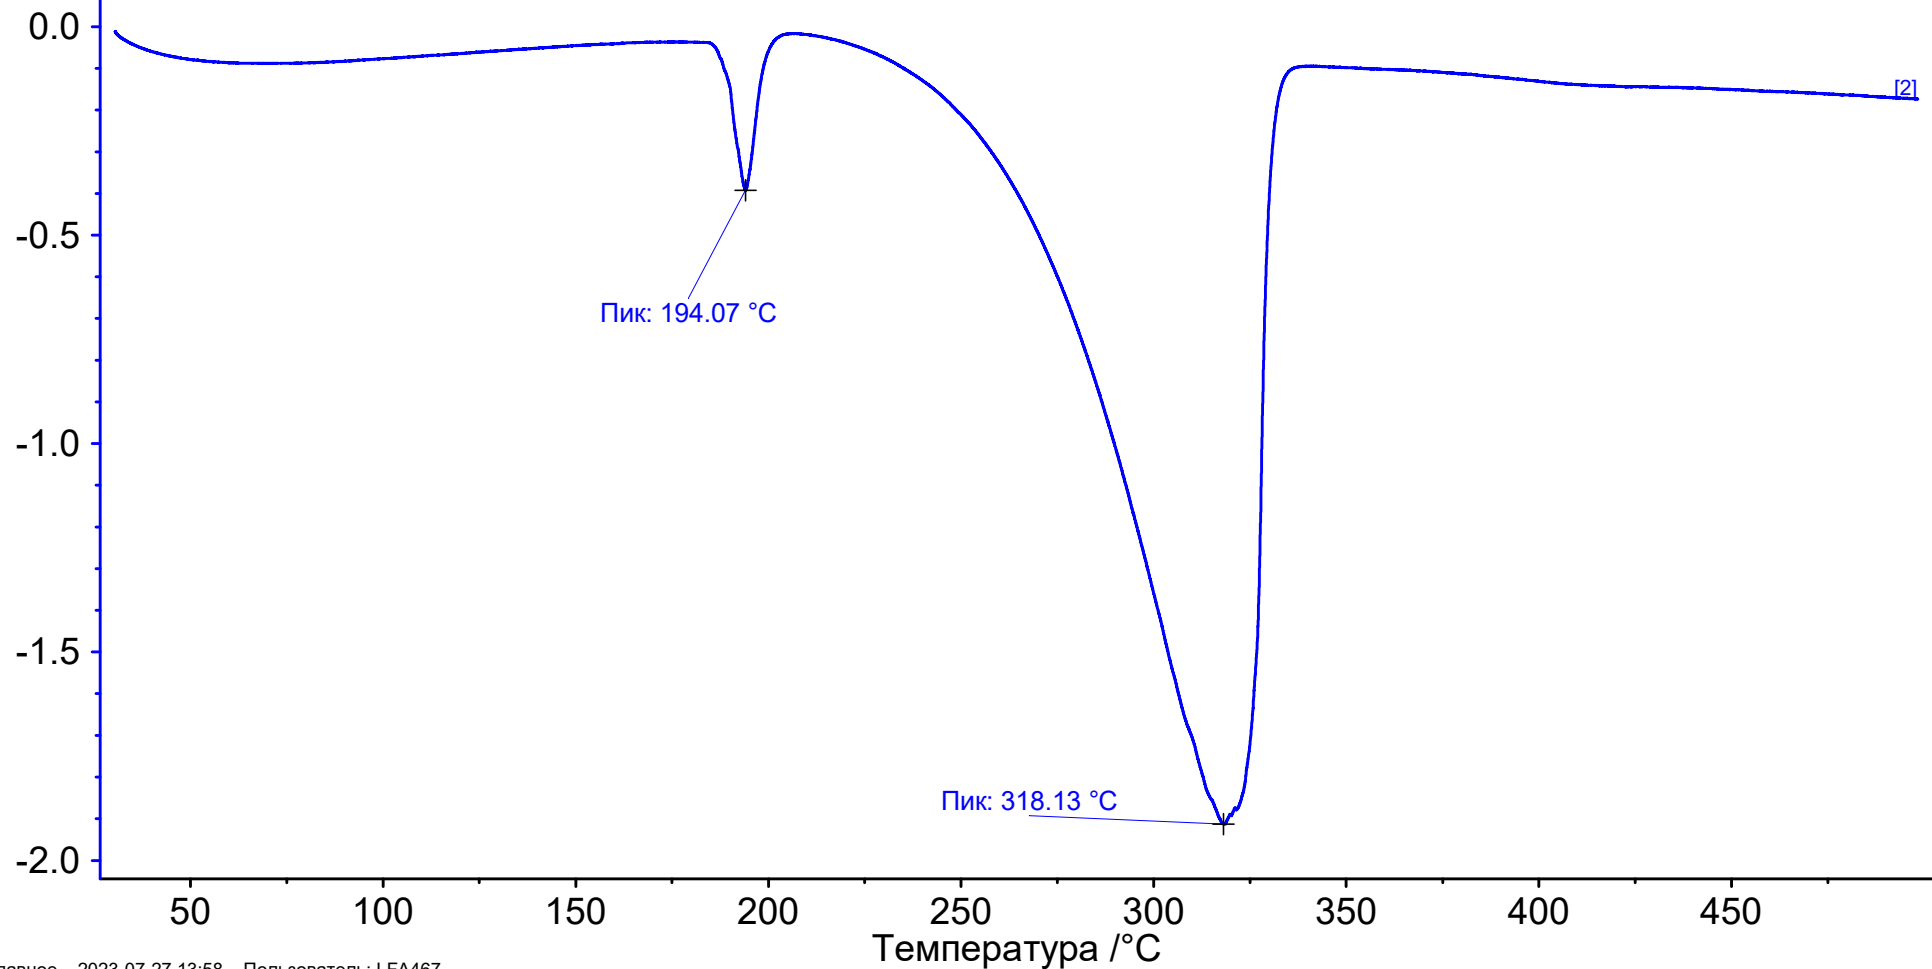

Главное 2023-07-27 13:58 Пользователь: LFA467

Прибор : NETZSCH STA 449F5 STA449F5A-0197-M

Файл : C:\NETZSCH\Proteus61\data\26.07.23_NH4Cl_XЧ_3kmin_30-500C.ngb-ds5

Проект :

Материал :

Сегменты :

1/1

Код образца : NH4Cl_X4

Файл коррекции : 11.05.23_correction for composite-3kmin_30-500C.ngb-bs5

Тигель : DSC/TG pan Al2O3

Дата/время : 26.07.2023 13:34:14

Темп. кал./Файлы чувст. : 3kmin-N2_washer+Al2O3+cover.ngb-ts5 / 3kmin-N2_washer+Al2O3+cover.ngb-es5

Атмосфера : N2 / N2

Лаборатория :

Диапазон : 30°C/3.0(К/мин)/500°C

ТГ корр./диап. измер. : 020/35000 мг

Оператор :

Прободерж./ТП : DSC/TG Std S / S

ДСК корр./диап. измер. : 020/5000 мкВ

Образец : 1, 21.8907 мг

Режим/тип измер. : ДСК-ТГ / образец с коррекцией

Создано программным обеспечением NETZSCH Proteus