


ДСК /(мВт/мг)

↑ ЭКЗО

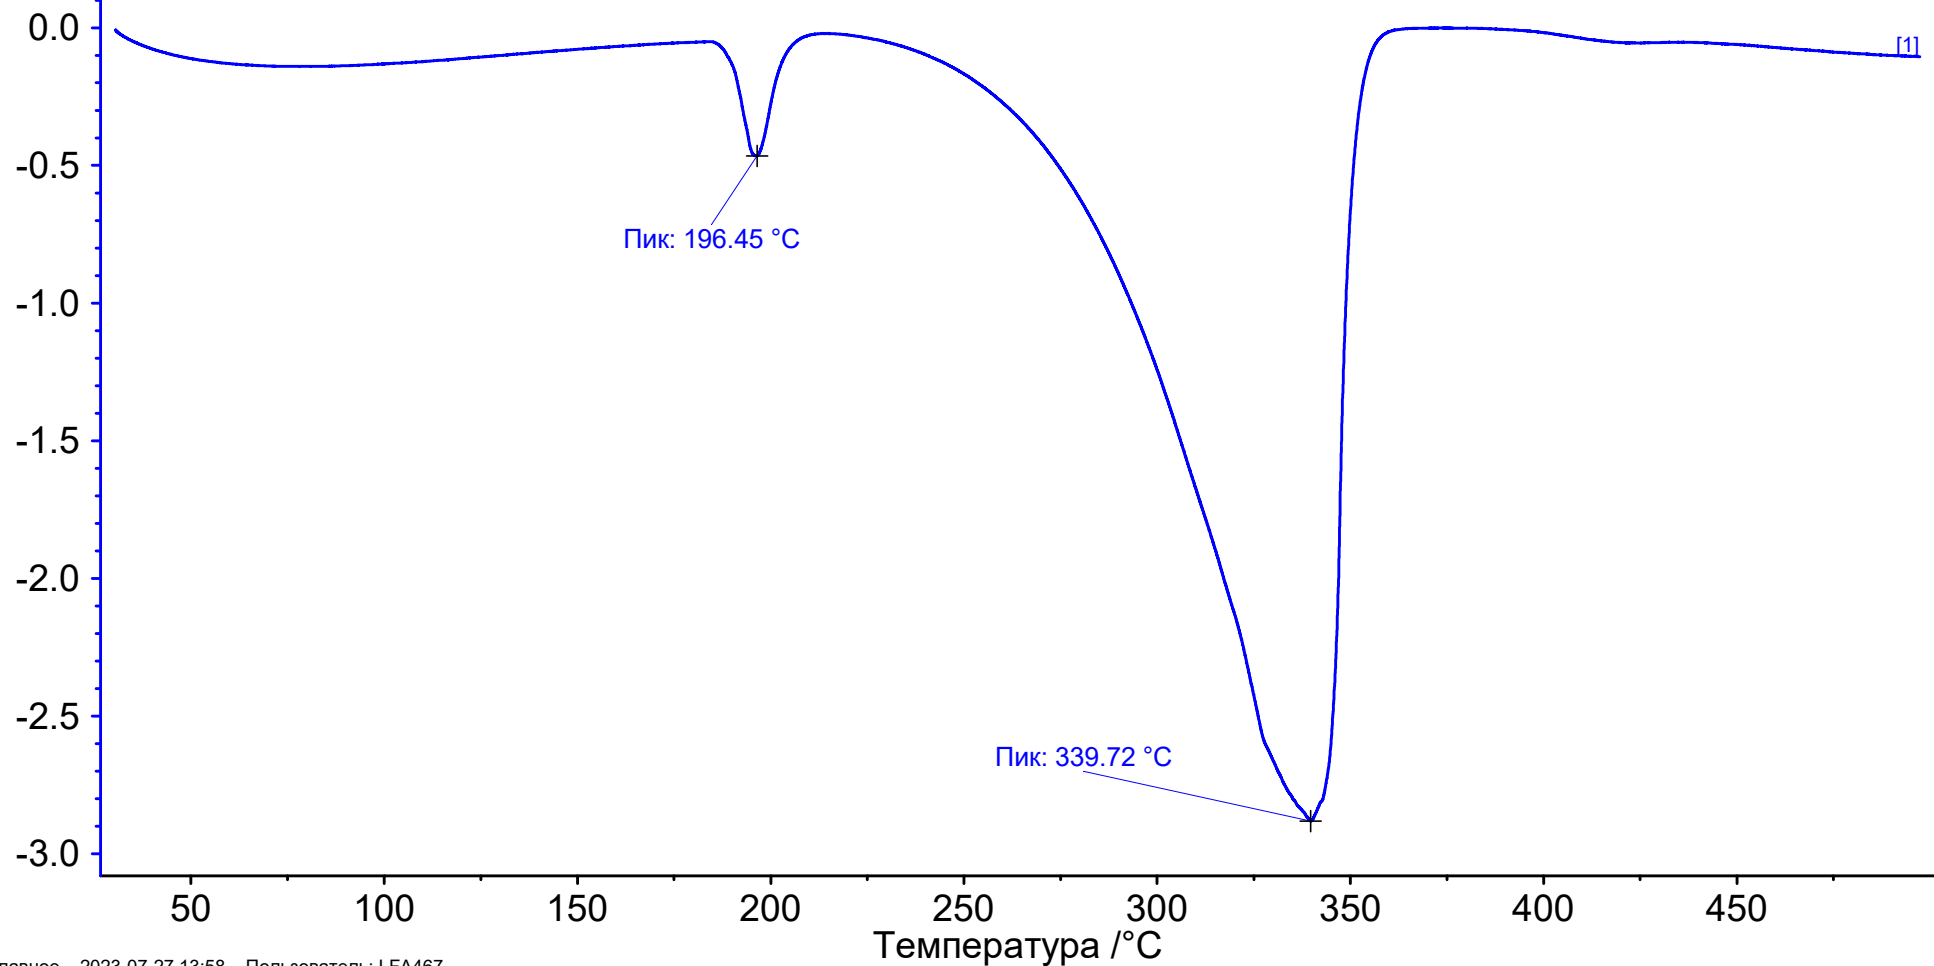

Главное 2023-07-27 13:58 Пользователь: LFA467

Прибор : NETZSCH STA 449F5 STA449F5A-0197-M

Файл : C:\NETZSCH\Proteus61\data\27.07.23_NH4Cl_XЧ_5kmin_30-500C.ngb-ds5

Проект :	Материал :	Сегменты :
Код образца : NH4CL_XЧ	Файл коррекции : 10.05.23_correction for composite-5kmin_30-500C.ngb-bs5	Тигель : DSC/TG pan Al2O3
Дата/время : 27.07.2023 11:48:33	Темп. кал./Файлы чувст. : 5kmin-N2_washer+Al2O3+cover.ngb-ts5 / 5kmin-N2_washer+Al2O3+cover.ngb-es5	Атмосфера : N2 / N2
Лаборатория :	Диапазон : 30°C/5.0(К/мин)/500°C	ТГ корр./диап. измер. : 020/35000 мг
Оператор :	Прободерж./ТП : DSC/TG Std S / S	ДСК корр./диап. измер. : 020/5000 мкВ
Образец : 1, 22.8865 мг	Режим/тип измер. : ДСК-ТГ / образец с коррекцией	

Создано программным обеспечением NETZSCH Proteus