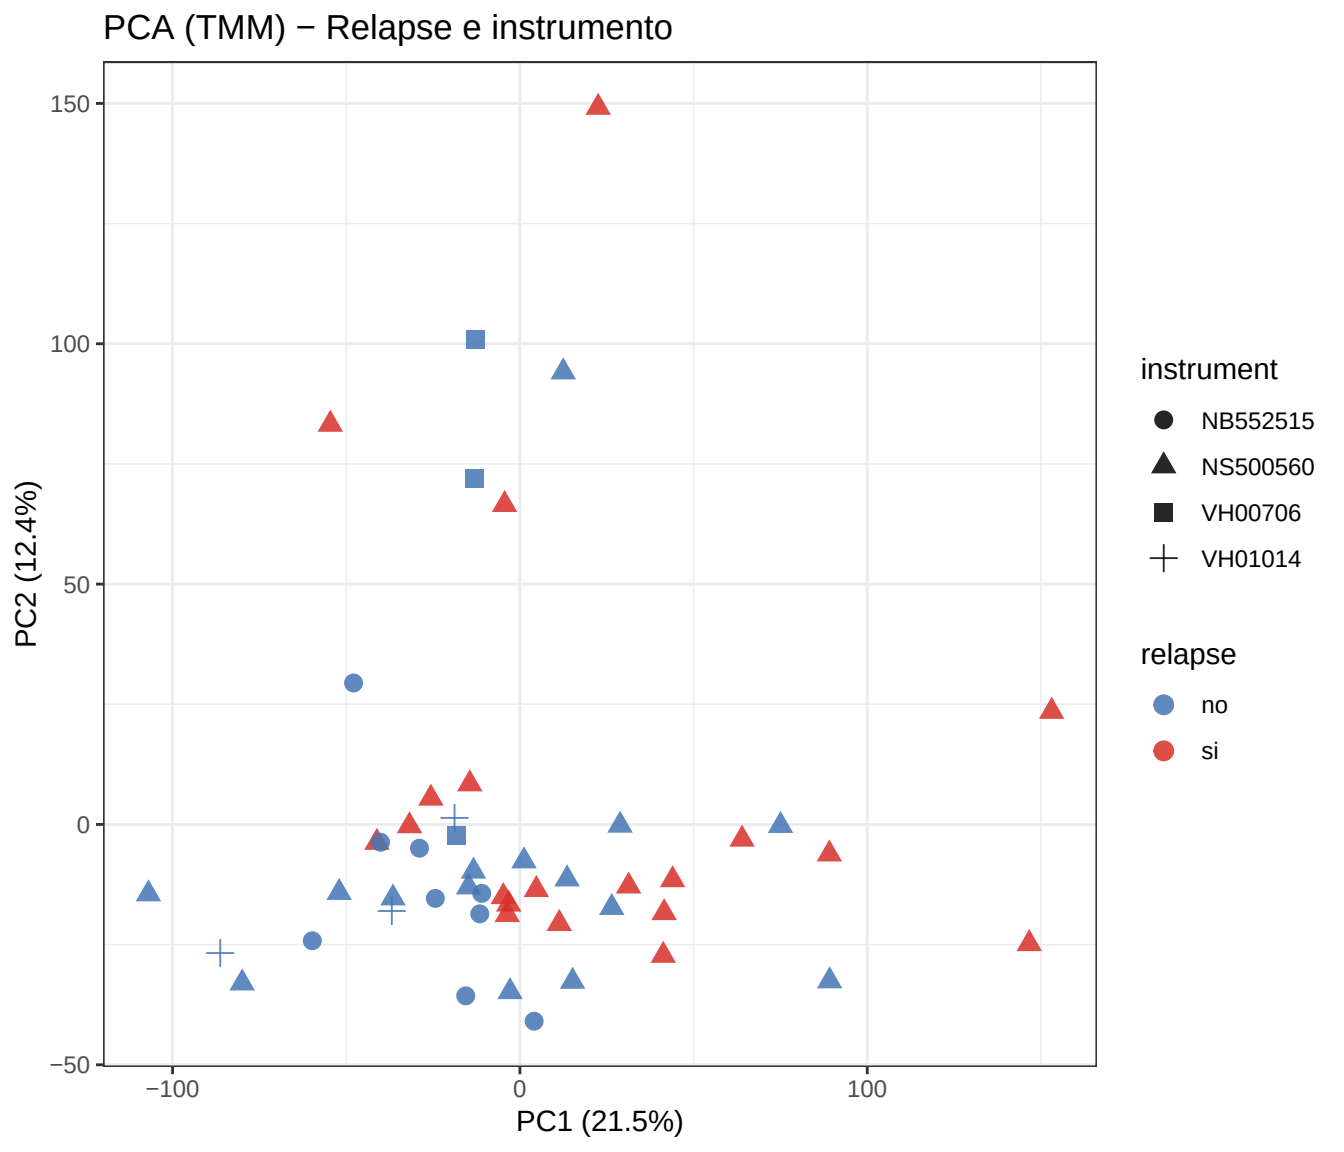
PCA (TMM) − Relapse e instrumento
150
100
50
0
−50
PC2 (12.4%)
−100
0
100
PC1 (21.5%)
instrument
NB552515
NS500560
VH00706
VH01014
relapse
no
si