

LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°252-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERU S.A.C. **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-23.02
DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, **RECEPCIÓN N°** : 552- 25
PROYECTO ** : LS3777_CA_PRIMER_CHACAMARCA **FECHA EMISIÓN** : 2025-05-12
UBICACIÓN ** : PREDIO RÚSTICO DENOMINADO PASAJE PATA RIO TUPIN, DIST. SAMAN, AZÁNGARO, PUNO

** Datos proporcionados por el cliente


Standard Test Methods for Liquid Limit, Plastic Limit and Plasticity Index of Soils

ASTM D4318-17^{E1}

DATOS DE LA MUESTRA

CANTERA/SONDAJE * : C-3 CODIGO DE LA MUESTRA : 862-SU-25
N° MUESTRA ** : M-1 FECHA DE RECEPCIÓN : 2025-05-07
TIPO DE MUESTRA : SUELO FECHA DE EJECUCIÓN : 2025-05-08
LUGAR DE ENSAYO : Laboratorio de Ensayo de Materiales

DESCRIPCIÓN	und	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO	
N° Ensayo	N°	1	2	3	1	2
N° Recipiente	N°	LM-15	LM-1	LM-3	LM-09	LM-8
N° de Golpes	N°	30	24	15		
Masa del recipiente y suelo Humedo	g	50.39	58.15	59.06	30.21	32.92
Masa del recipiente y suelo Seco	g	43.29	51.60	51.48	29.21	31.74
Masa del Recipiente	g	25.42	35.89	34.20	23.51	25.18
Masa del Agua	g	7.10	6.55	7.58	1.00	1.18
Masa del Suelo Seco	g	17.87	15.71	17.28	5.70	6.56
Contenido de Humedad	%	39.7	41.7	43.9	17.5	18.0

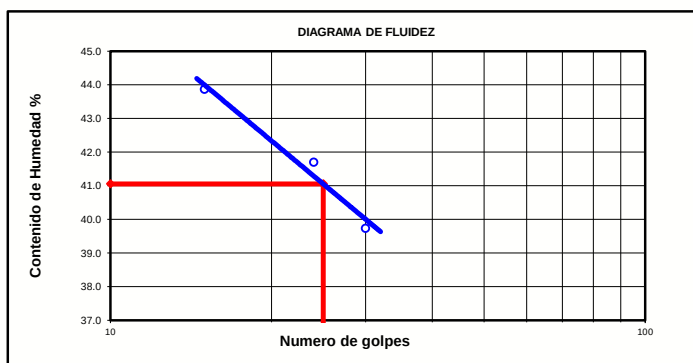

Límite Líquido **41**

Límite Plástico **18**

Índice de Plasticidad **23**


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.





Ingeniería
y laboratorio
de suelos

LABORATORIO DE ENSAYO ACREDITADO POR EL
ORGANISMO DE ACREDITACIÓN INACAL - DA
CON REGISTRO N° LE - 184



LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES

INFORME DE ENSAYO N°252-25 SU23

CLIENTE : SITES DEL PERU S.A.C.

CÓDIGO : F-LEM-P-SU-23.02

DIRECCIÓN ** : JR. CARLOS PORTOCARRERO No. 262, PISO 11, URB. SANTA CATALINA, DIST. LA VICTORIA, RECEPCIÓN N° : 552- 25

PROYECTO ** : LS3777_CA_PRIMER_CHACAMARCA

FECHA EMISIÓN : 2025-05-12

UBICACIÓN ** : PREDIO RÚSTICO DENOMINADO PASAJE PATA RIO TUPIN, DIST. SAMAN, AZÁNGARO, PUNO

** Datos proporcionados por el cliente

Condiciones del ensayo

- Método de ensayo en el Límite Líquido
- Herramienta de ranurado para el límite líquido
- Dispositivo para el límite líquido
- Método de laminación para el Límite Plástico
- Proceso de selección en caso de muestras Intacta, se retiró lentes de arena
- Método de preparación de la muestra de ensayo

Multipunto
Metal
Manual
Manual
No se retiró
Húmedo

Descripción de la muestra

- Tipo de muestra:
- Condición de la muestra:
- Tamaño máximo de partícula, (in):
- Porcentaje de la muestra retenido en el tamiz No. 40 (%)
- Forma de la partícula:
- Contenido de humedad natural ASTM D2216-19

SUELO
Alterado
No.4
2.3%
Angular
34.8%

Ref. Informe N°860-25 SU20

Nota:

- Los datos de identificación de la muestra son proporcionados por el cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre la muestra proporcionada por el cliente.
- Los resultados de los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad con normas de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

Observaciones:


IRMA COAQUIRA LAYME
Ingeniero Civil CIP 121204
Laboratorio Geofal S.A.C.

