
A - A (1 : 1), Schnitt durch den Kontakt bei 20°

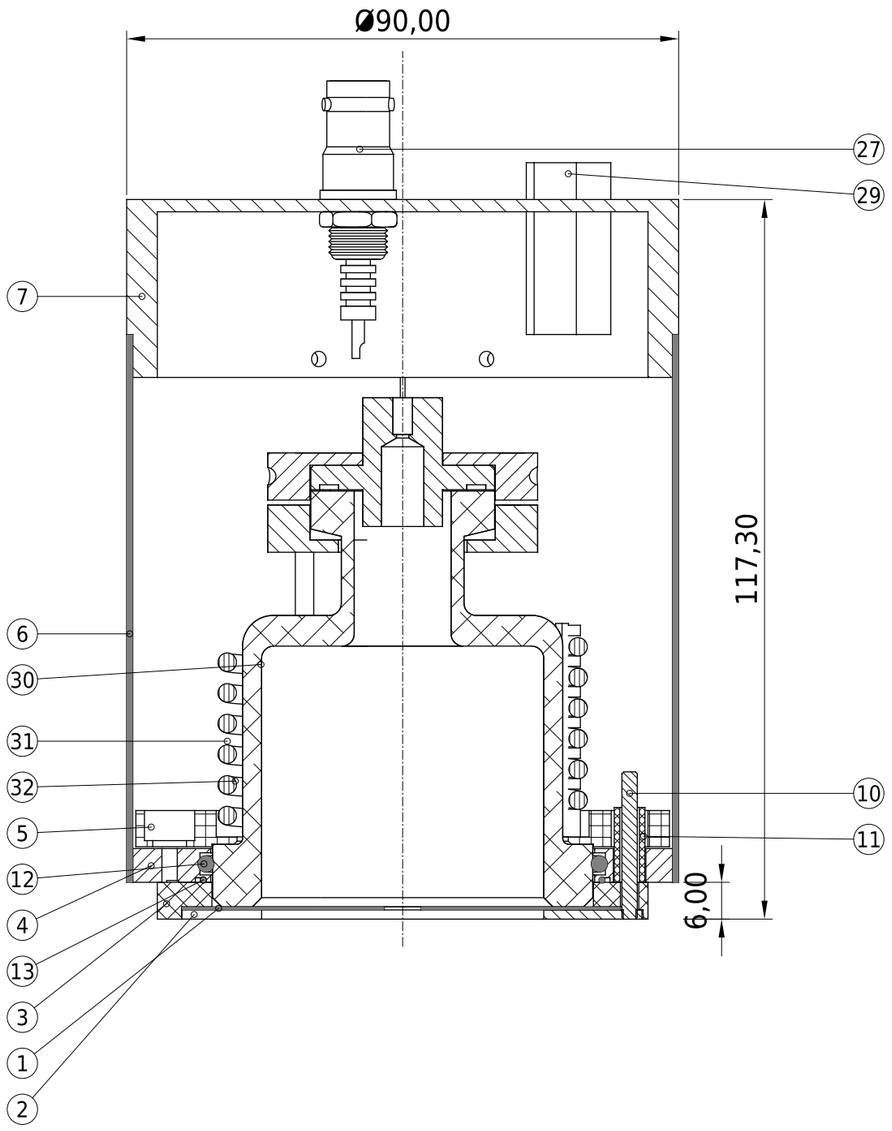

Stückliste				
Pos.	Menge	Benennung	Norm / Teil-Nr.	Werkstoff
1	1	Blende	101	Mo
2	1	Klemmring	102	1.4301
3	1	Träger	103	GFK
4	1	Edelstahlring	104	1.4301
5	1	GFK-Ring oben	105	GFK
6	3	Abdeckblech	106	EN AW-5754
7	1	Deckel	107	EN AW-6082
8	9	Distanzhülse	108	1.4301
9	9	Federscheibe	109	1.4301
10	1	Kontaktbolzen M2,5 × 24	110	A2-70
11	1	Keramikhülse	111	Al2O3
12	1	O-Ring 61,5 × 2,65	DIN 3771	FFKM
13	1	O-Ring 64 × 1		FFKM
14	9	Druckfeder Ø7/Ø5,3, L0 5,3, ~8 N/mm	Katalog	1.4310
15	6	Senkschraube M2 × 4	ISO 14581	A2
16	3	Senkschraube M2,5 × 10	ISO 14581	A2
17	3	Zylinderschraube M2 × 10	ISO 4762	A2
18	9	Zylinderschraube M3 × 10, versilbert	DIN 7984	A2
19	12	Zylinderschraube M3 × 5, versilbert	ISO 4762	A2
20	21	Scheibe 3	ISO 7089	A2
21	2	Sechskantmutter M2,5	ISO 4032	A2
22	1	Ringkabelschuh M2,5		Cu verzinnt
23	1	Zylinderstift 2 × 8	ISO 8734	1.4305
24	9	HELICOIL Tangfree M2 × 1d (6 Träger, 3 Platte)		A2
25	3	HELICOIL Tangfree M2,5 × 2d		A2
26	1	Frontplatte, Bereich RFN (Bearbeitung)	vorhanden	Al
27	2	SHV-Buchse PE4239	Pasternack	
28	1	N-Buchse, Einbau von innen		
29	1	Schottverschraubung 1/8 Zoll SS-200-61	Swagelok	1.4401
30	1	Quarzglasgefäß mit Klemmung	vorhanden	
31	1	Spule, 5,9 Windungen, Draht Ø3	113	Cu
32	1	Spulenstäbe (Satz 4)	112	GFK, s. Hinweis

Federschrauben (8, 9, 14, 18, 20) liegen auf Ø76 bei 0° + n·40°,
nicht in der Schnittebene. Spule in den vier Spulenstäben, Stäbe auf dem Glasfuß.

Teil-Nr.	Anzahl
100	1x
Werkstoff:	siehe Stückliste

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

RFN Blendenaufnahme


Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Assembly.iam


Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

Draufsicht (2 : 1)

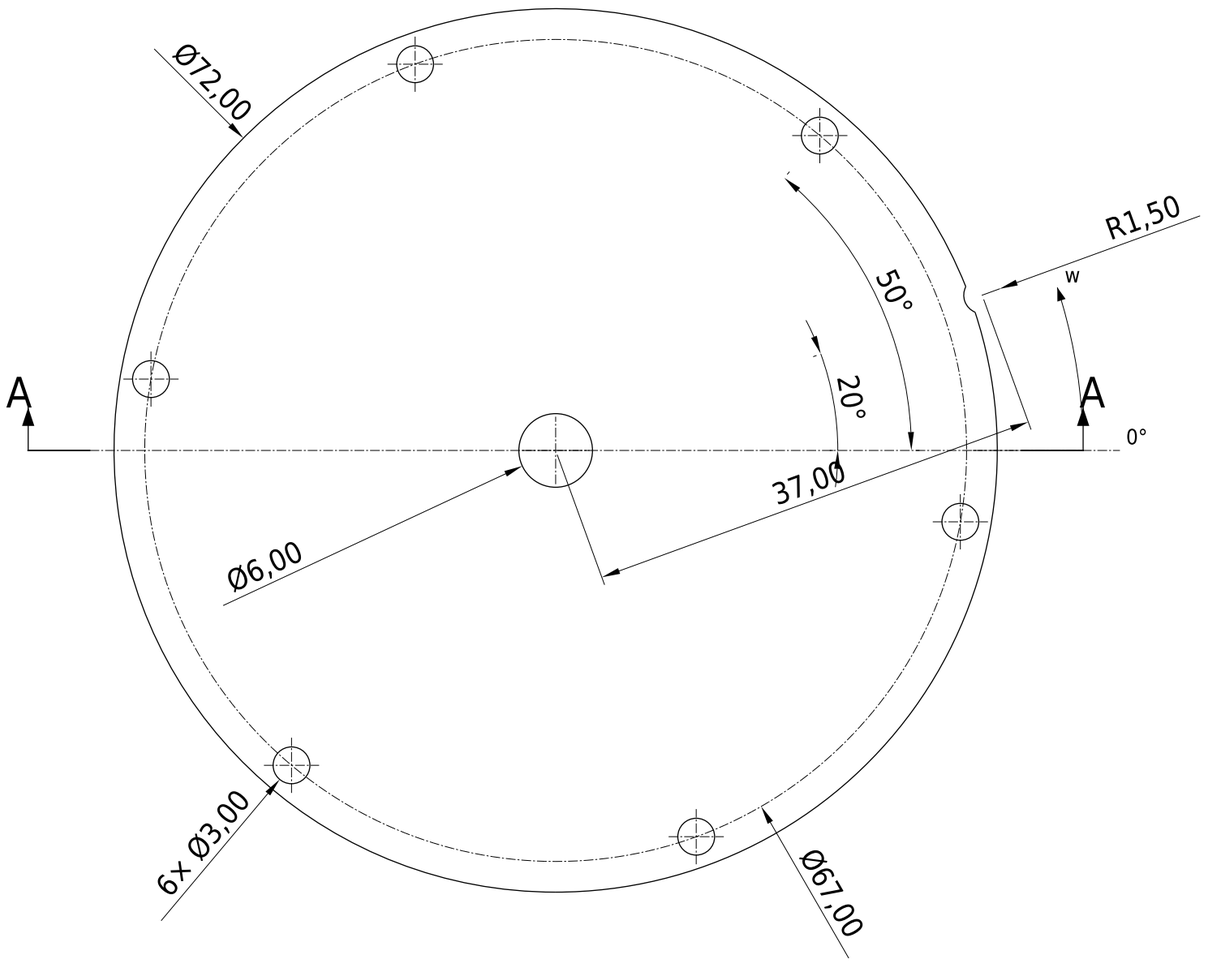

A - A (2 : 1)

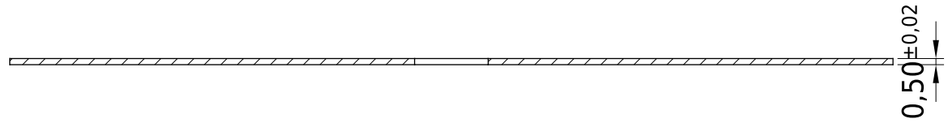

Hinweise

Fertigung CNC nach RFN_Blende.stp.
Zeichnung enthält Kontroll- und Funktionsmaße.
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Lasern oder drahterodieren, Kontur und Löcher in einem Zug.
Glasseite eben 0,02, gratfrei, keine Kratzer.
Lochbild ist Wechselteil: Löcher nur innerhalb Ø40.
Kerbe R1,5 bei r 37 / 20° gehört zu jeder Variante.
Winkel ab +X gegen den Uhrzeigersinn.
Erste Klemmbohrung bei 50°, dann alle 60°.

Teil-Nr.	Anzahl
101	1x
Werkstoff:	Molybdän

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Blende

Ansprechpartner


Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Blende.stp


Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER


Draufsicht, Blendenseite (2 : 1)

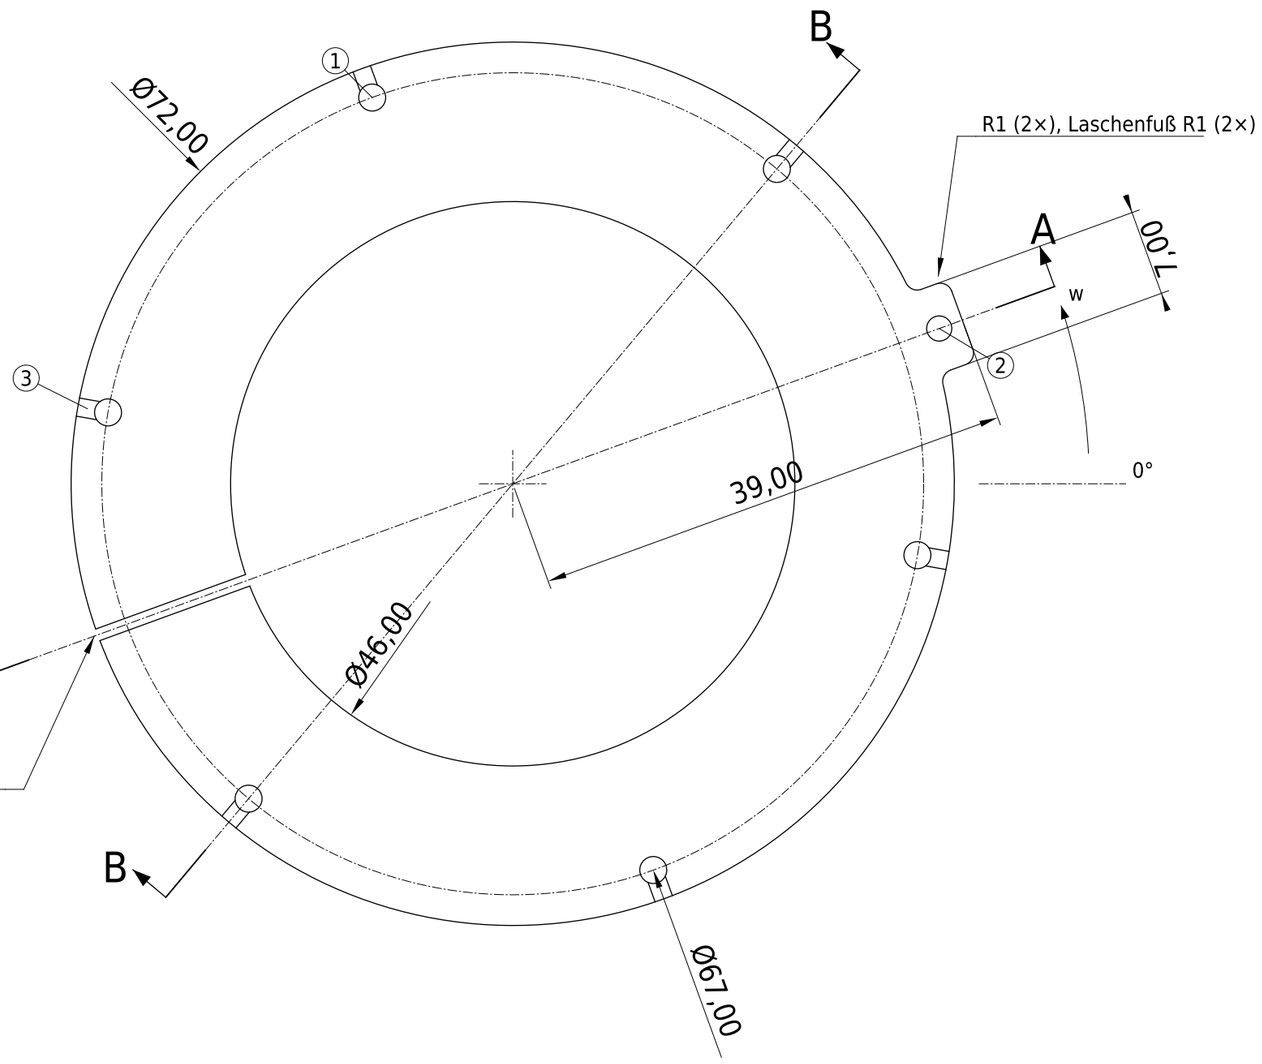

A - A (2 : 1)

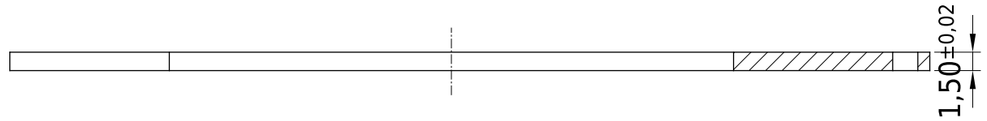

B - B (10 : 1)

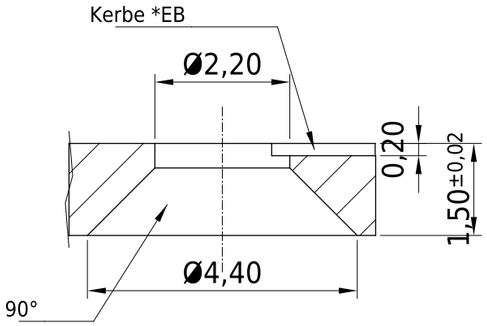

Bohrungen und Konturen				
	Element	Lage	Winkel	n
1	Ø2,2 durch, Senkung 90° Ø4,4 von unten	Ø67	50° + n·60°	6
2	M2,5 durch (Kontaktbolzen)	r 37	20°	1
3	Kerbe oben *EB 1,5 breit, 0,2 tief, Bohrungsmitte bis Rand	—	wie 1	6
—	Schlitz 1,0 durch, ganzer Ring	—	200°	1
—	Lasche 7,0 breit bis r 39,0, Ecken R1, Fuß R1	—	20°	1

Hinweise

Fertigung CNC nach RFN_Klemmring.stp.
Zeichnung enthält Kontroll- und Funktionsmaße.
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Gefräst, Fräser Ø2 für die Kontur, Ø1 für den Schlitz.
Rohteil Blech 2 mm, beidseitig auf 1,5 geschliffen, Ebenheit 0,02.
Blendenseite (oben) gratfrei, keine Kratzer.
Winkel ab +X gegen den Uhrzeigersinn, Blick auf die Blendenseite.

Teil-Nr.	Anzahl
102	1x
Werkstoff:	Edelstahl 1.4301

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Klemmring

Ansprechpartner

Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)


Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Klemmring.stp


Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER


A - A (2 : 1)

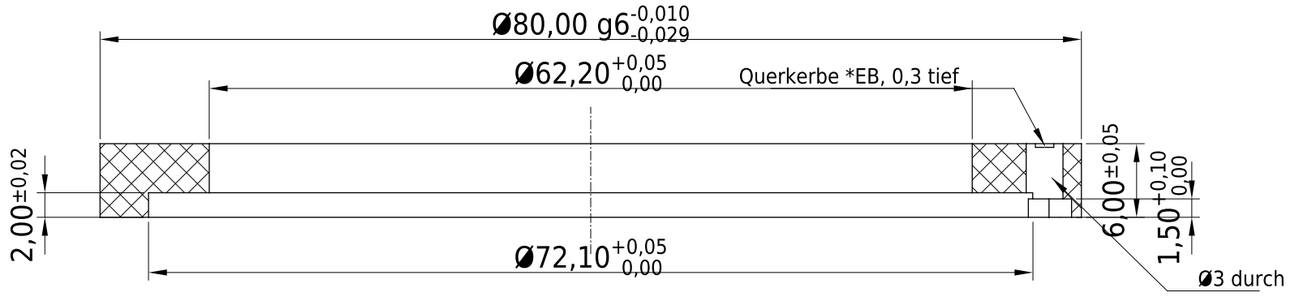


Draufsicht (1 : 1)

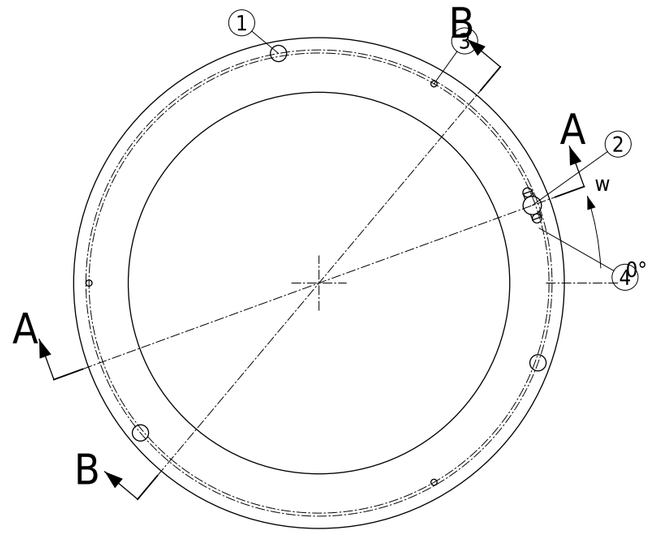

B - B (5 : 1)

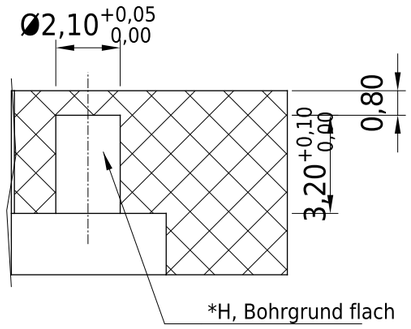

Ansicht von unten (1 : 1)

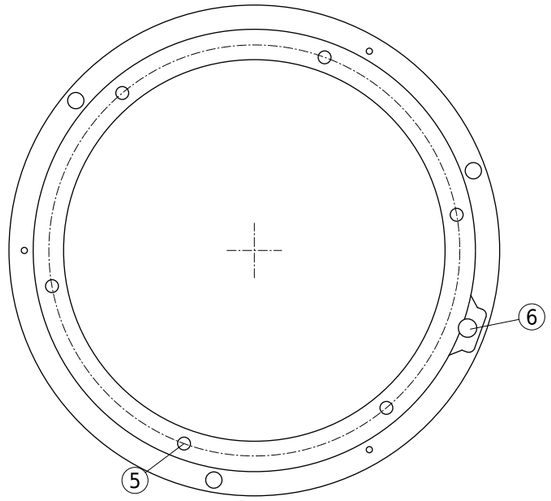

Bohrungen und Konturen				
	Element	Lage	Winkel	n
1	Ø2,65 durch *H (HELICOIL M2,5 2d, STI)	Ø76	100°, 220°, 340°	3
2	Ø3 durch (Kontaktbolzen)	r 37	20°	1
3	Ø1 durch *EB	Ø75	60°, 180°, 300°	3
4	Querkerbe oben *EB, Langloch 1,5 × 6, 0,3 tief, quer zum Radius	r 37	20°	1
5	Ø2,1 × 3,2 tief *H (HELICOIL M2 1d), von der Tasche, flach	Ø67	50° + n·60°	6
6	Freistich 7,4 breit, 1,5 tief, bis r 39,2, Ecken R1, Fase 1,5	—	20°	1

Hinweise

Fertigung CNC nach RFN_Traeger.stp.
Zeichnung enthält Kontroll- und Funktionsmaße.
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Drehteil, Fräsungen mit Fräser Ø2 und Ø1,5.
*H Gewinde STI nach HELICOIL-Datenblatt, Einsatz 0,2 versenkt.
Ø80 g6 passend zur Plattenbohrung H7.
Winkel ab +X gegen den Uhrzeigersinn, Blick von oben.

Teil-Nr.	Anzahl
103	1x
Werkstoff:	GFK (EP-Glashartgewebe)

Fachbereich 07		
2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Träger


Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Traeger.stp


Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER


A - A (2 : 1)

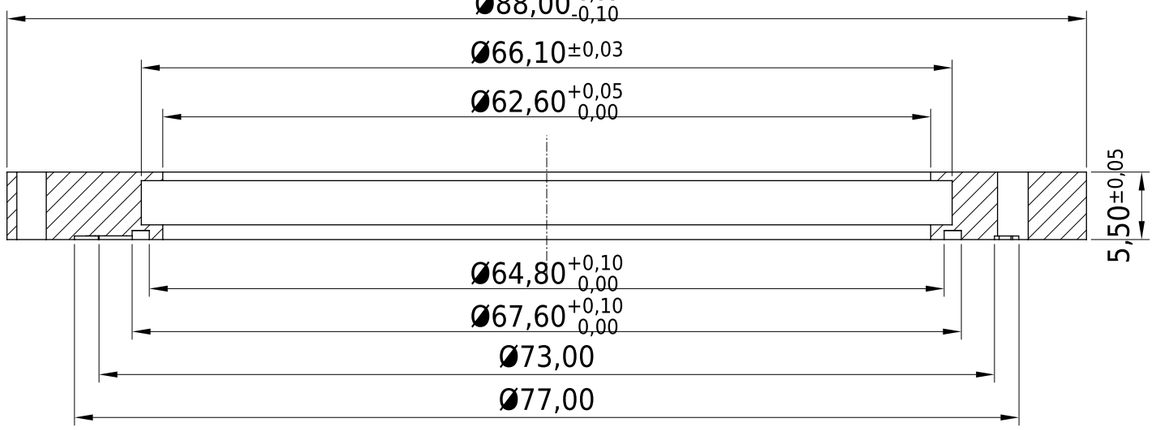


Draufsicht (1 : 1)

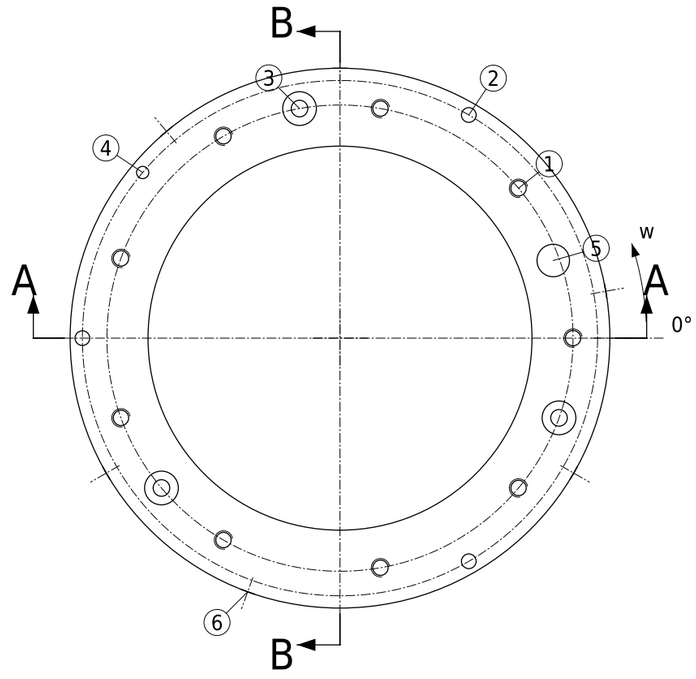

B - B (5 : 1)

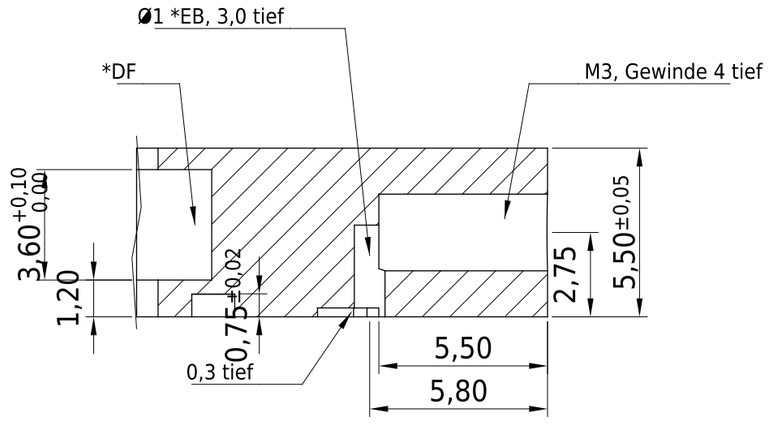

Ansicht von unten (1 : 1)

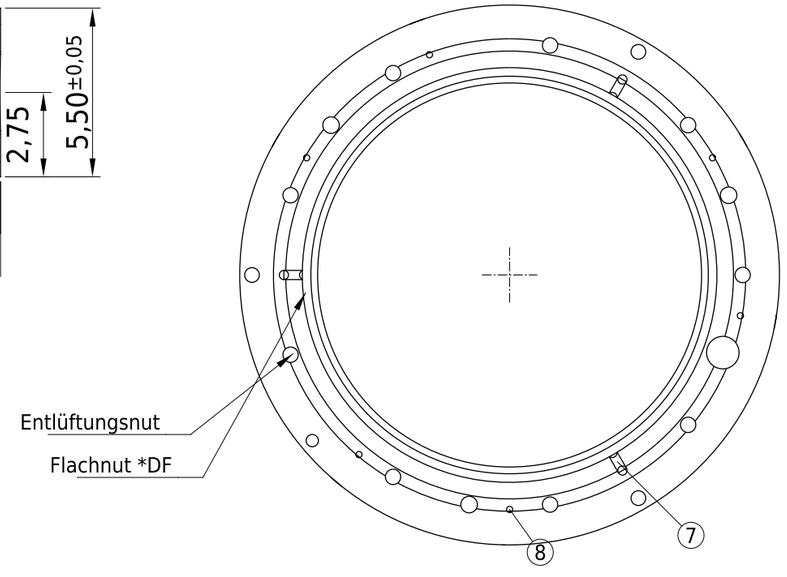

Bohrungstabelle				
	Bohrung	Lage	Winkel	n
1	M3 durch	Ø76	0° + n·40°	9
2	Ø2,4 durch	Ø84	60°, 180°, 300°	3
3	Ø2,7 durch, Senkung 90° Ø5,5 oben	Ø76	100°, 220°, 340°	3
4	Ø2 H7 durch (Passstift)	Ø84	140°	1
5	Ø5,3 durch (Keramikhülse)	r 37	20°	1
6	M3 radial, 4 tief, Bohrung 5,5, Mitte 2,75 ü. Unters.	außen	10°, 90°, 130°, 210°, 250°, 330°	6
7	Kerbe unten 1,5 breit, 0,3 tief, r 33,5 bis r 36,8	—	60°, 180°, 300°	3
8	Ø1 *EB von unten, 3,0 tief	r 38,2	wie 6	6

Teil-Nr.	Anzahl
104	1x
Werkstoff:	Edelstahl 1.4301

Hinweise

Fertigung CNC nach RFN_Edelstahlring.stp.
Zeichnung enthält Kontroll- und Funktionsmaße.
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
*DF Radialnut, Flachnut, Unterseite Ra 0,8.
Ober- und Unterseite planparallel 0,02.
Winkel ab +X gegen den Uhrzeigersinn, Blick von oben.
Ansicht von unten ist gespiegelt.

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Edelstahlring


Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Edelstahlring.stp


Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

A - A (2 : 1)

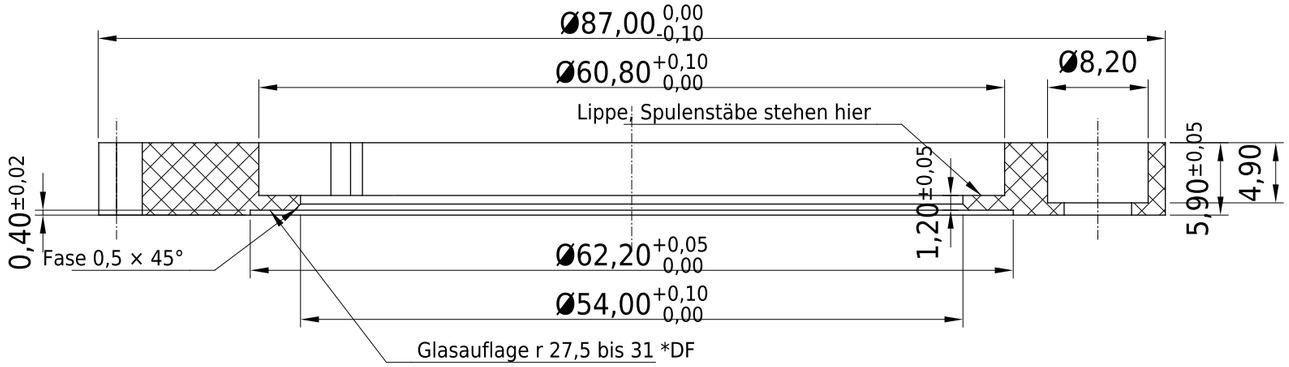

Draufsicht (1 : 1)

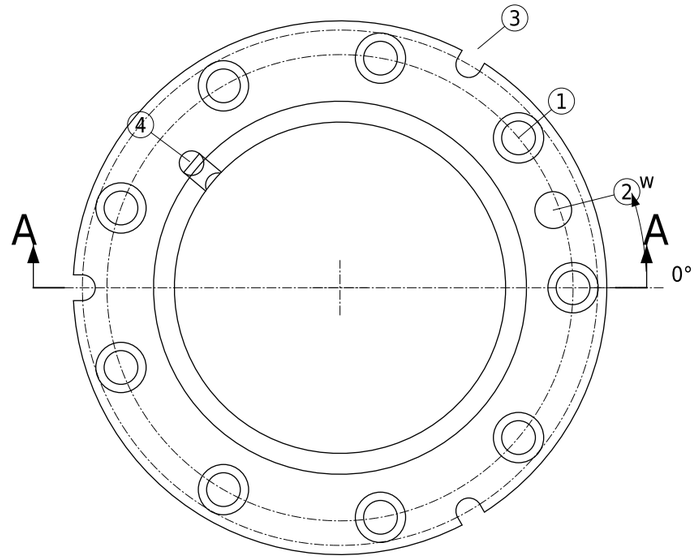

Hinweise

Fertigung CNC nach RFN_GFK_Ring_oben.stp.
Zeichnung enthält Kontroll- und Funktionsmaße.
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Drehteil, Randnuten mit Fräser Ø4.
Glasauflage *DF eben 0,02, Ra 1,6.
Glassenkung Ø62,2 zentriert den Ring auf dem Glasfuß.
Lippe Ø54 × 1,2 unter Spule und Stäben, darüber Bohrung Ø60,8 für die Spule.
Winkel ab +X gegen den Uhrzeigersinn, Blick von oben.

Bohrungen und Konturen

	Element	Lage	Winkel	n
1	Ø5,5 durch, Ansenkung Ø8,2 × 4,9 tief von oben	Ø76	0° + n·40°	9
2	Ø6 durch (Keramikhülse)	r 37	20°	1
3	Randnut 4,2 breit durch, inneres Ende R2,1 um Ø84, nach außen offen	Ø84	60°, 180°, 300°	3
4	Anschlussnut Spule 4 breit, 4,3 tief, Grund = Lippe oben	—	140°	1

Teil-Nr.	Anzahl
105	1x
Werkstoff:	GFK (EP-Glashartgewebe)

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

GFK-Ring oben


Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_GFK_Ring_oben.stp


Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER


Zuschnitt, vor dem Rollen (1 : 1)

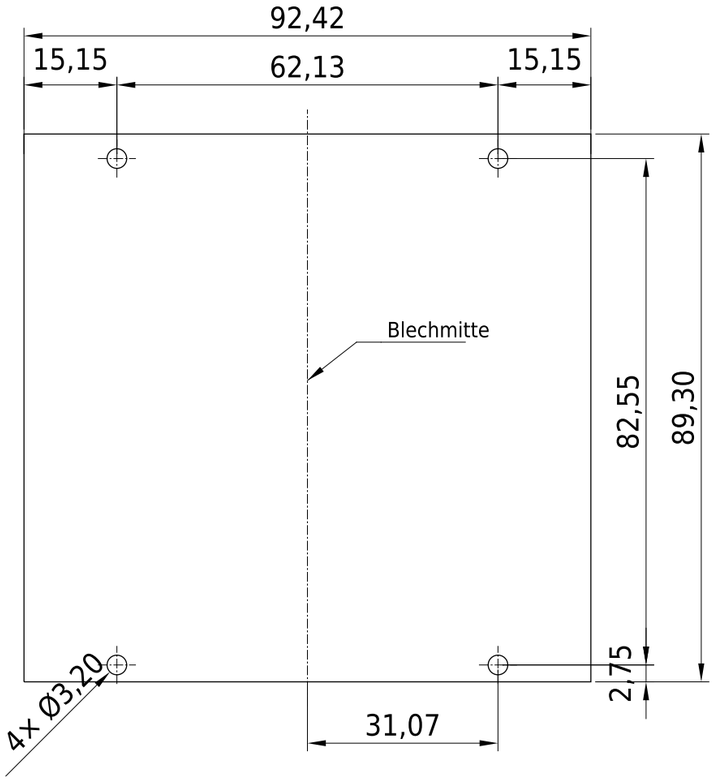

Draufsicht, gerollt (1 : 1)

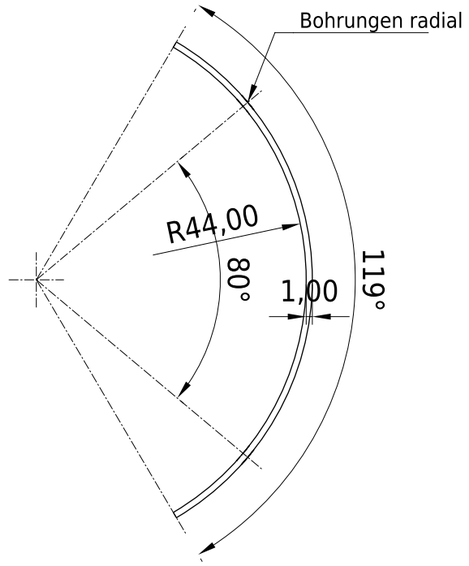

Isometrie (1 : 1,33)

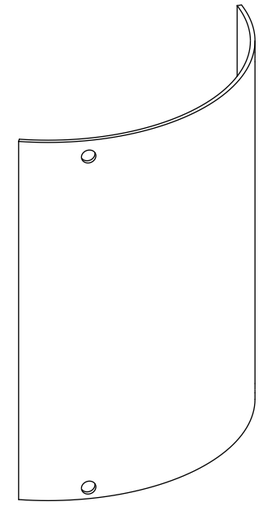

Hinweise

Fertigung konventionell, alle Maße angegeben.
3D-Daten: RFN_Abdeckblech.stp
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Blech 1 mm. Zuschnitt lasern oder scheren, Bohrungen Ø3,2 vor dem Rollen.
Auf Innen-Ø88 rollen (R44), Enden vorbiegen, Bogen 119°.
Prüfen: Blech liegt am Stahlring Ø88 an, Bohrungen
treffen die Radialgewinde 2,75 über der Unterkante.
Alternativ: Rohr auf Ø90/Ø88 × 89,3 drehen, Bohrungen radial,
in drei Teile sägen, Fuge 0,77 mm (1°).
Schrauben ISO 4762 M3 × 5 mit Scheibe ISO 7089, keine Senkung.

Teil-Nr.	Anzahl
106	3x
Werkstoff:	Aluminium EN AW-5754

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Abdeckblech


Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Abdeckblech.stp


Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER


A - A (2 : 1)

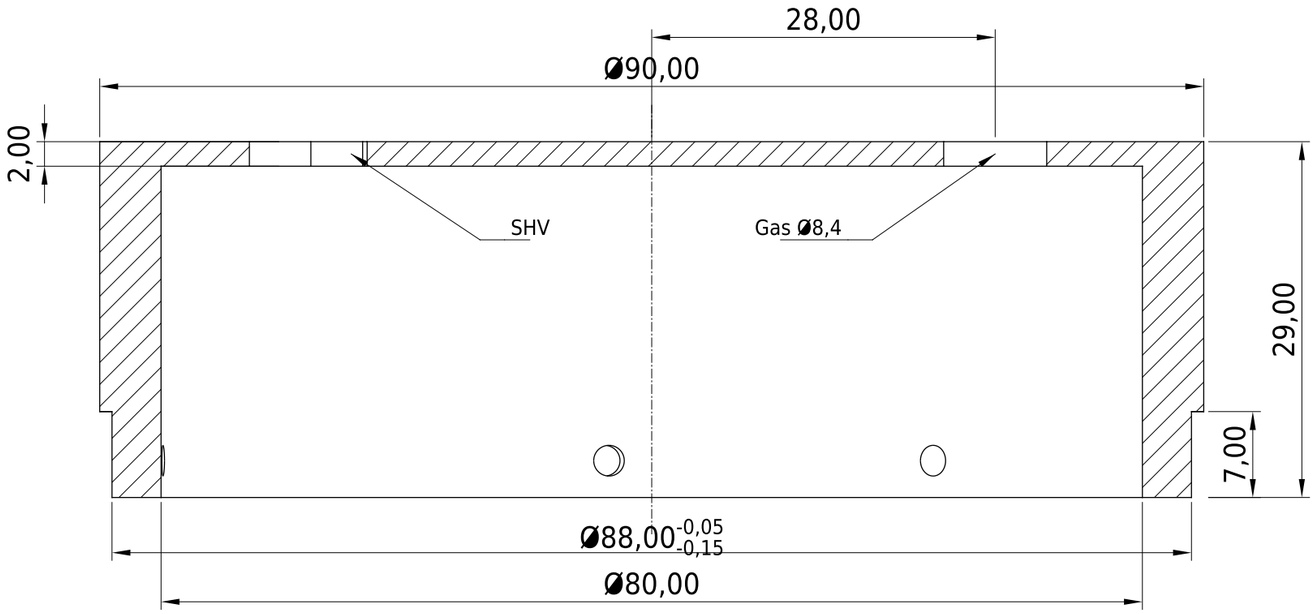


Draufsicht (1 : 1)

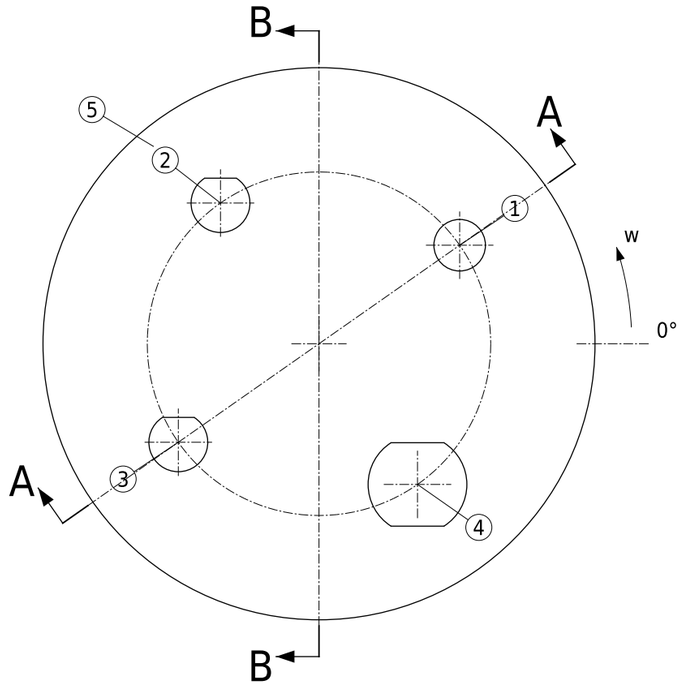


B - B (4 : 1)



Z (3 : 1) SHV



Y (3 : 1) N-Buchse

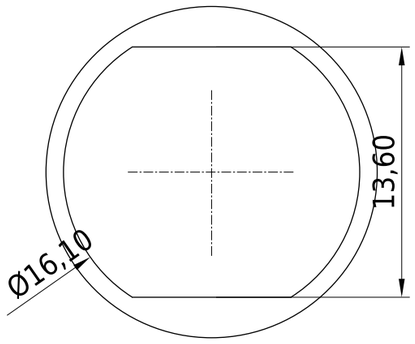

Bohrungen				
	Element	Lage	Winkel	n
1	Ø8,4 durch (Swagelok SS-200-61)	Ø56	35°	1
2	Ø9,6 durch, Abflachung 4,05 von Mitte (SHV), Z	Ø56	125°	1
3	wie 2	Ø56	215°	1
4	Ø16,1 durch, Doppel-D SW 13,6 (N-Buchse), Y	Ø56	305°	1
5	M3 radial durch Zapfenwand, Mitte 3 über Unterseite	außen	10°, 90°, 130°, 210°, 250°, 330°	6

Hinweise

Fertigung CNC nach RFN_Deckel.stp.
Zeichnung enthält Kontroll- und Funktionsmaße.
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Drehteil, D-Bohrungen gefräst.
Abflachungen liegen parallel zur X-Achse, Lage beliebig.
Zapfen Ø88 passend in die Abdeckbleche.
Winkel ab +X gegen den Uhrzeigersinn, Blick von oben.

Teil-Nr.	Anzahl
107	1x
Werkstoff:	Aluminium EN AW-6082 T6

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name


Deckel


Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Deckel.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

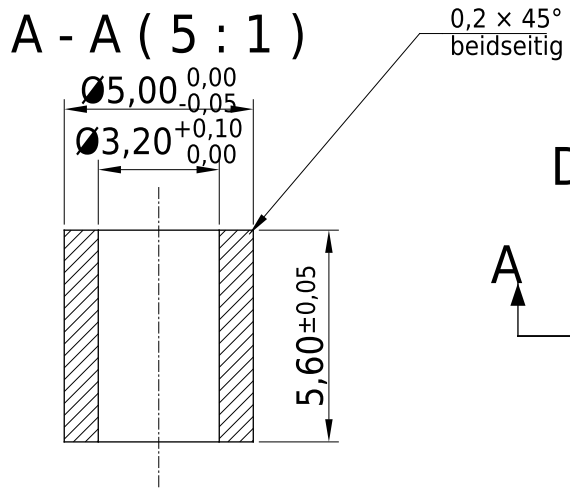

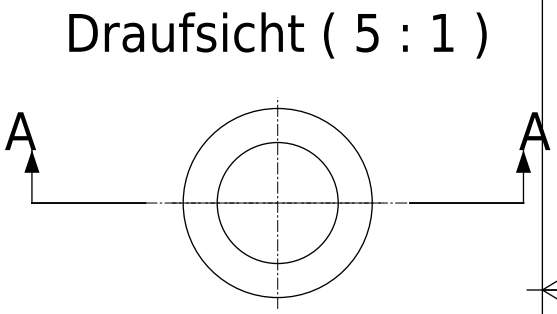

Hinweise

Fertigung konventionell, alle Maße angegeben.
3D-Daten: RFN_Distanzhuelse.stp
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Drehteil oder Rohr Ø5 × Ø3,2 ablängen.
Länge bestimmt die Federvorspannung: alle 9 gleich, ±0,05.
Stirnflächen plan und parallel.

Teil-Nr.	Anzahl
108	9x
Werkstoff:	Edelstahl 1.4301

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name


Distanzhülse


Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Distanzhuelse.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

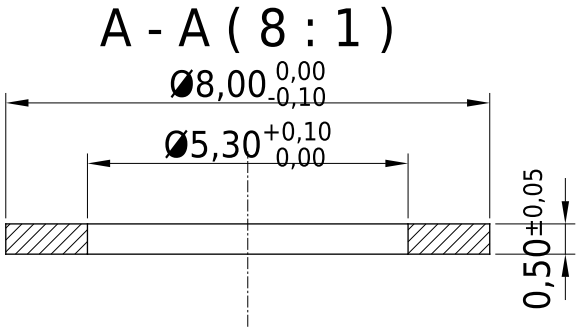

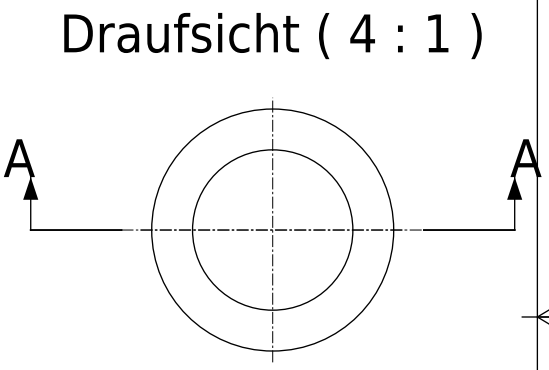

Hinweise

Fertigung konventionell, alle Maße angegeben.
3D-Daten: RFN_Federscheibe.stp
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Gelasert, gestanzt oder gedreht, gratfrei.
Liegt unter der Feder auf dem Boden der Federsenkung im GFK-Ring.

Teil-Nr.	Anzahl
109	9x
Werkstoff:	Edelstahl 1.4301

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Federscheibe


Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Federscheibe.stp


Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

Ansicht (4 : 1)

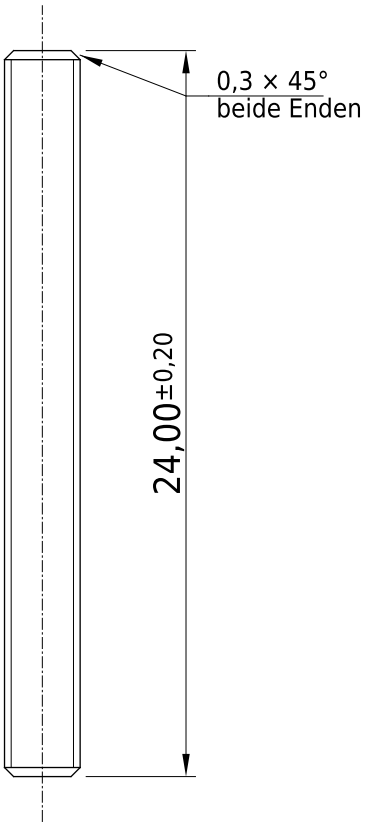

Stirnansicht (10 : 1)

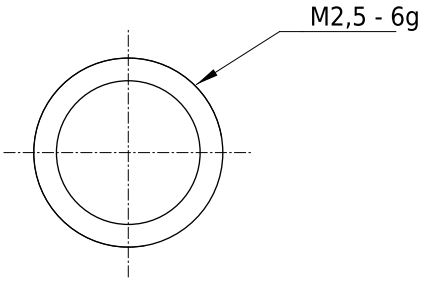

Hinweise

Fertigung konventionell, alle Maße angegeben.
3D-Daten: RFN_Kontaktbolzen.stp
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Gewindestange DIN 976-1 M2,5 A2-70 auf 24 ablängen.
Enden anfasen, Gewinde gängig, gratfrei.
Im Klemmring eingeschraubt, bündig mit dessen Unterseite.

Teil-Nr.	Anzahl
110	1x
Werkstoff:	A2-70

Fachbereich 07

	Datum	Name
2026		
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Kontaktbolzen


Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Kontaktbolzen.stp


Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

A - A (4 : 1)

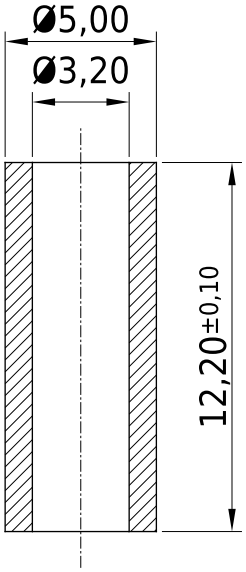

Draufsicht (4 : 1)

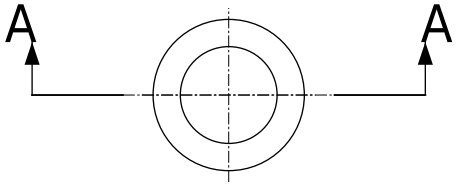

Hinweise

Fertigung konventionell, alle Maße angegeben.
3D-Daten: RFN_Keramikhuelse.stp
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Kaufteil Al2O3-Rohr Ø5 × Ø3,2, mit Diamantscheibe trennen.
Stirnflächen plan und parallel, Kanten leicht brechen.
Steht auf dem Träger, 0,5 über dem GFK-Ring.

Teil-Nr.	Anzahl
111	1x
Werkstoff:	Keramik Al2O3

Fachbereich 07

	Datum	Name
2026		
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Keramikhülse

Ansprechpartner


Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Keramikhuelse.stp


Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK,
*DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

Rohr vor dem Trennen, Schnitt (2 : 1)

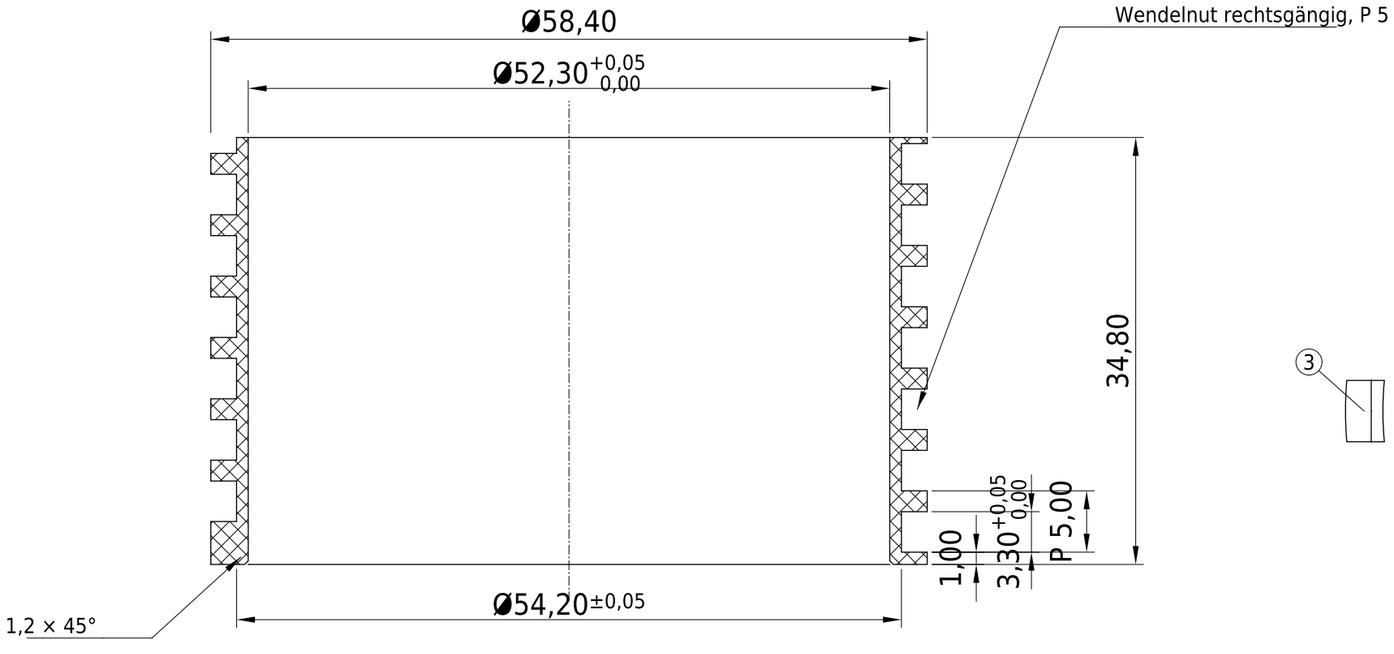

Draufsicht, getrennt (2 : 1)

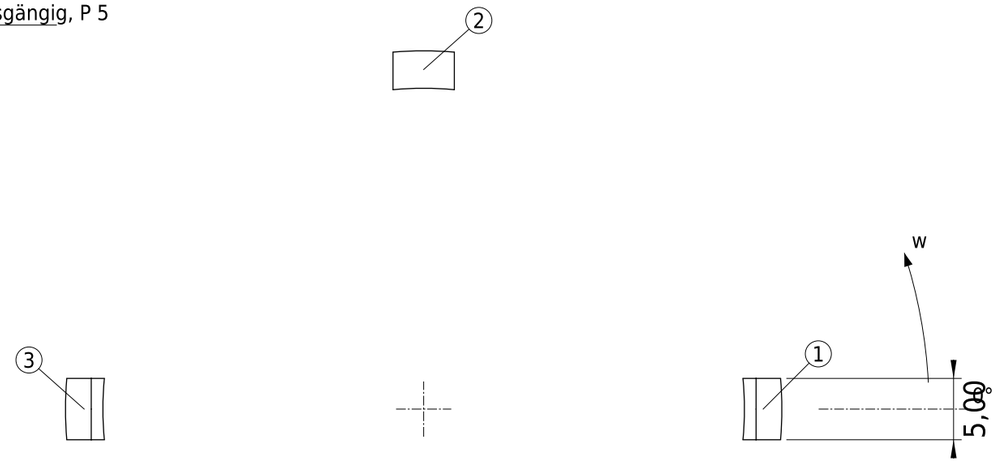

Hinweise

Fertigung konventionell, alle Maße angegeben.
3D-Daten: RFN_Spulenstaebe.stp
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Rohr drehen, innen auf einem Dorn stützen, Wendelnut wie ein Gewinde drehen: Steigung 5 rechts, Breite 3,3, Grund Ø54,2, Auslauf 1,5 über unten.
Dann vier Stäbe 5 breit bei 0°, 90°, 180°, 270° heraustrennen,
1 bis 4 nummerieren, Reihenfolge beim Einbau beibehalten.
Benachbarte Stäbe: Nuten um 1,25 (P/4) versetzt.
Werkstoff: Stäbe berühren die Spule (bis ~300 °C). Epoxid-GFK zu schwach, Silikonharz-Glasgewebe, Polyimid-Glas oder PEEK-GF30 nehmen.

Teil-Nr.	Anzahl
112	1 Satz (4)
Werkstoff:	GFK, siehe Hinweis

Fachbereich 07

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Spulenstäbe


Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Spulenstaebe.stp


Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER

Vorderansicht (2 : 1)

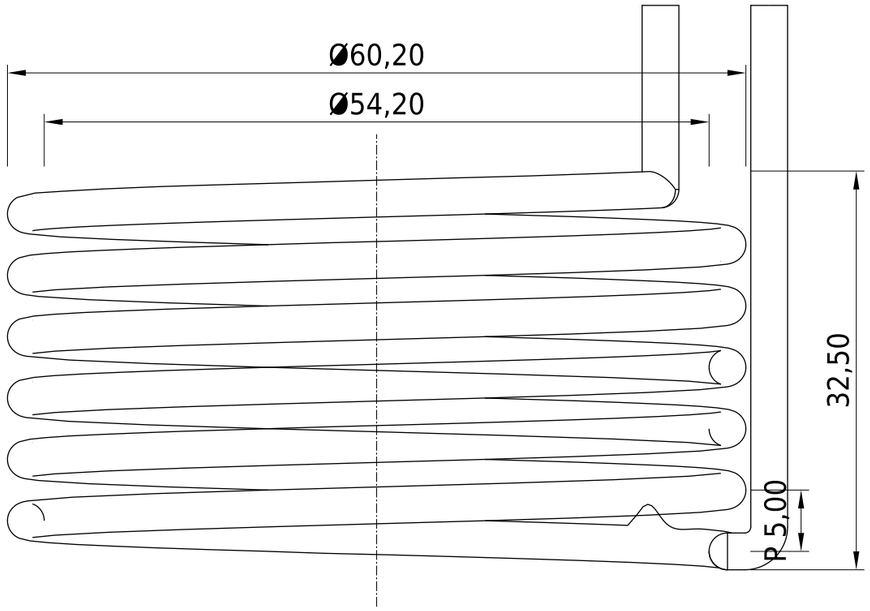

Draufsicht (1,5 : 1)

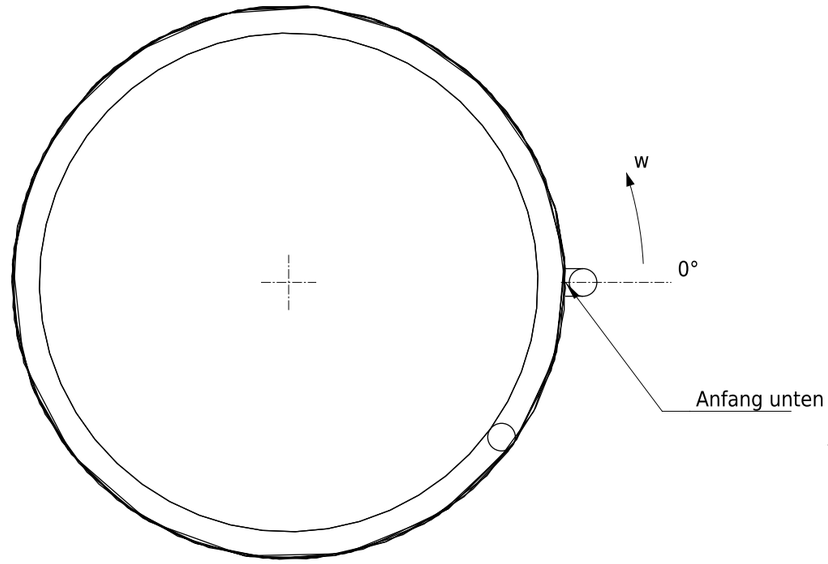

Spulendaten	
Größe	Wert
Draht	Cu Ø3,0
Drahtmitte	Ø57,2
Windungen	5,9
Steigung	5 mm, rechtsgängig
Lücke zwischen Windungen	2 mm
Drahtlänge Wendel	1061 mm + Anschlüsse
Unterkante ab Blendenunterseite	13,05 mm

Hinweise

Fertigung konventionell, alle Maße angegeben.
3D-Daten: RFN_Spule.stp
Allgemeintoleranzen ISO 2768-mK.
Kanten gebrochen 0,2, gratfrei.
Auf Dorn Ø54,2 wickeln oder direkt in die Nut der Spulenstäbe einschrauben. Rechtsgängig wie die Nut. Anfang unten liegt im Nutauslauf, Anschluss radial nach außen durch die Anschlussnut des GFK-Rings, dann außen neben den Windungen nach oben. Windungszahl und Steigung vor dem Wickeln mit der Anpassung (Induktivität) abstimmen.

Teil-Nr.	Anzahl
113	1x
Werkstoff:	Kupfer

Fachbereich 07

Spule

2026	Datum	Name
Entw.	24.10.	Wehkamp
Gez.	24.10.	Wehkamp
Gepr.	00.00.	name

Ansprechpartner
Konrad Wehkamp (konrad.helmut.wehkamp@physik.uni-giessen.de)
Jana Zorn(jana.zorn-2@exp1.physik.uni-giessen.de)

RFN_Spule.stp

Blatt 1/1

*H=HELICOIL, *E=ENSAT, *EB=ENTLÜFTUNGSBOHRUNG, *AG=ABGESTIMMT MIT GEGENSTÜCK, *DF=DICHTFLÄCHE KEINE KRATZER