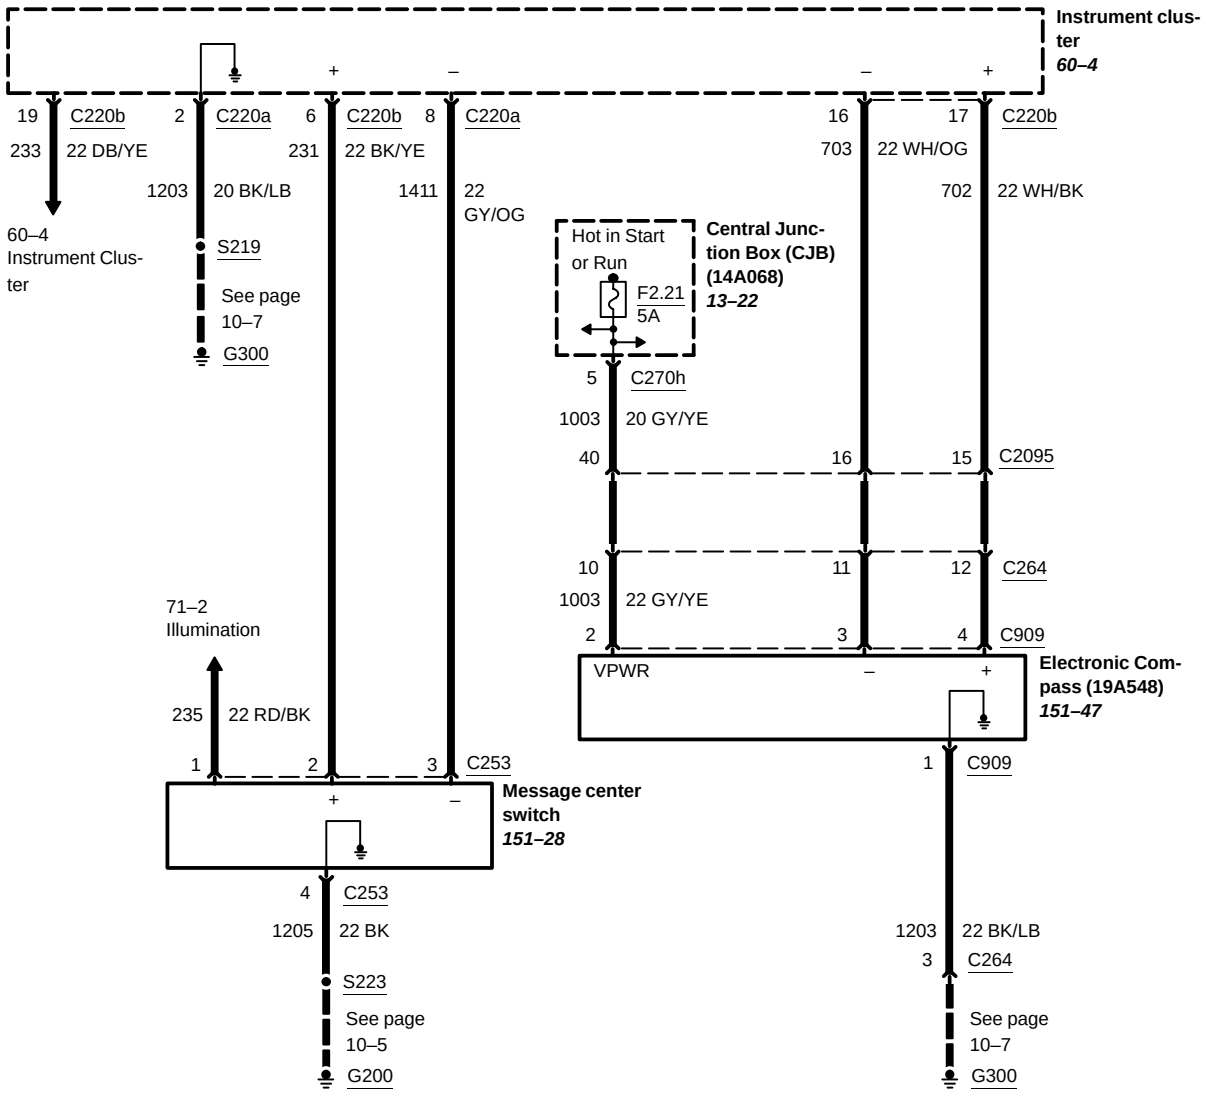
Instrument cluster
60–4
+
–
–
+
19
C220b
233
22 DB/YE
2
C220a
1203
20 BK/LB
6
C220b
231
22 BK/YE
8
C220a
1411
22 GY/OG
16
17
C220b
703
22 WH/OG
702
22 WH/BK
60–4
Instrument Cluster
S219
See page 10–7
G300
Hot in Start or Run
F2.21
5A
Central Junction Box (CJB) (14A068)
13–22
5
C270h
1003
20 GY/YE
40
16
15
C2095
10
11
12
C264
1003
22 GY/YE
2
3
4
C909
VPWR
Electronic Compass (19A548)
151–47
1
C909
71–2
Illumination
235
22 RD/BK
1
2
3
C253
Message center switch
151–28
4
C253
1205
22 BK
S223
See page 10–5
G200
1203
22 BK/LB
3
C264
See page 10–7
G300