



Dados Consolidados-dgl1905.xlsx — aba '10kV' (10kV)


QC1 — Estabilidade do Instrumento (Throughput)

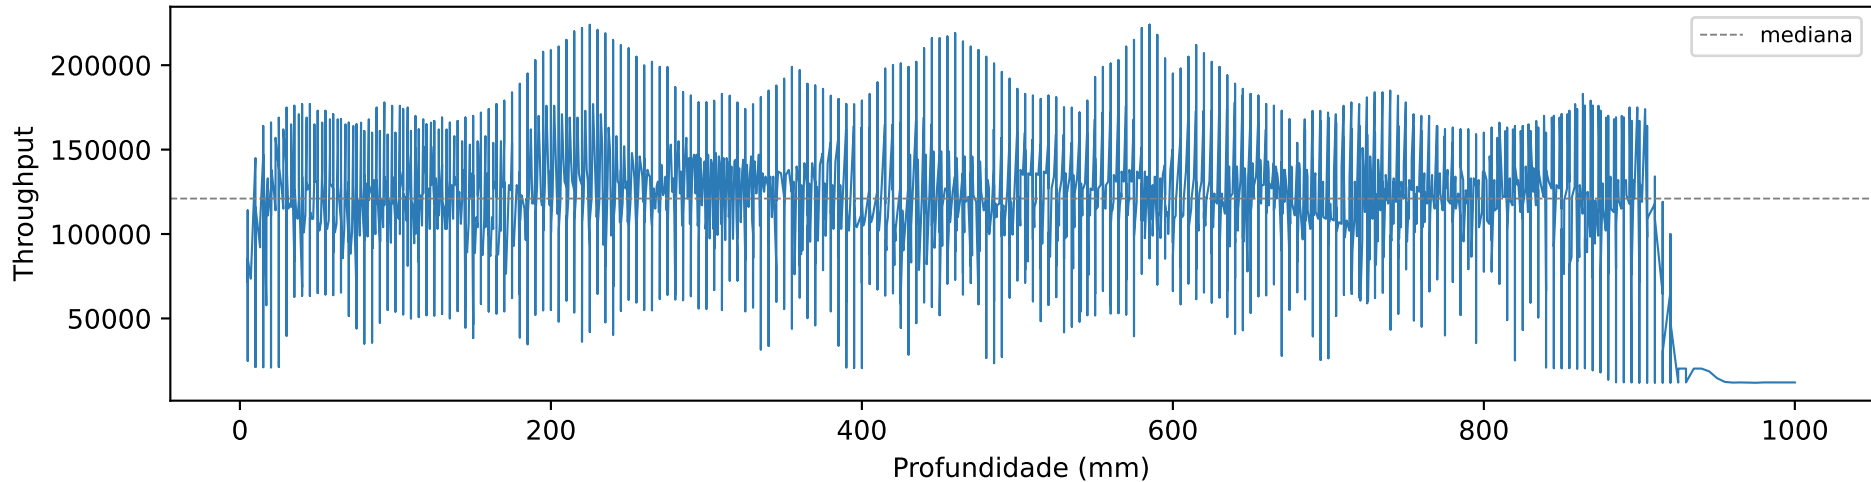


QC2 — Espalhamento Coerente (Rh-L α)

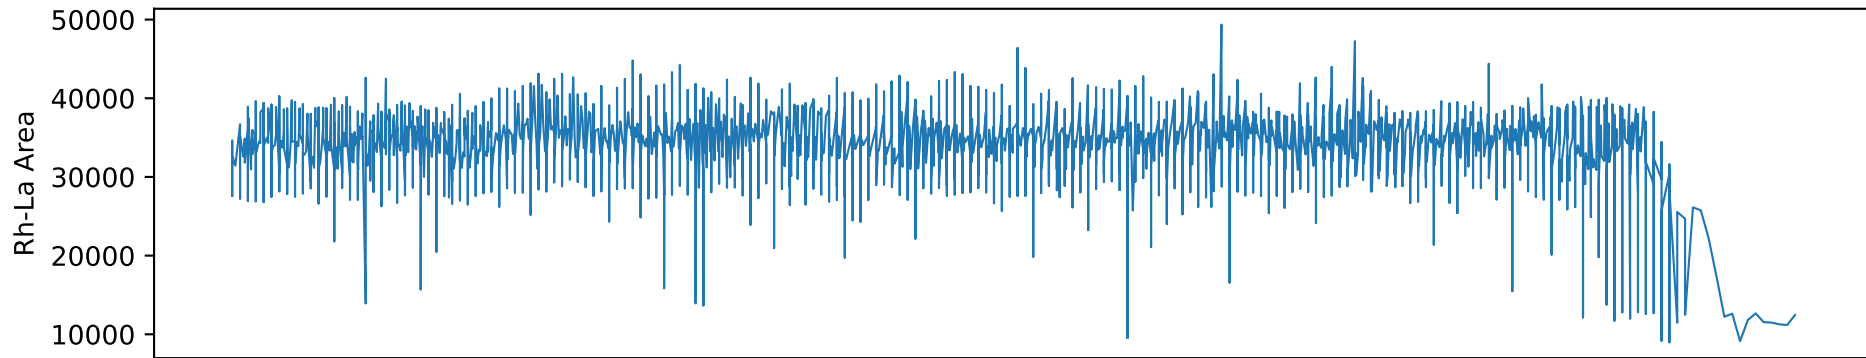


QC3 — Espalhamento Incoerente (Rh-L α -Inc)

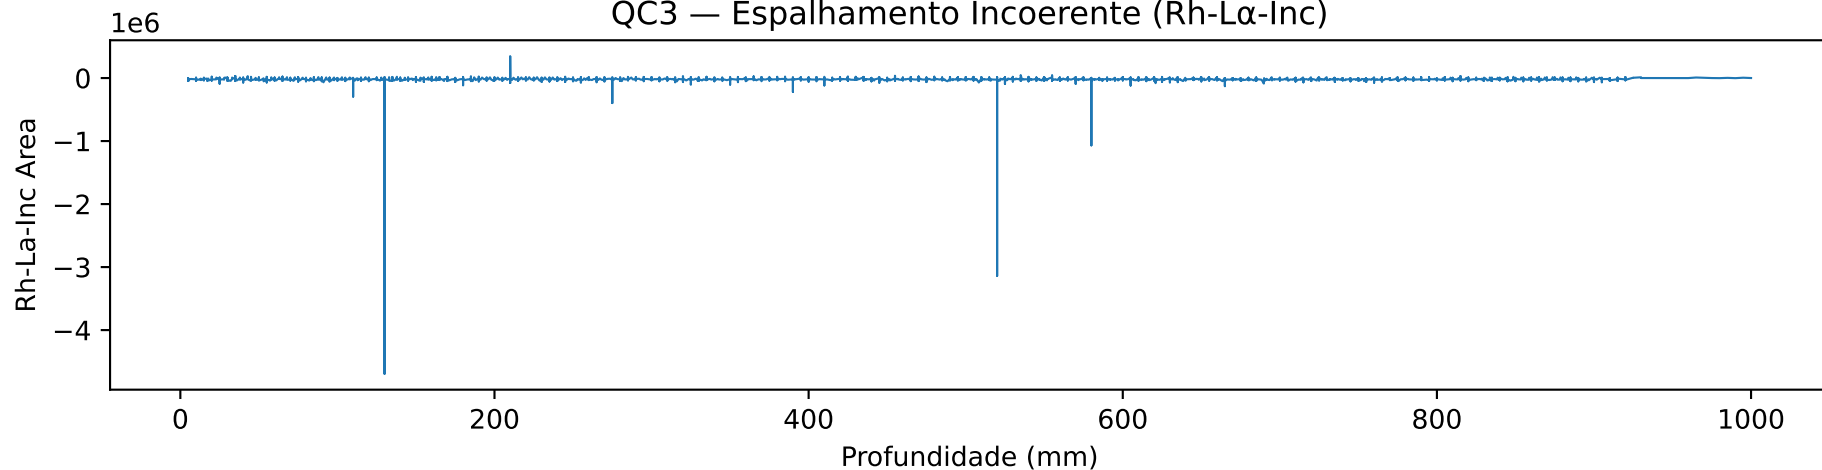


QC4 — Rolling QC (Rh-La-Inc)

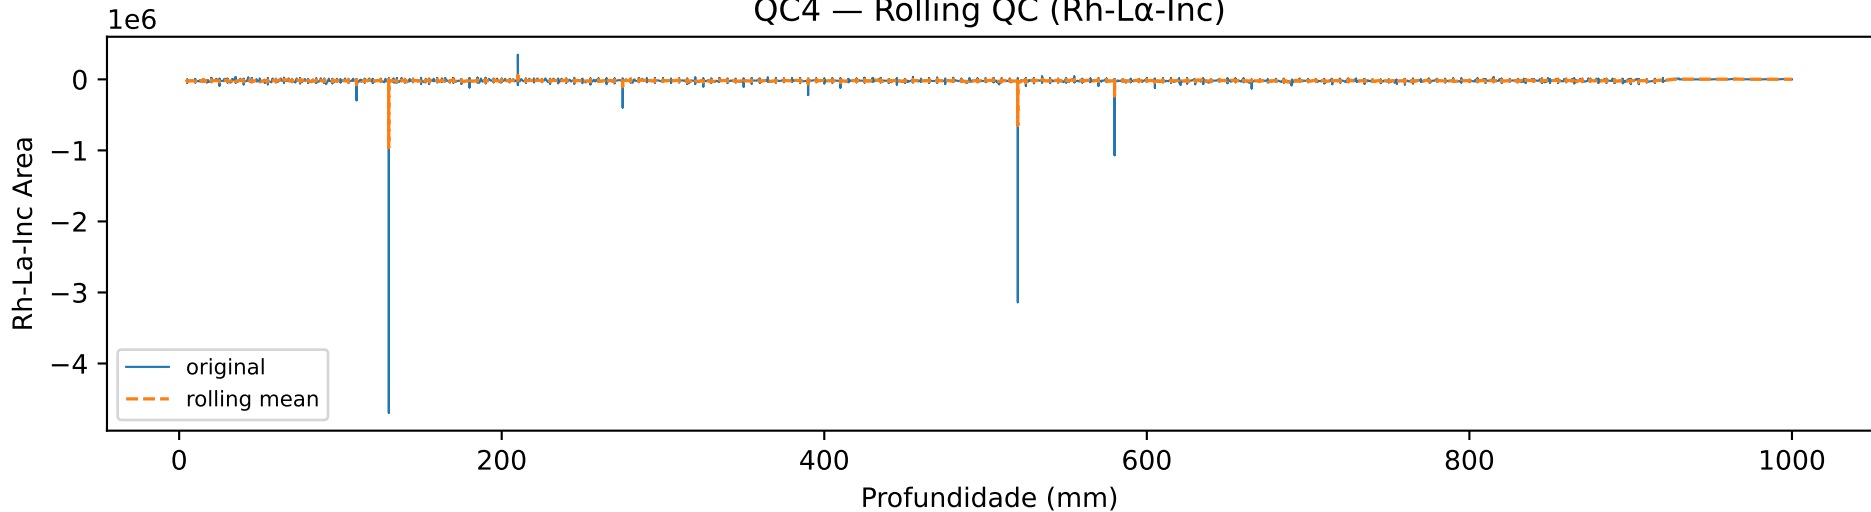

QC5 — Réplicas (Mean RPD)

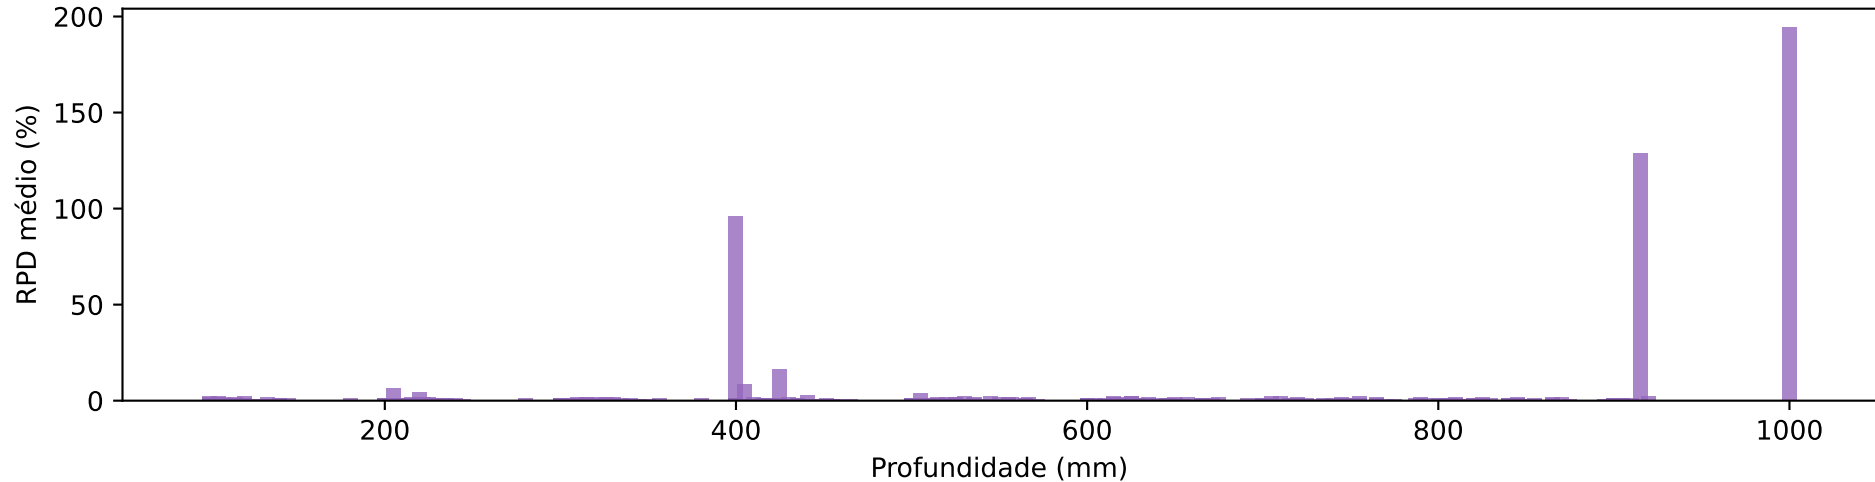

Quality Index (QI) e Quality Flag (QF)

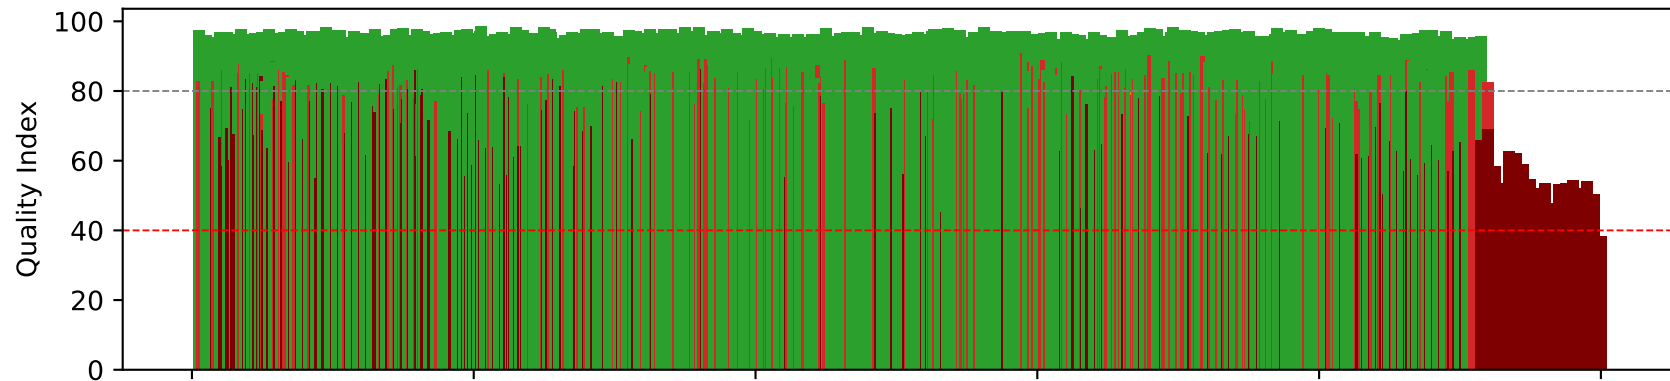

ND-Indeterminado

Quality Flag

3-Rejeitado

2-Suspeito

1-Atenção

0-OK

0

200

400


600

800

1000

Profundidade (mm)

QC6 — PCA (colorido por Mahalanobis)

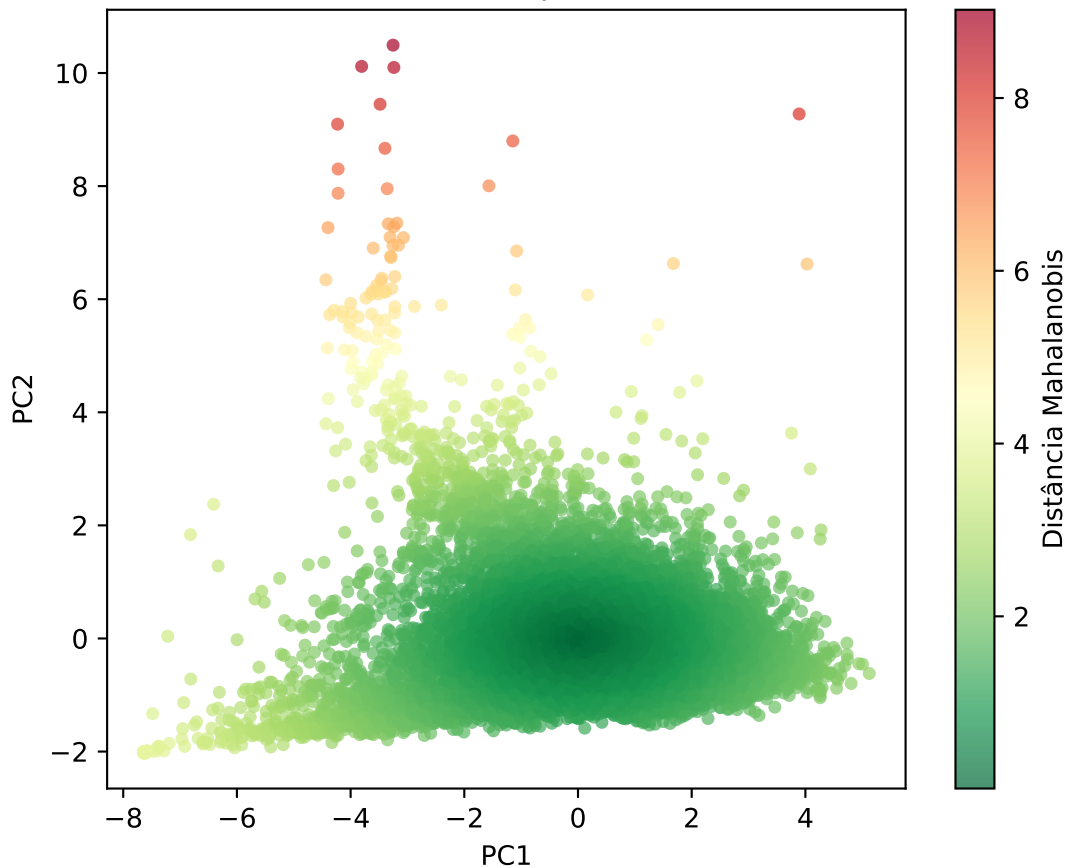


Intervalos Problemáticos

Início (CompositeDepth, mm)	Fim (CompositeDepth, mm)	Nº Medidas	QF Máximo	Causas
5.0	1000.0	2890	3-Rejeitado ⚠	Argônio (Ar-Kα), QI baixo, Rh-Lα, Rh-Lα-Inc, Deri


⚠ Intervalo(s) marcados foram disparados por um critério pontual (z-score ou Mahalanobis), não pelo QI agregado — o QI permanece em faixa aceitável (≥ 80).

Dados Consolidados-dgl1905.xlsx — aba '30kV' (30kV)


QC1 — Estabilidade do Instrumento (Throughput)

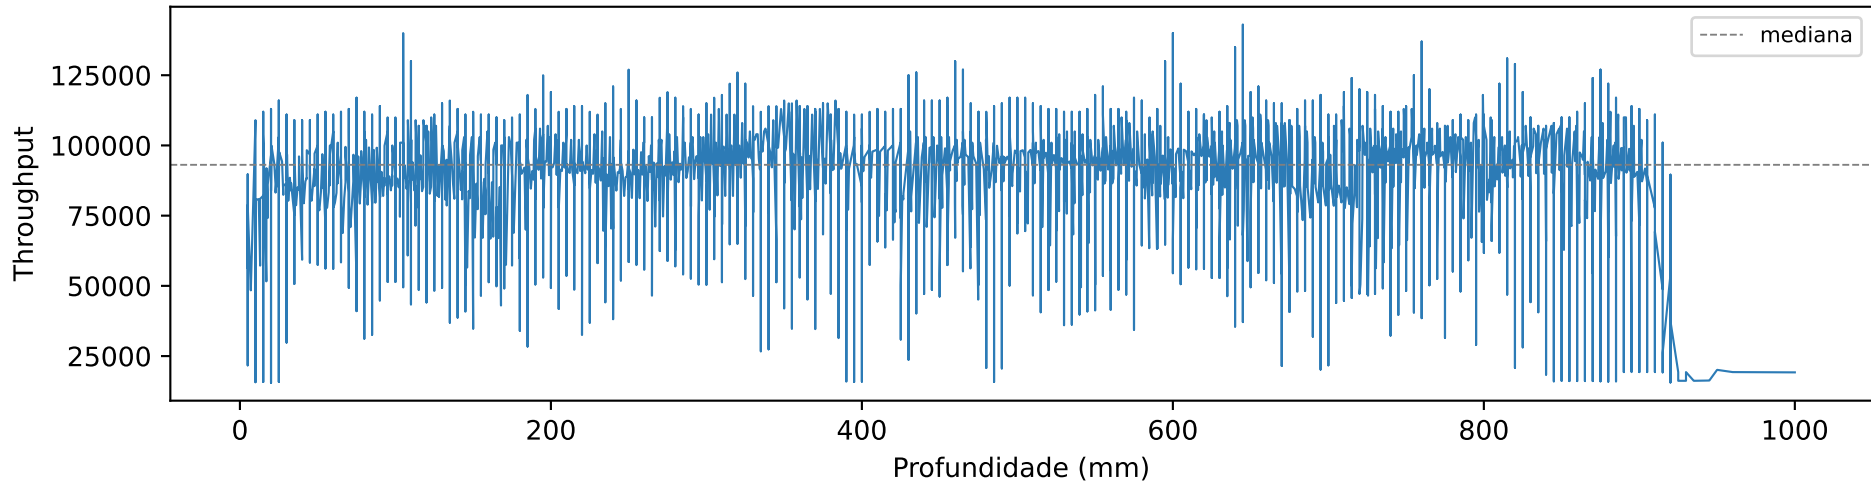


QC2 — Espalhamento Coerente (Rh-L α)

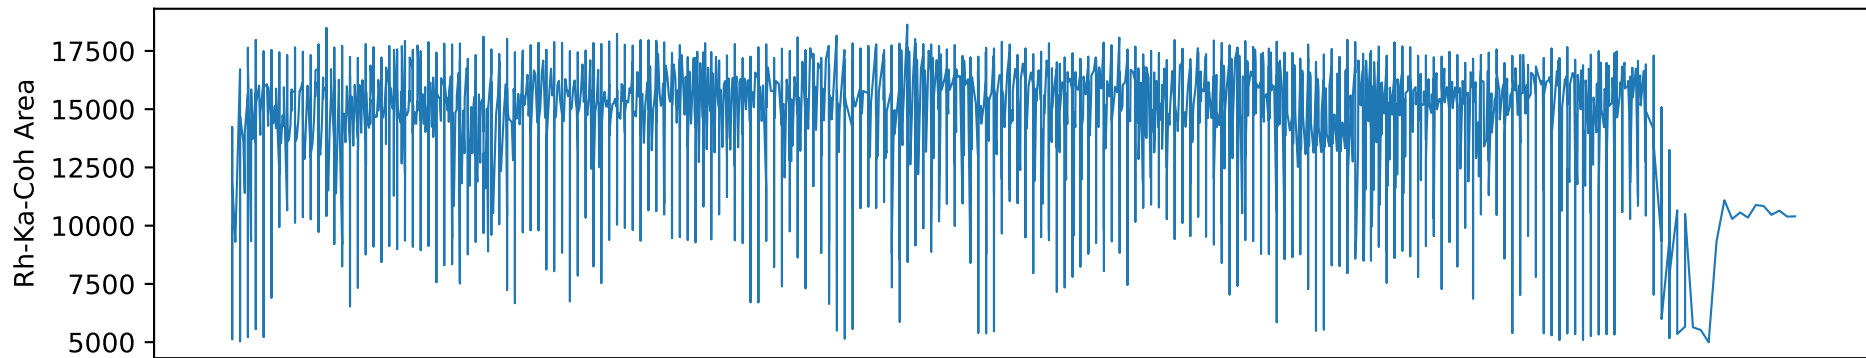


QC3 — Espalhamento Incoerente (Rh-L α -Inc)

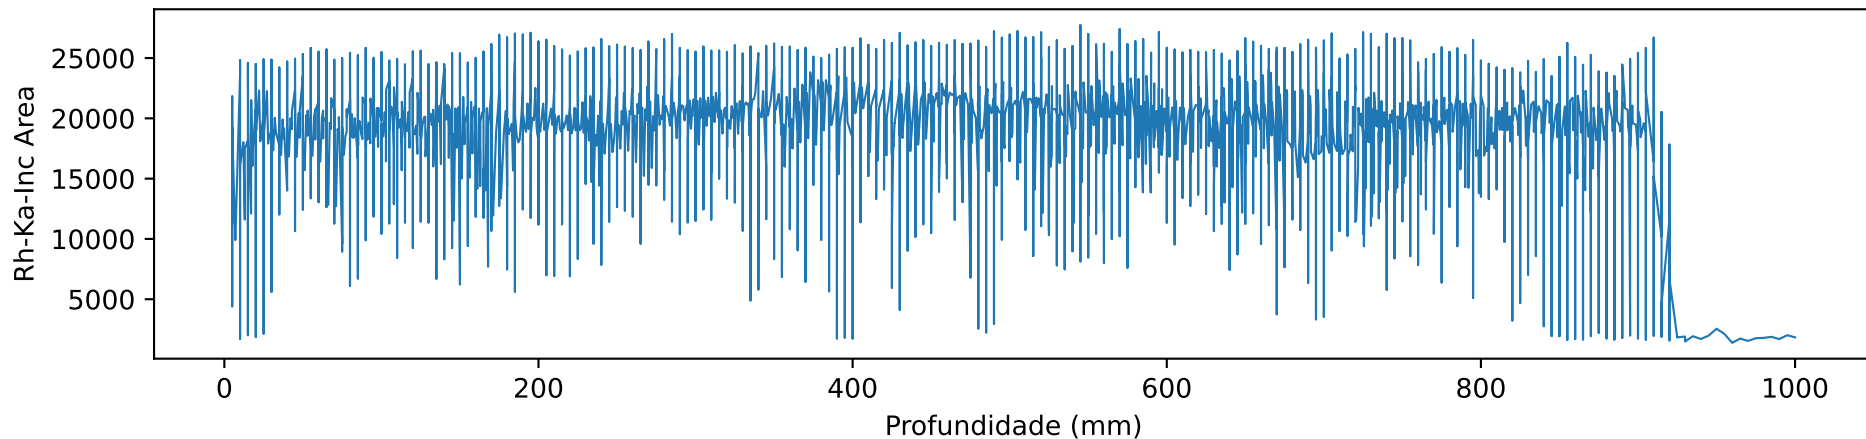


QC4 — Rolling QC (Rh-K α -Inc)

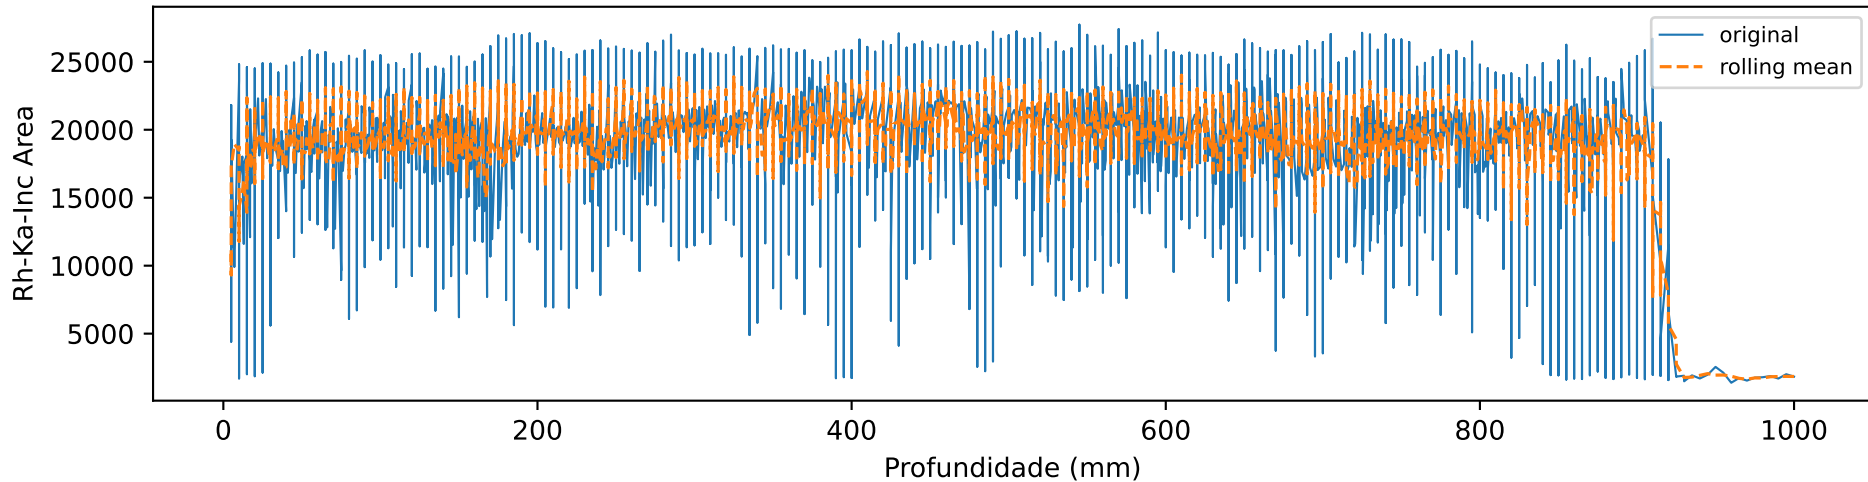


QC5 — Réplicas (Mean RPD)

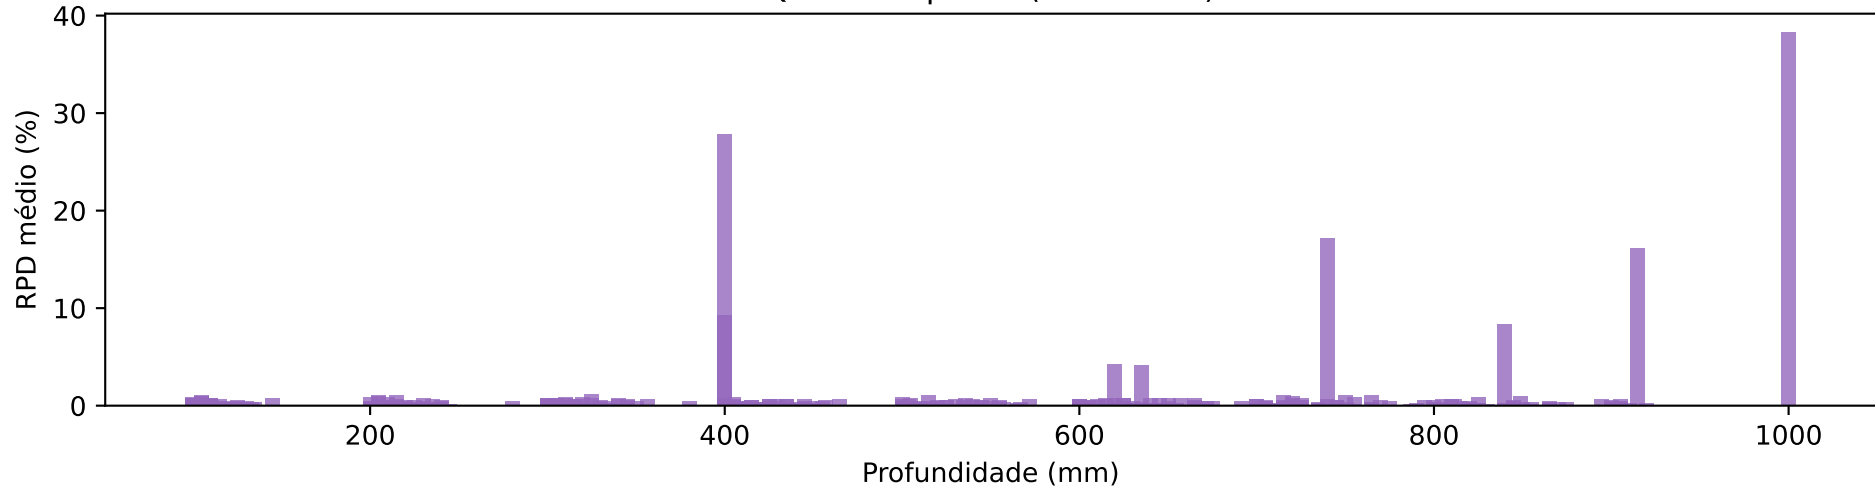


Quality Index (QI) e Quality Flag (QF)

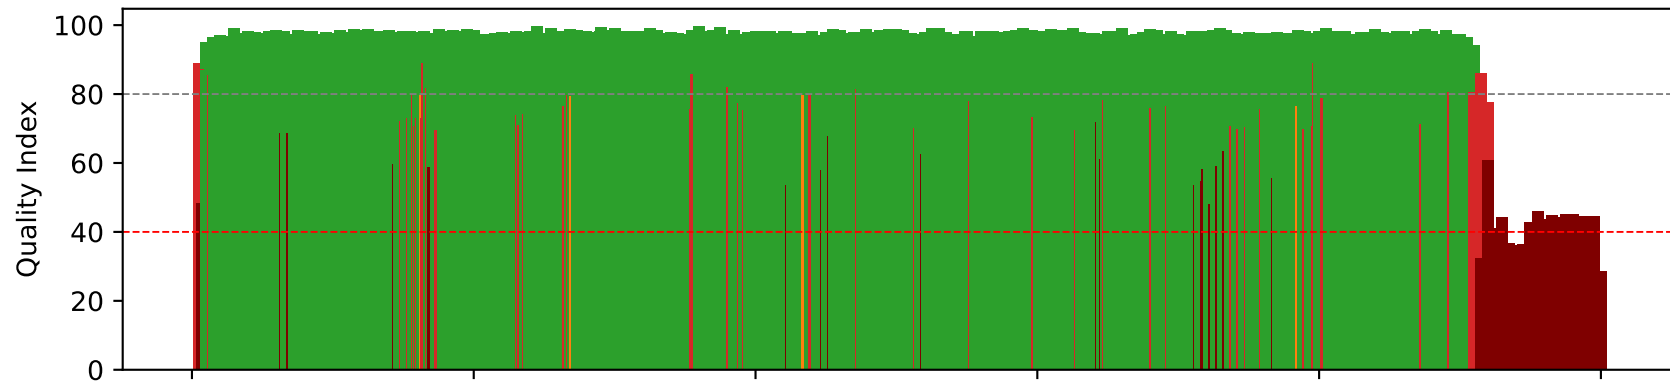

ND-Indeterminado

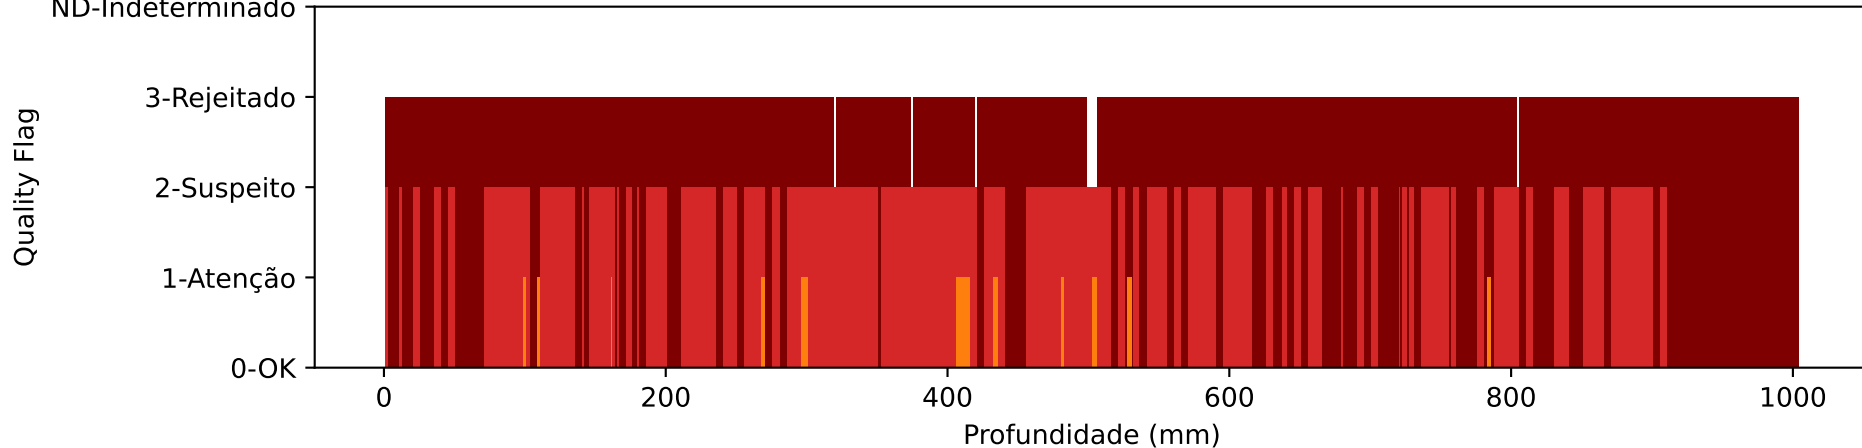

QC6 — PCA (colorido por Mahalanobis)

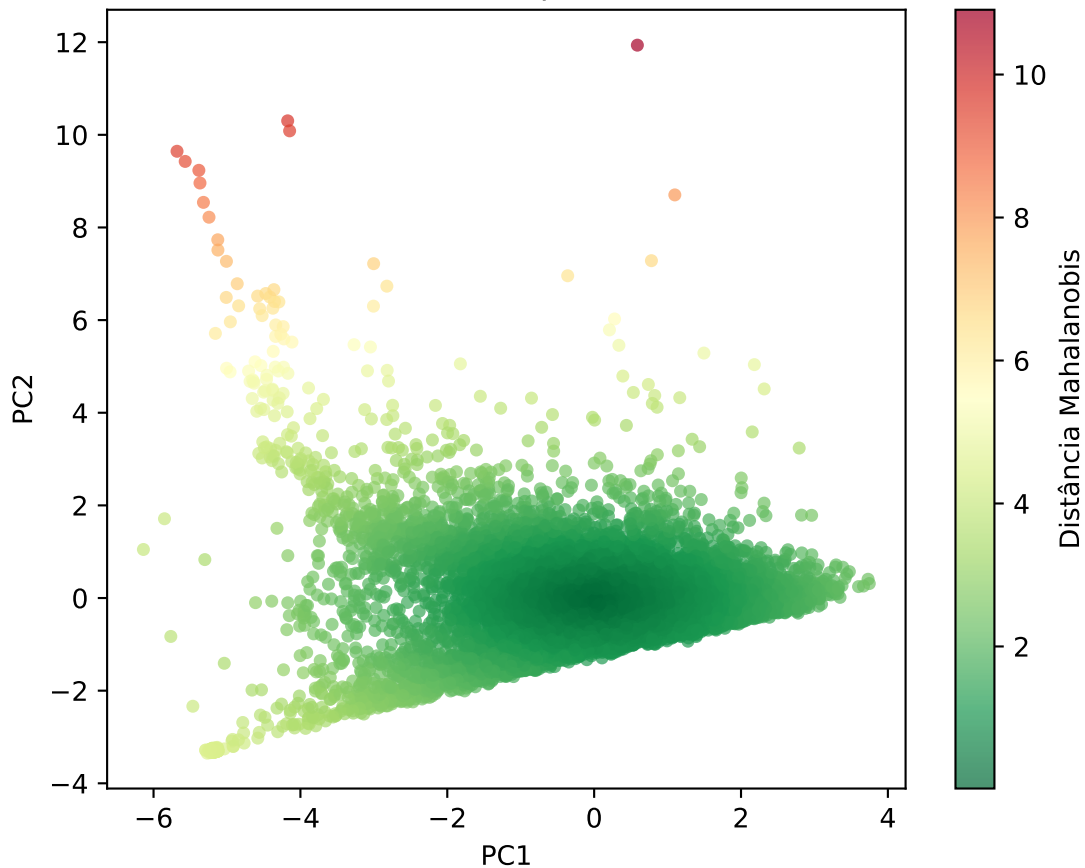


Intervalos Problemáticos

Início (CompositeDepth, mm)	Fim (CompositeDepth, mm)	Nº Medidas	QF Máximo	Causas
5.0	1000.0	1720	3-Rejeitado ⚠	QI baixo, Rh-Lα, Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC), Th


⚠ Intervalo(s) marcados foram disparados por um critério pontual (z-score ou Mahalanobis), não pelo QI agregado — o QI permanece em faixa aceitável (≥ 80).

Dados Consolidados-dgl1905.xlsx — aba '50kV' (50kV)


QC1 — Estabilidade do Instrumento (Throughput)

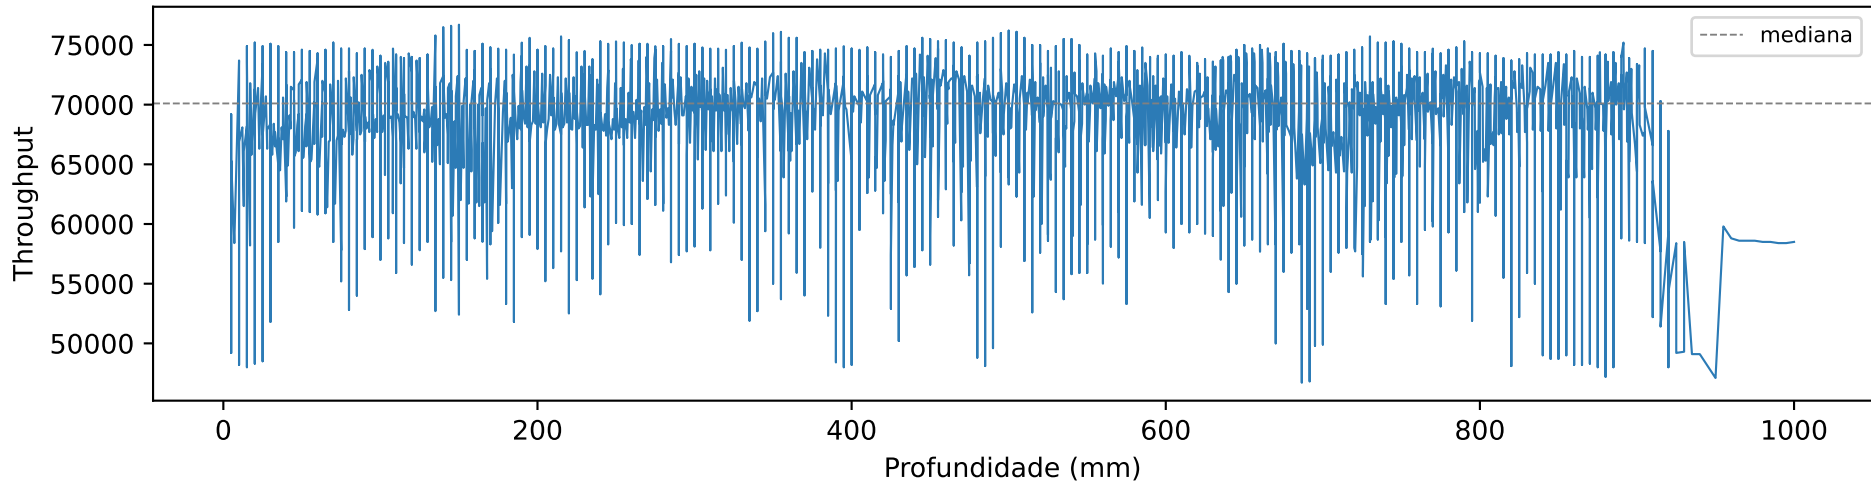


QC4 — Rolling QC (Throughput)

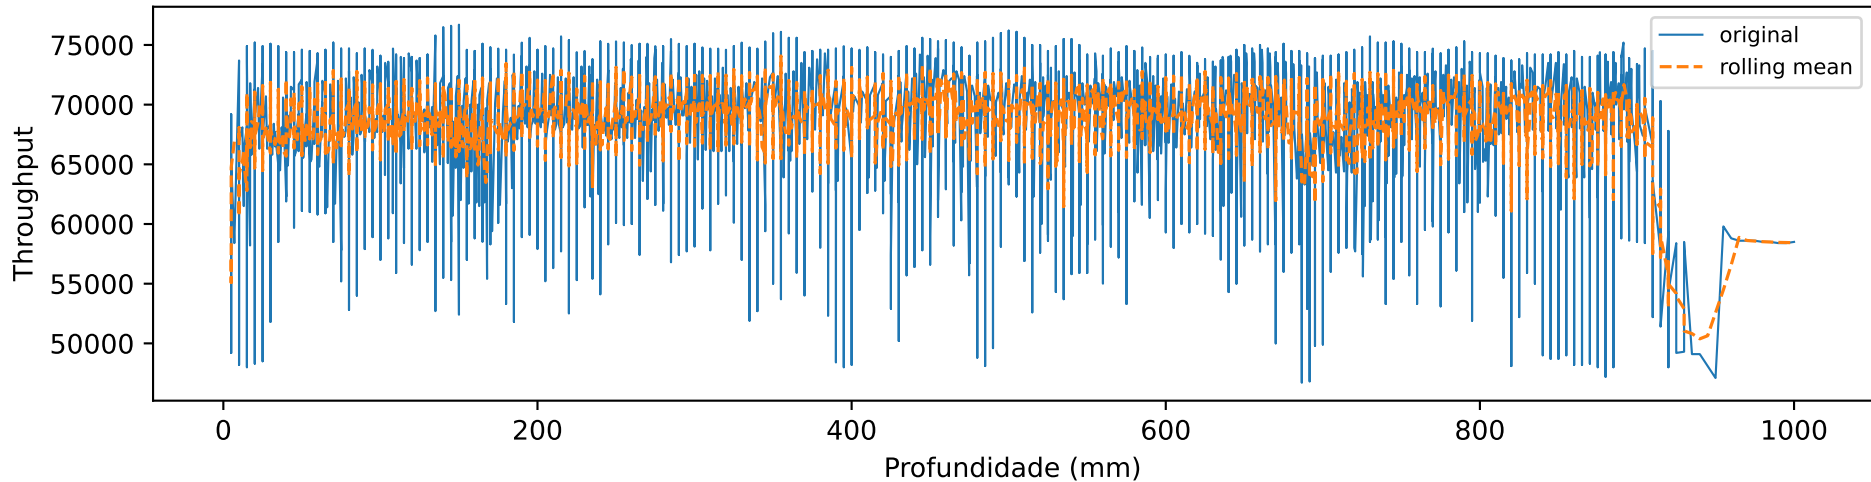

QC5 — Réplicas (Mean RPD)

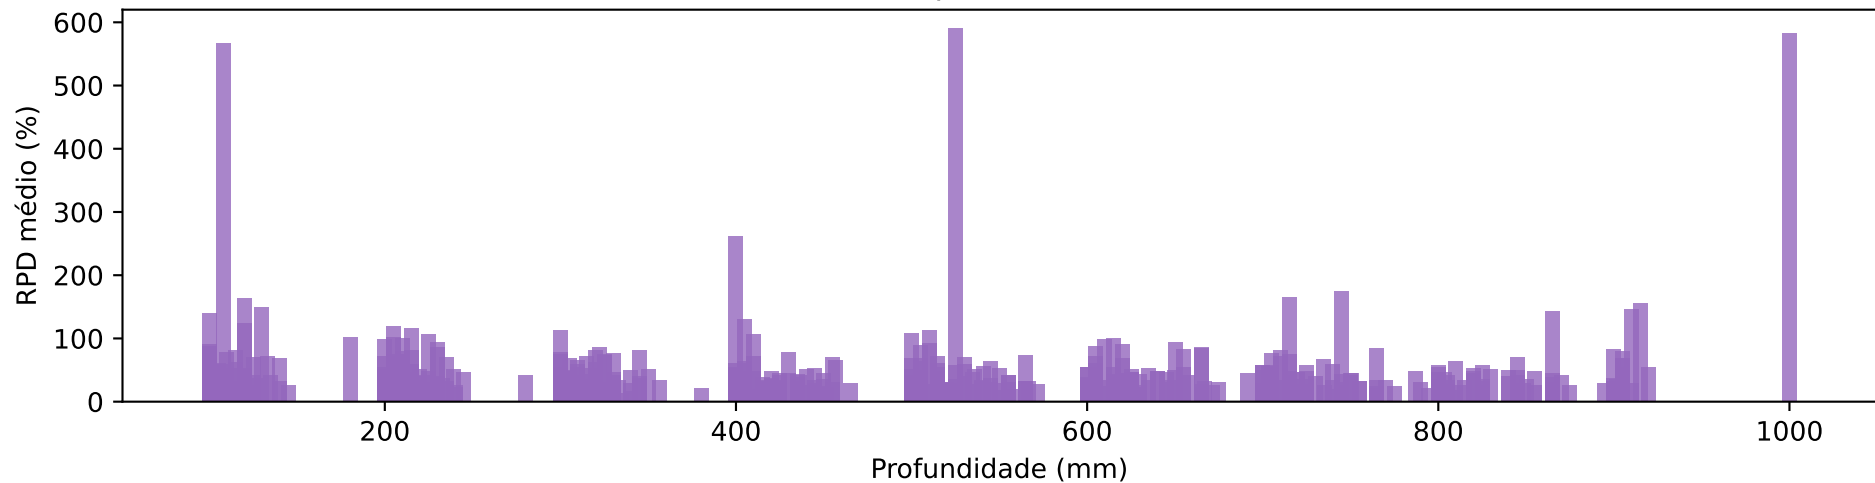

Quality Index (QI) e Quality Flag (QF)

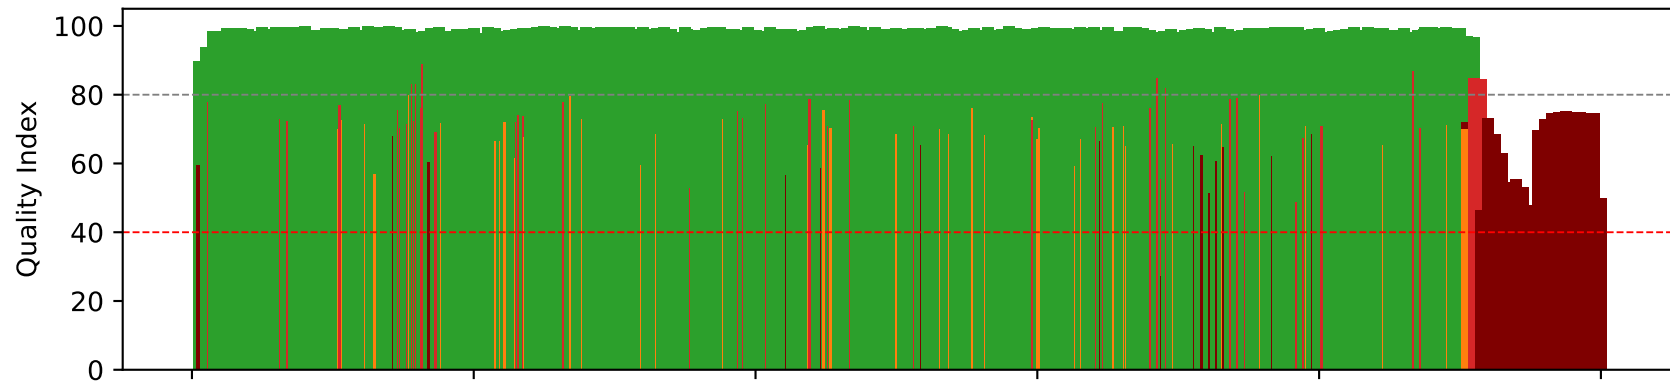

ND-Indeterminado

Quality Flag

3-Rejeitado

2-Suspeito

1-Atenção

0-OK

0

200


400

600


800

1000

Profundidade (mm)

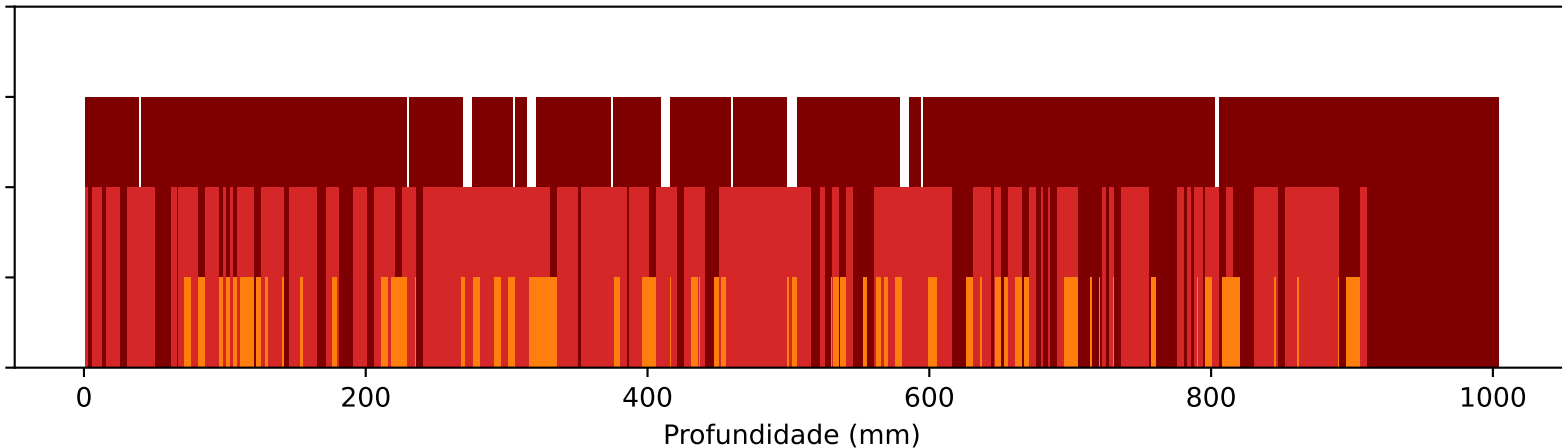

QC6 — PCA (colorido por Mahalanobis)

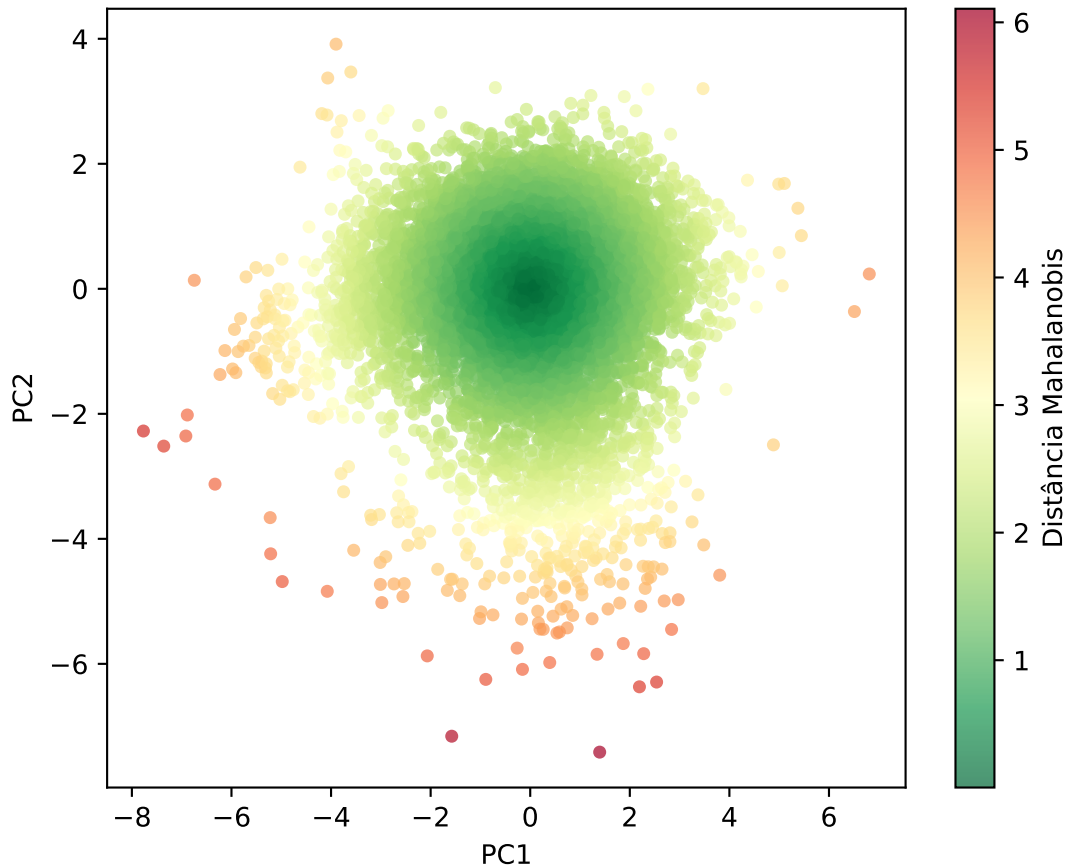

Intervalos Problemáticos

Início (CompositeDepth, mm)	Fim (CompositeDepth, mm)	Nº Medidas	QF Máximo	Causas
5.0	1000.0	1211	3-Rejeitado ⚠	QI baixo, Deriva (Rolling QC), Throughput

⚠ Intervalo(s) marcados foram disparados por um critério pontual (z-score ou Mahalanobis), não pelo QI agregado — o QI permanece em faixa aceitável (≥ 80).