



Dados Consolidados|CCE10.xlsx — aba '10kV' (10kV)


QC1 — Estabilidade do Instrumento (Throughput)

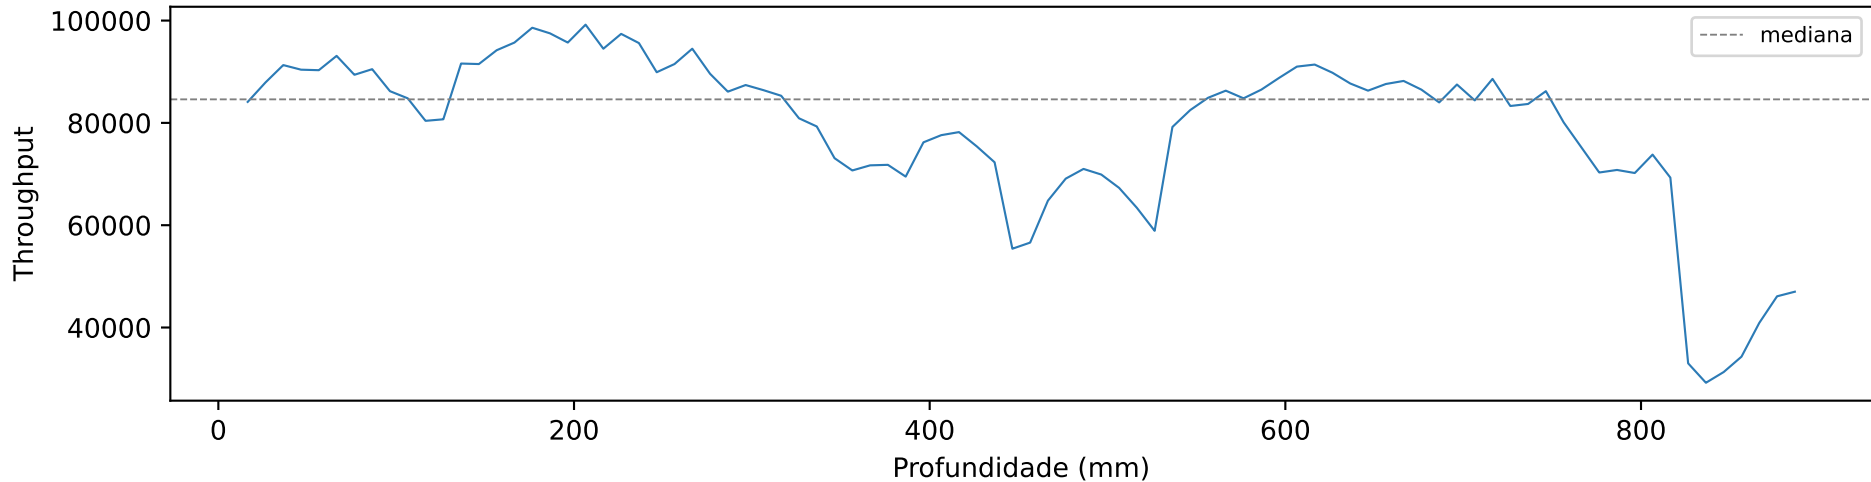


QC2 — Espalhamento Coerente (Rh-L α)

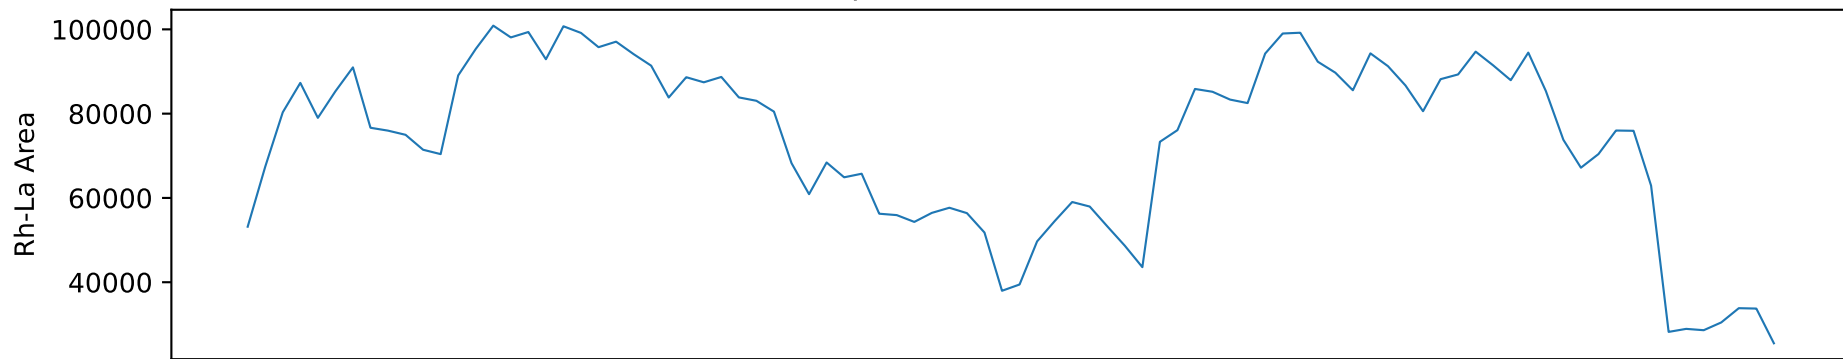


QC3 — Espalhamento Incoerente (Rh-L α -Inc)


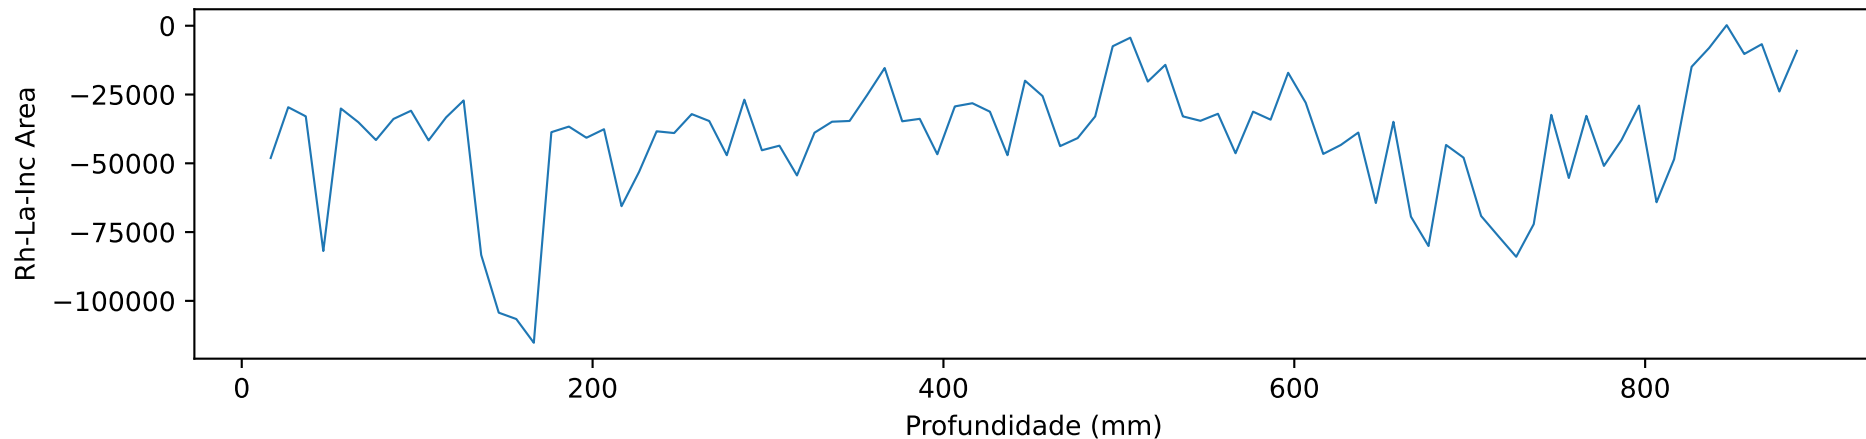


QC4 — Rolling QC (Rh-L α -Inc)

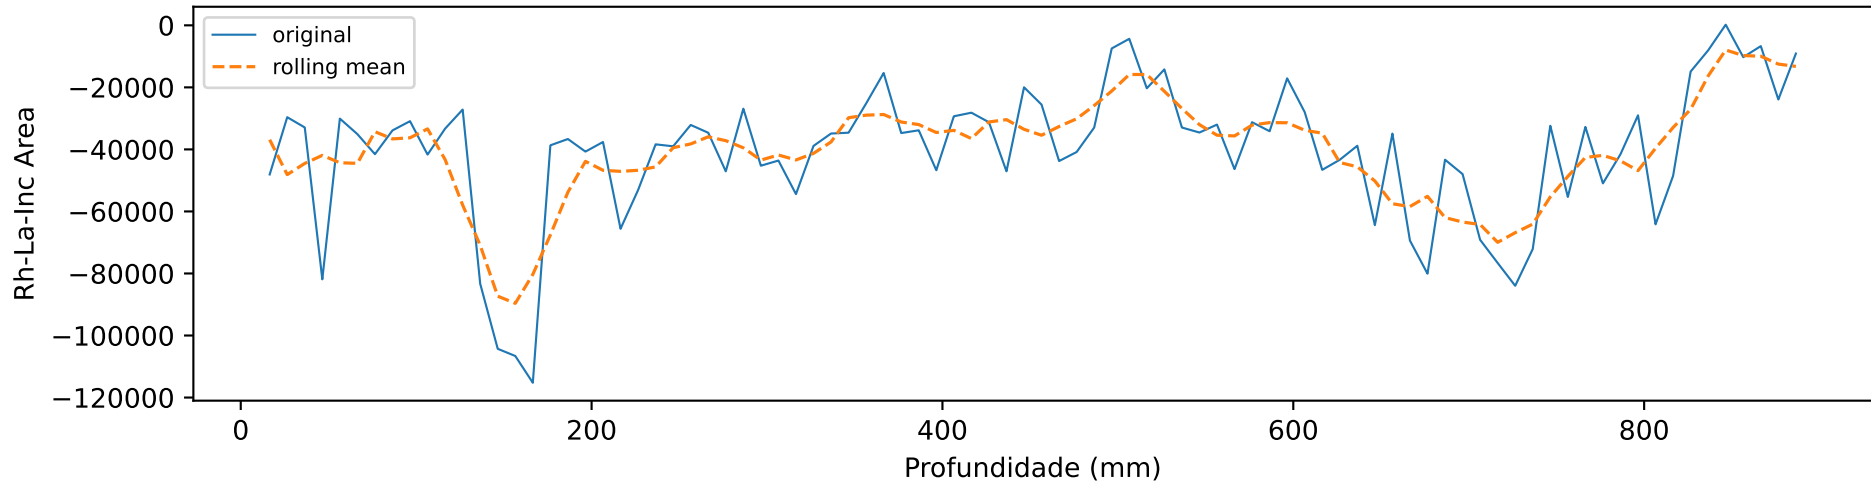


QC5 — Réplicas (Mean RPD)

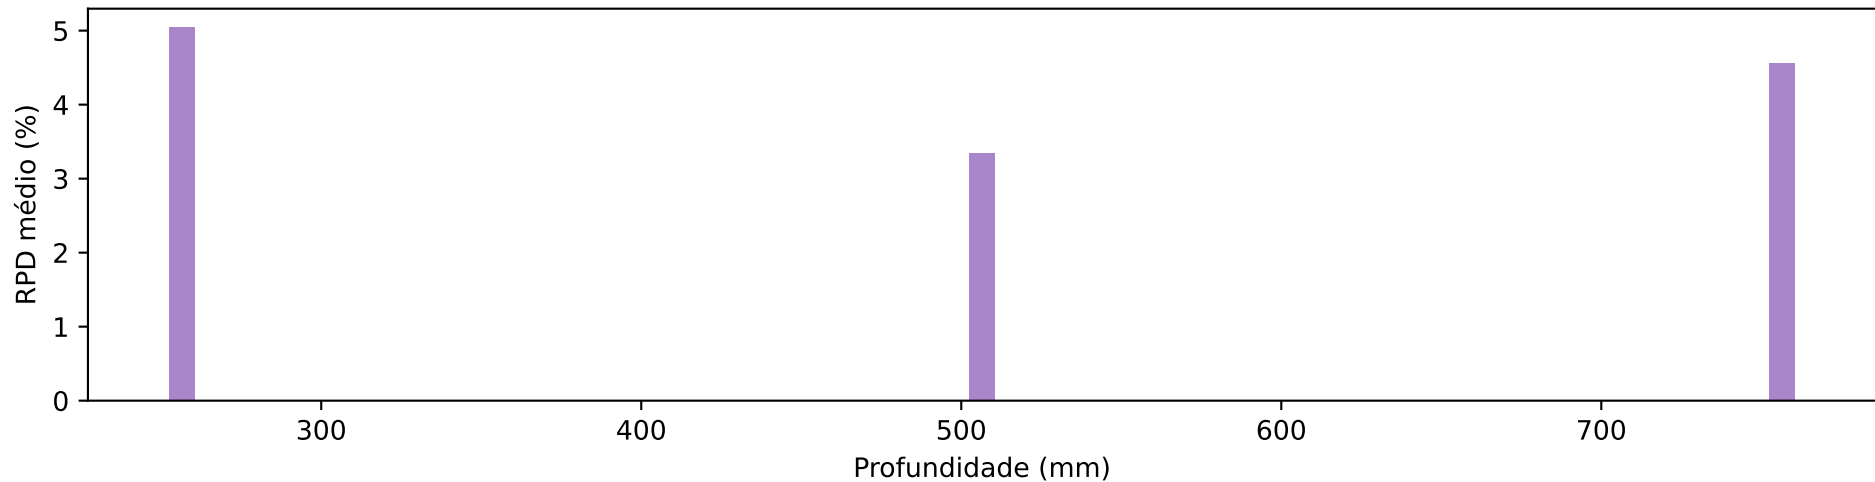

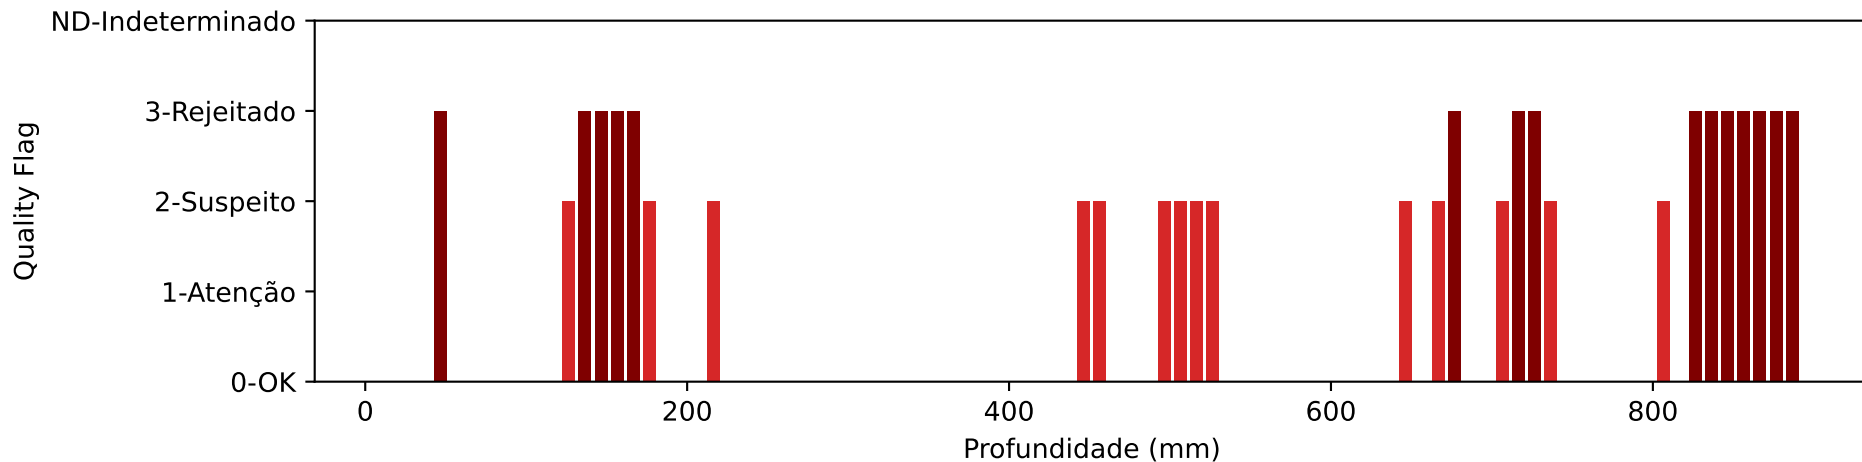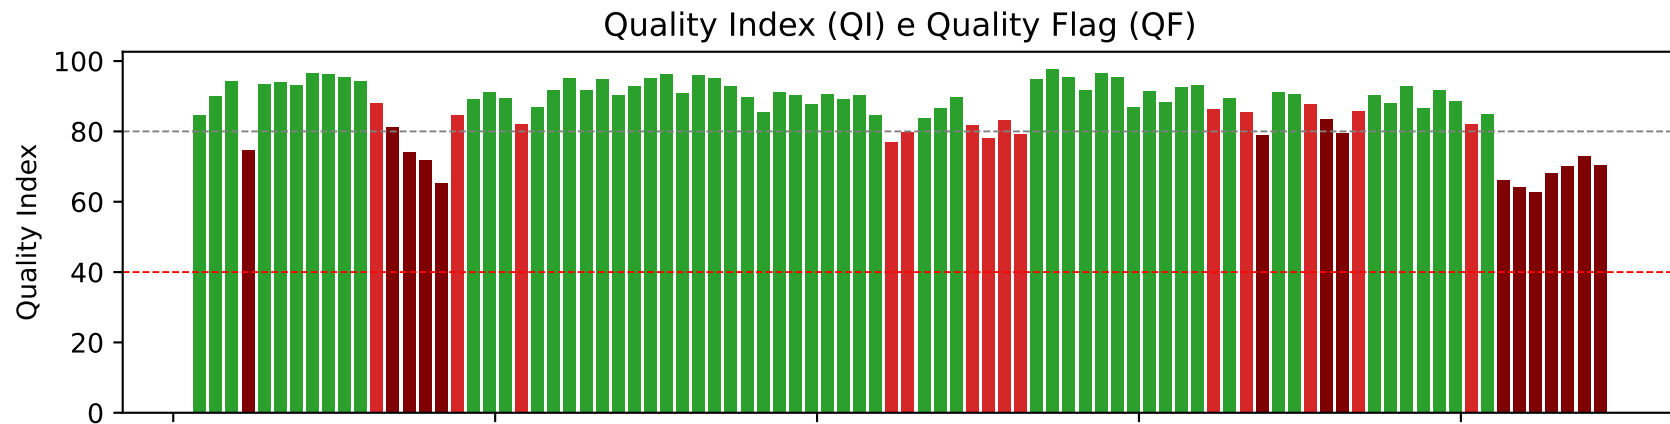

QC6 — PCA (colorido por Mahalanobis)

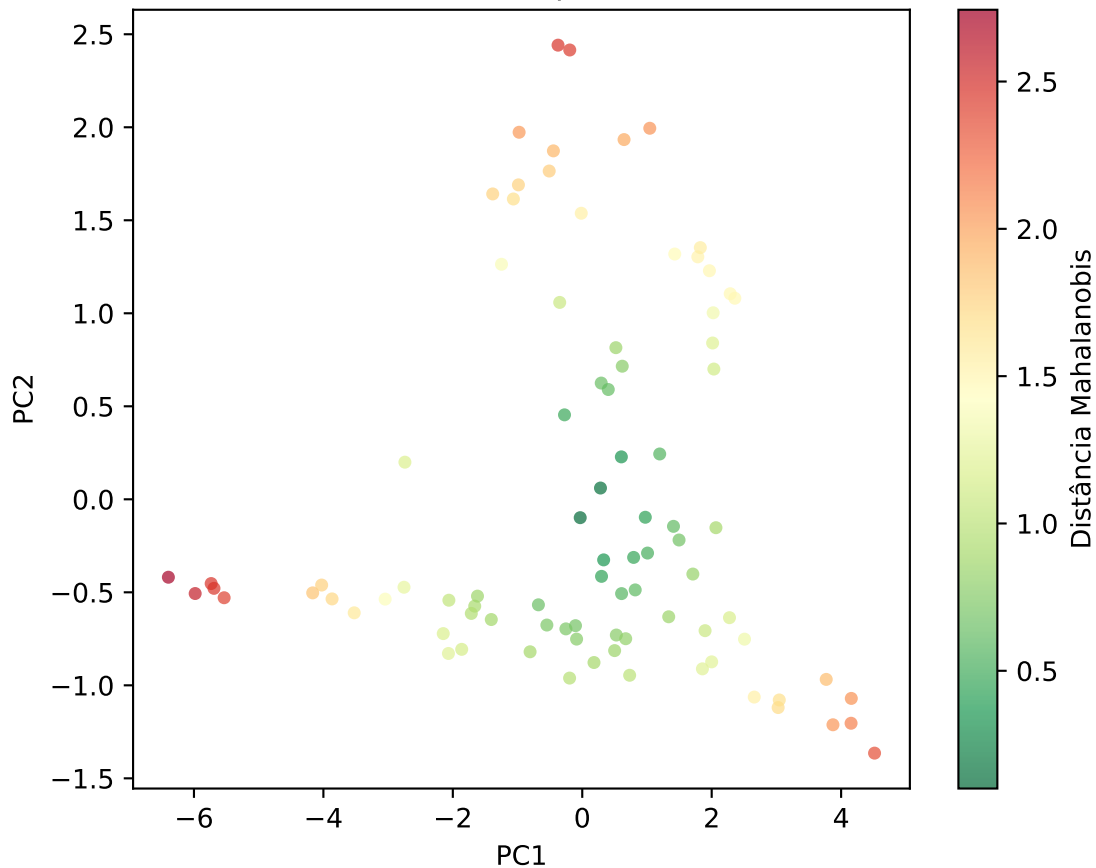


Intervalos Problemáticos

Início (CompositeDepth, mm)	Fim (CompositeDepth, mm)	Nº Medidas	QF Máximo	Causas
46.5	46.5	1	3-Rejeitado	Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC)
126.5	176.5	6	3-Rejeitado Δ	Rh-Lα-Inc, Deriva (Rolling QC)
216.5	216.5	1	2-Suspeito Δ	Rh-Lα-Inc
446.5	456.5	2	2-Suspeito	Rh-Lα, Throughput
496.5	526.5	4	2-Suspeito Δ	Rh-Lα-Inc, Throughput
646.5	676.5	3	3-Rejeitado Δ	Rh-Lα-Inc
706.5	736.5	4	3-Rejeitado Δ	Rh-Lα-Inc
806.5	886.5	8	3-Rejeitado Δ	Argônio (Ar-Kα), Rh-Lα, Rh-Lα-Inc, Throughput


Δ Intervalo(s) marcados foram disparados por um critério pontual (z-score ou Mahalanobis), não pelo QI agregado — o QI permanece em faixa aceitável (≥ 80).

Dados Consolidados|CCE10.xlsx — aba '30kV' (30kV)


QC1 — Estabilidade do Instrumento (Throughput)

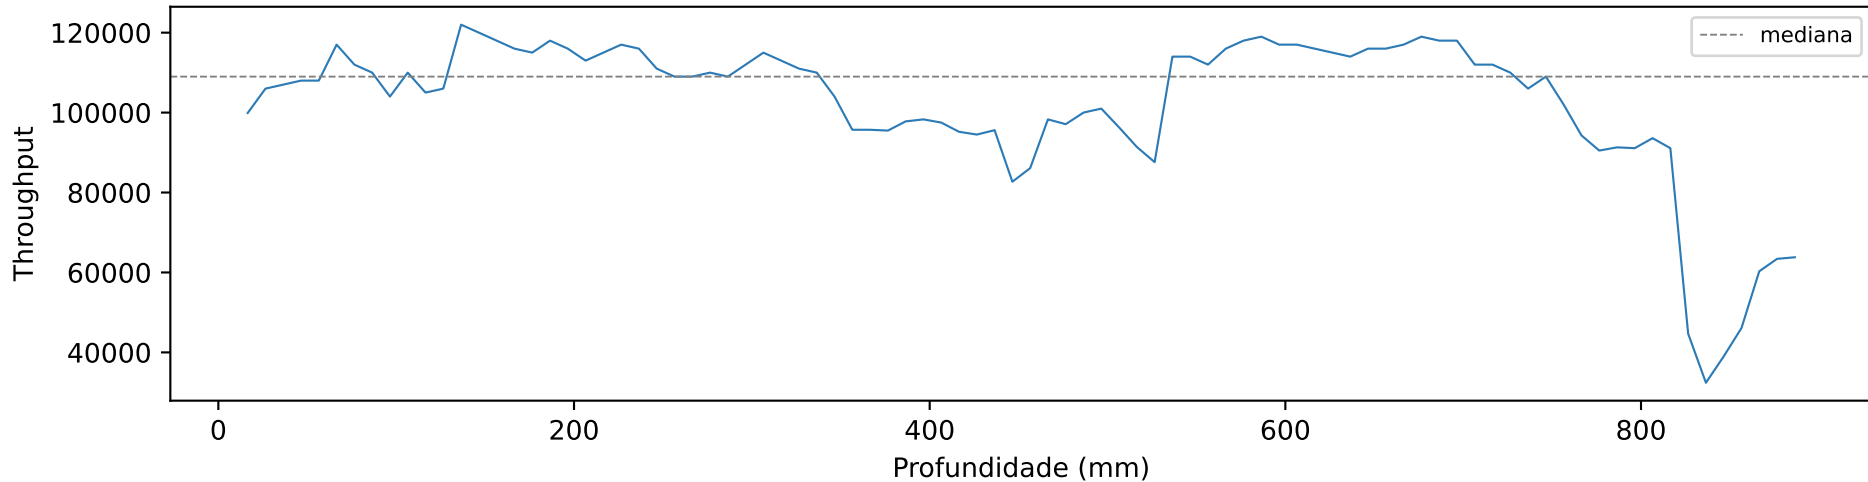


QC2 — Espalhamento Coerente (Rh-L α)

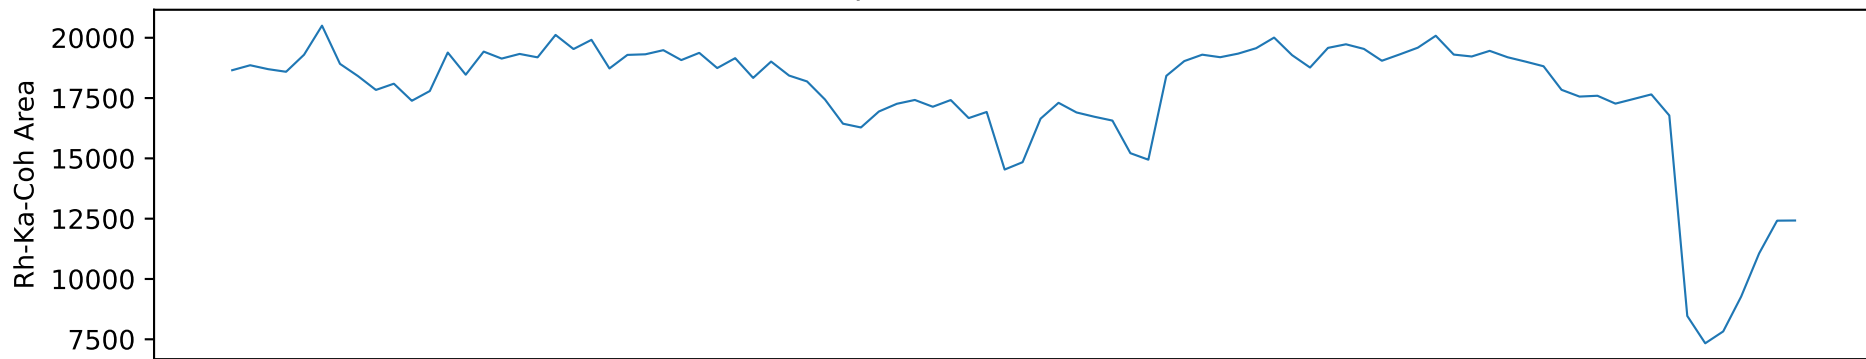


QC3 — Espalhamento Incoerente (Rh-L α -Inc)


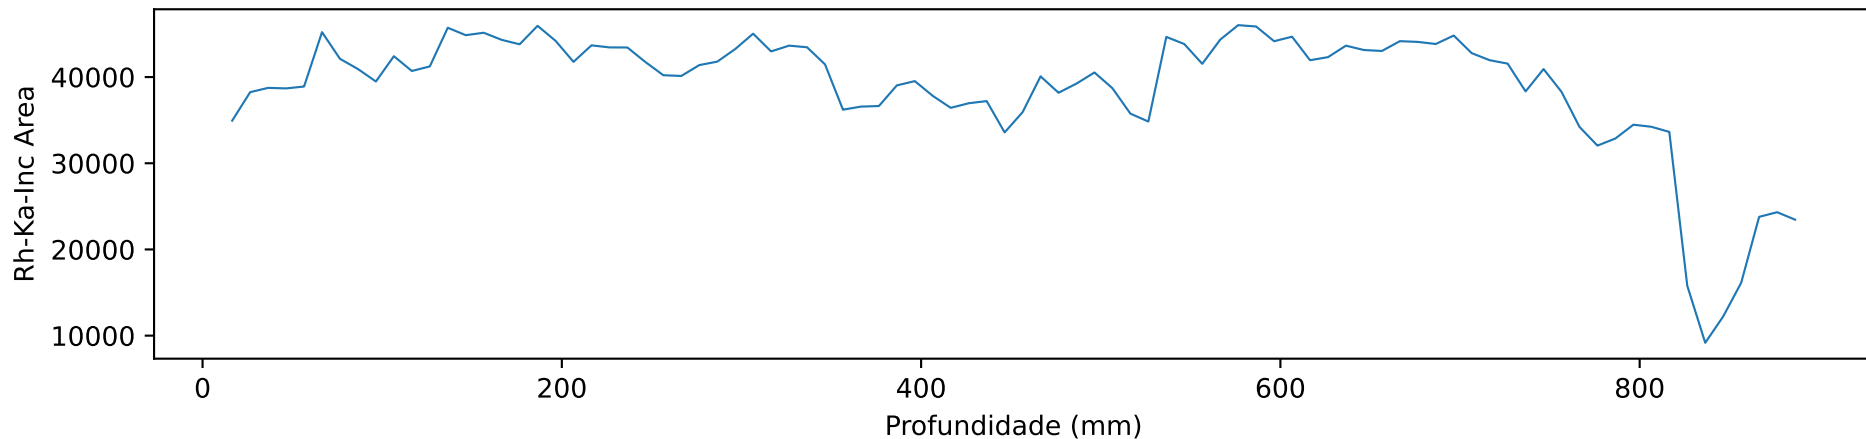


QC4 — Rolling QC (Rh-K α -Inc)

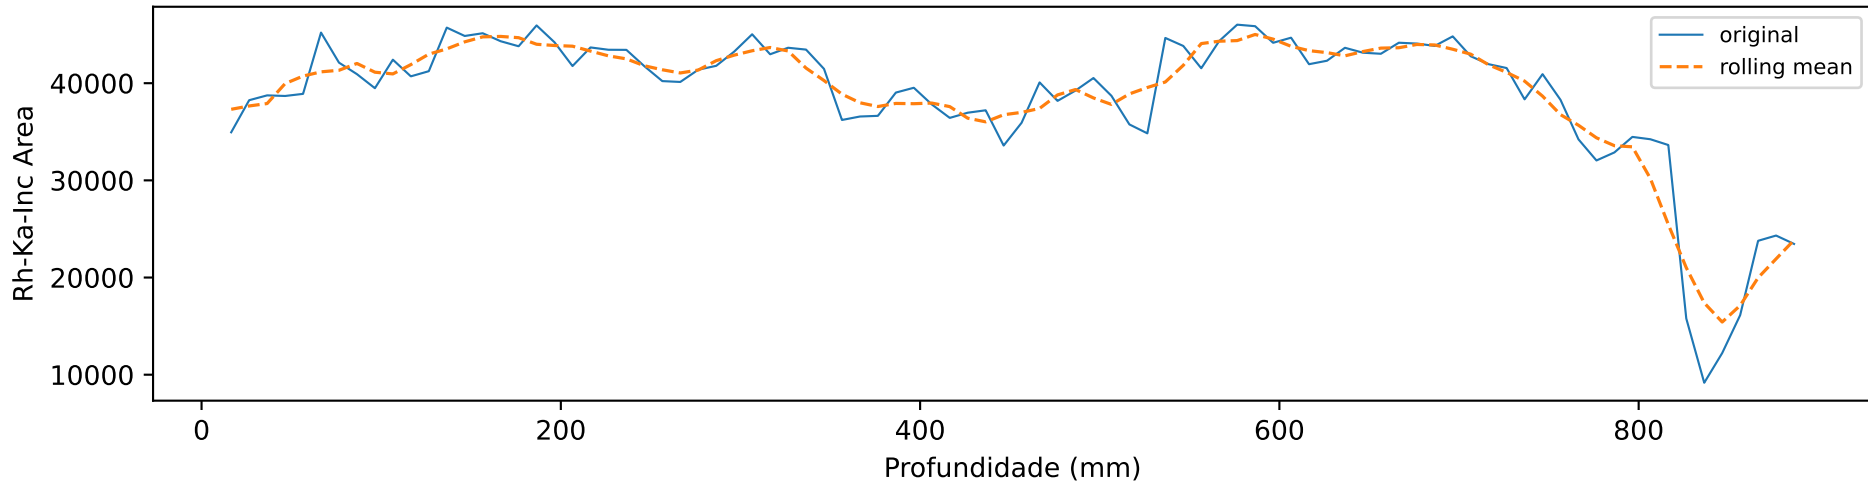


QC5 — Réplicas (Mean RPD)

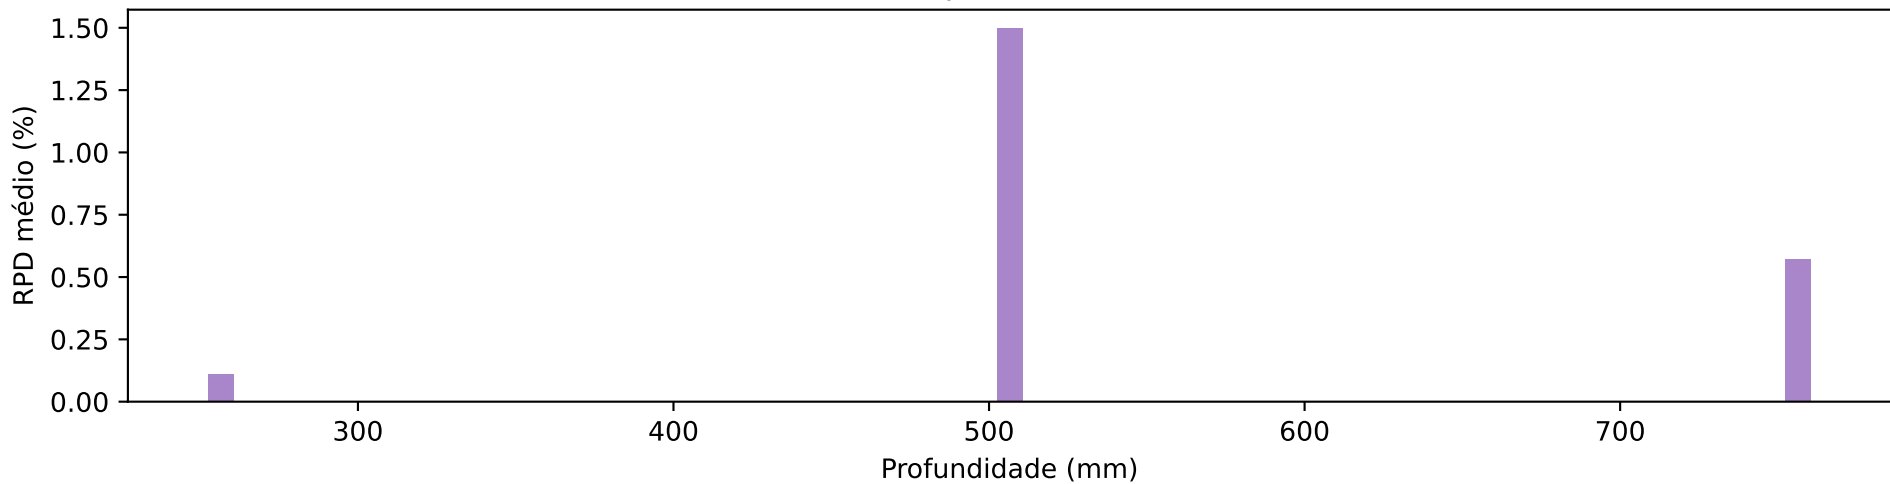

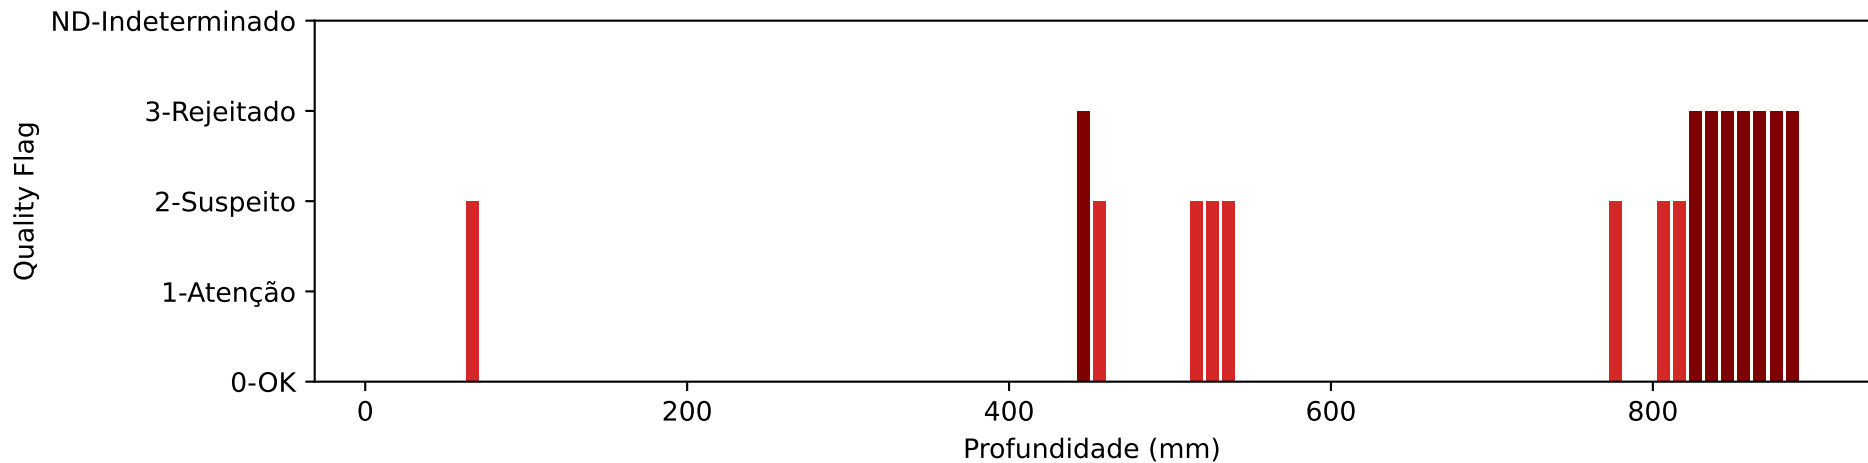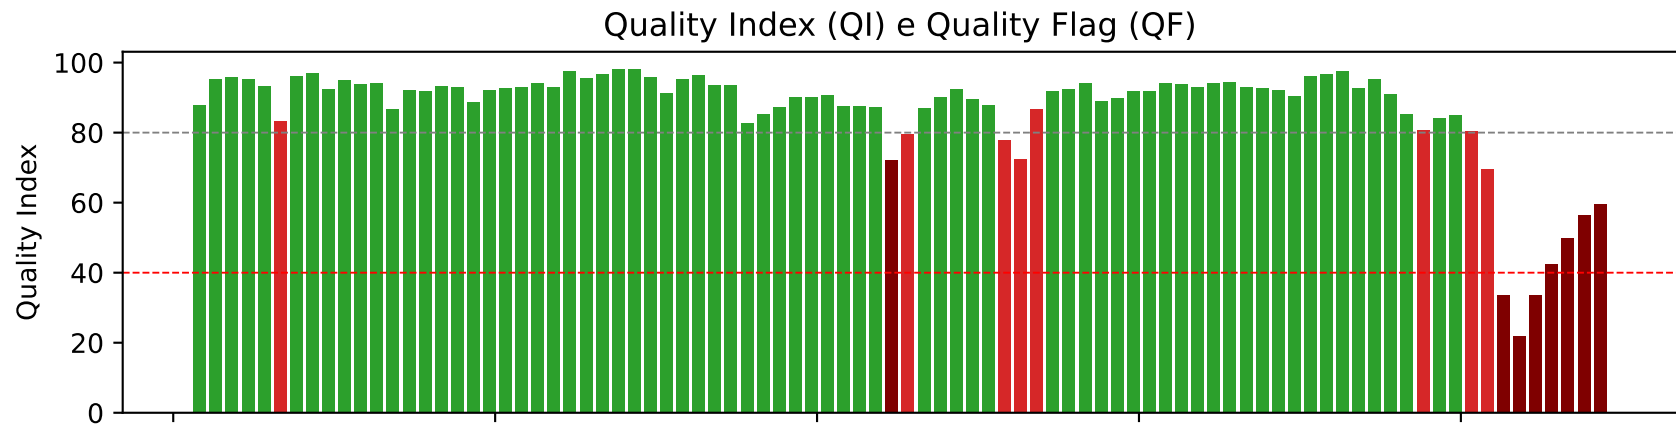

QC6 — PCA (colorido por Mahalanobis)

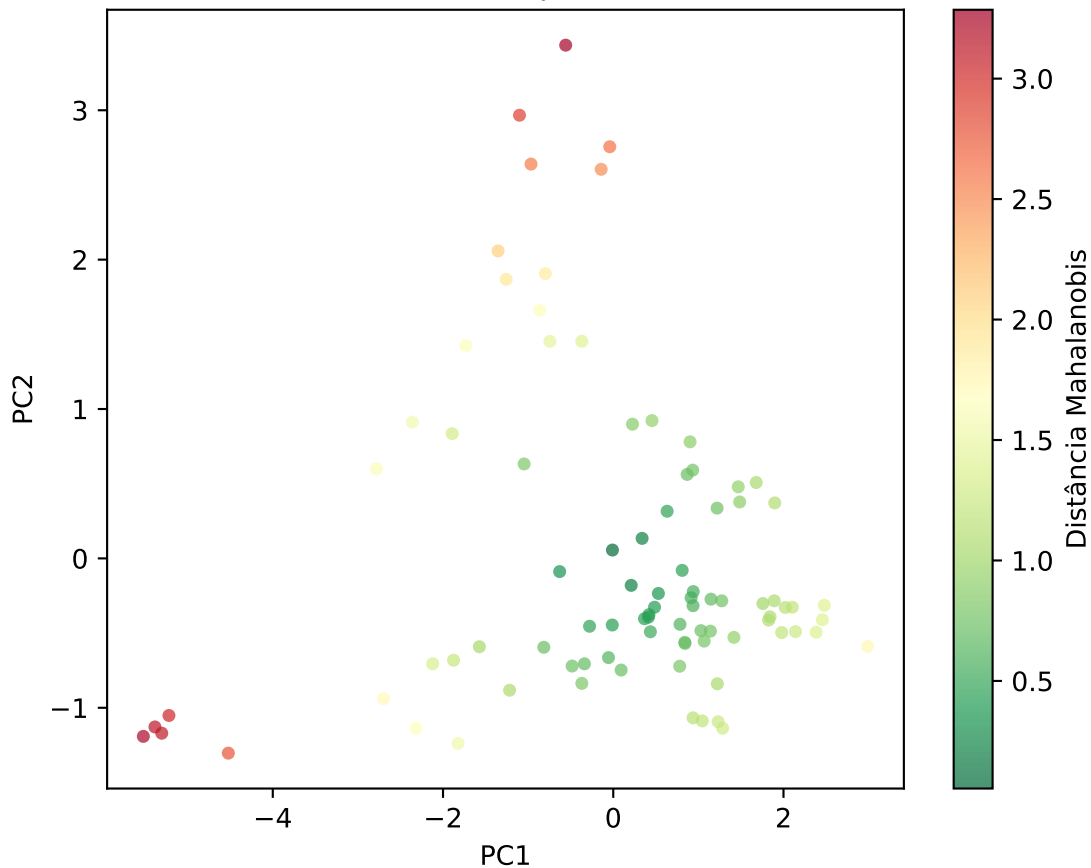


Intervalos Problemáticos

Início (CompositeDepth, mm)	Fim (CompositeDepth, mm)	Nº Medidas	QF Máximo	Causas
66.5	66.5	1	2-Suspeito $\triangle$	Deriva (Rolling QC)
446.5	456.5	2	3-Rejeitado	Rh-L α , Throughput
516.5	536.5	3	2-Suspeito $\triangle$	Rh-L α , Deriva (Rolling QC)
776.5	776.5	1	2-Suspeito $\triangle$	Rh-L α -Inc
806.5	886.5	9	3-Rejeitado $\triangle$	QI baixo, Rh-L α , Rh-L α -Inc, Deriva (Rolling QC), Th


$\triangle$ Intervalo(s) marcados foram disparados por um critério pontual (z-score ou Mahalanobis), não pelo QI agregado — o QI permanece em faixa aceitável (≥ 80).

Dados Consolidados|CCE10.xlsx — aba '50kV' (50kV)


QC1 — Estabilidade do Instrumento (Throughput)


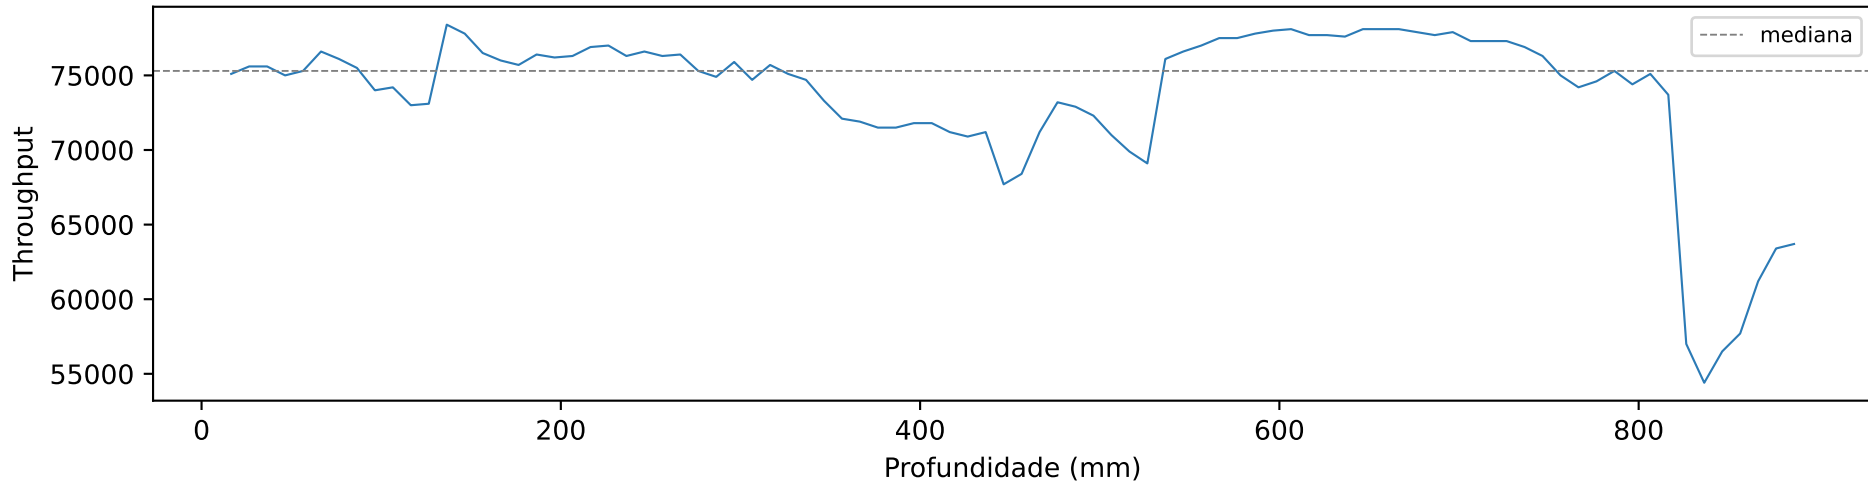


QC4 — Rolling QC (Throughput)

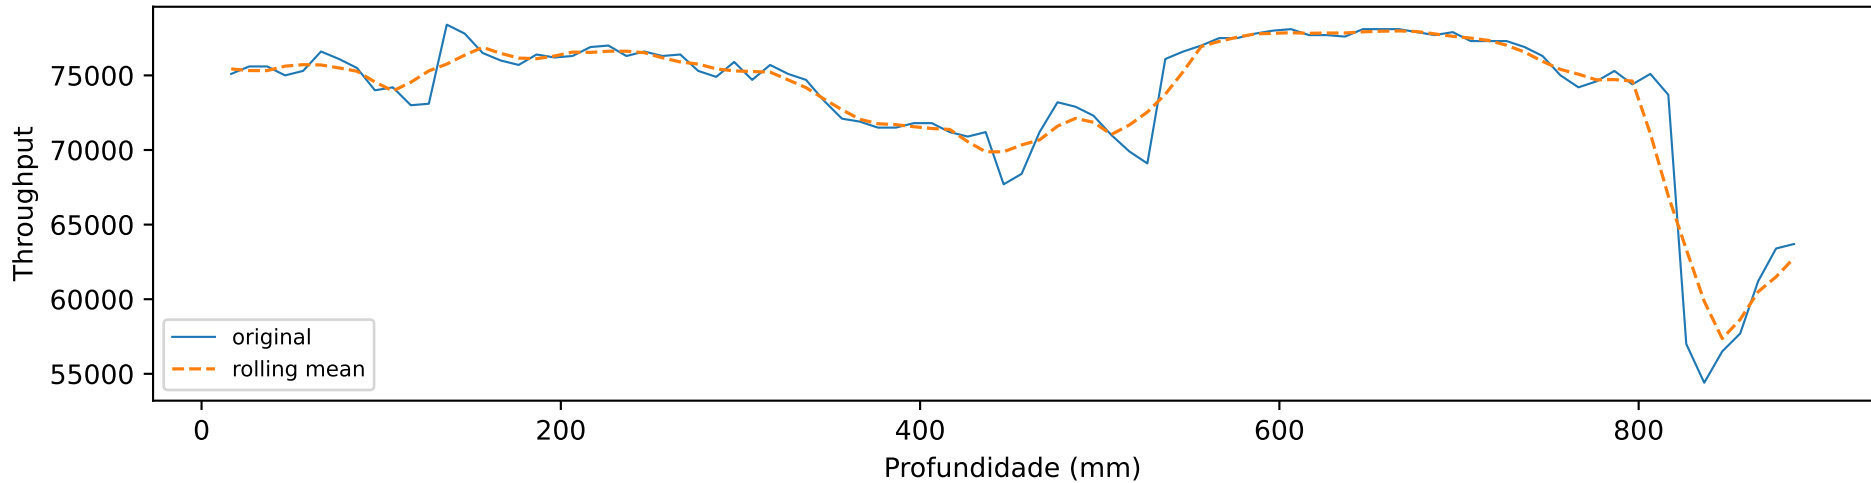


QC5 — Réplicas (Mean RPD)

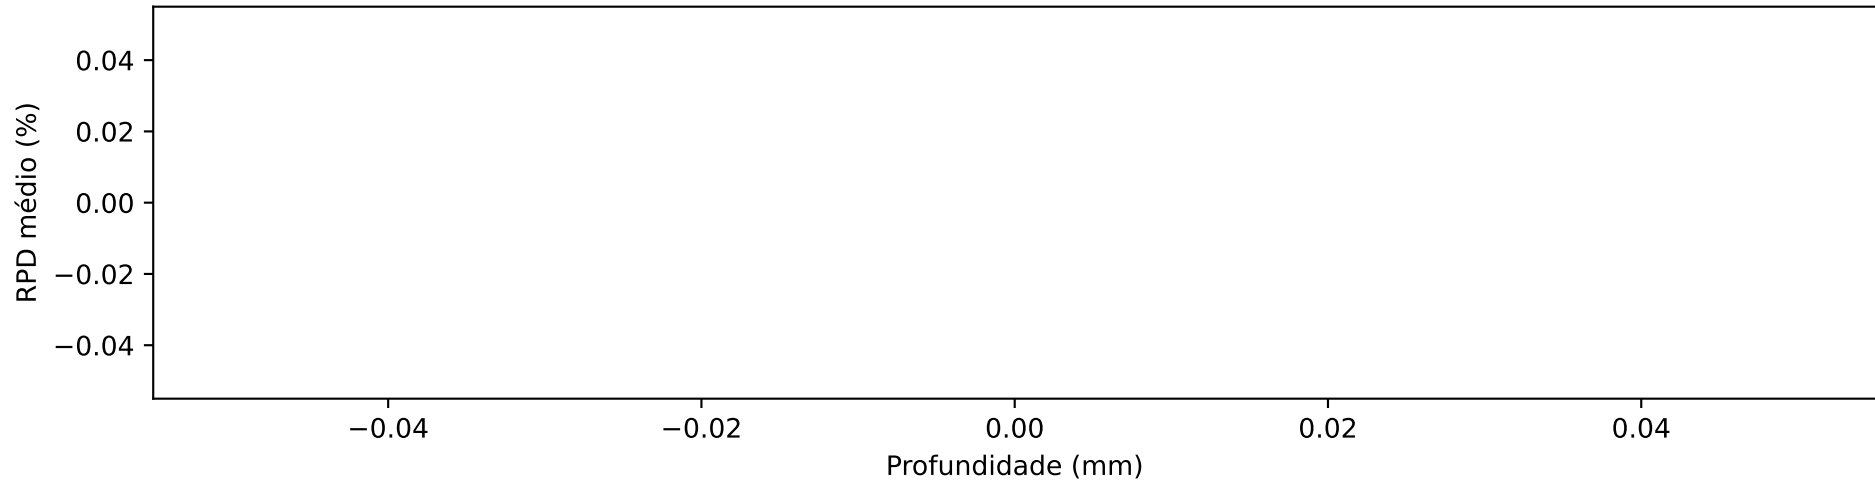

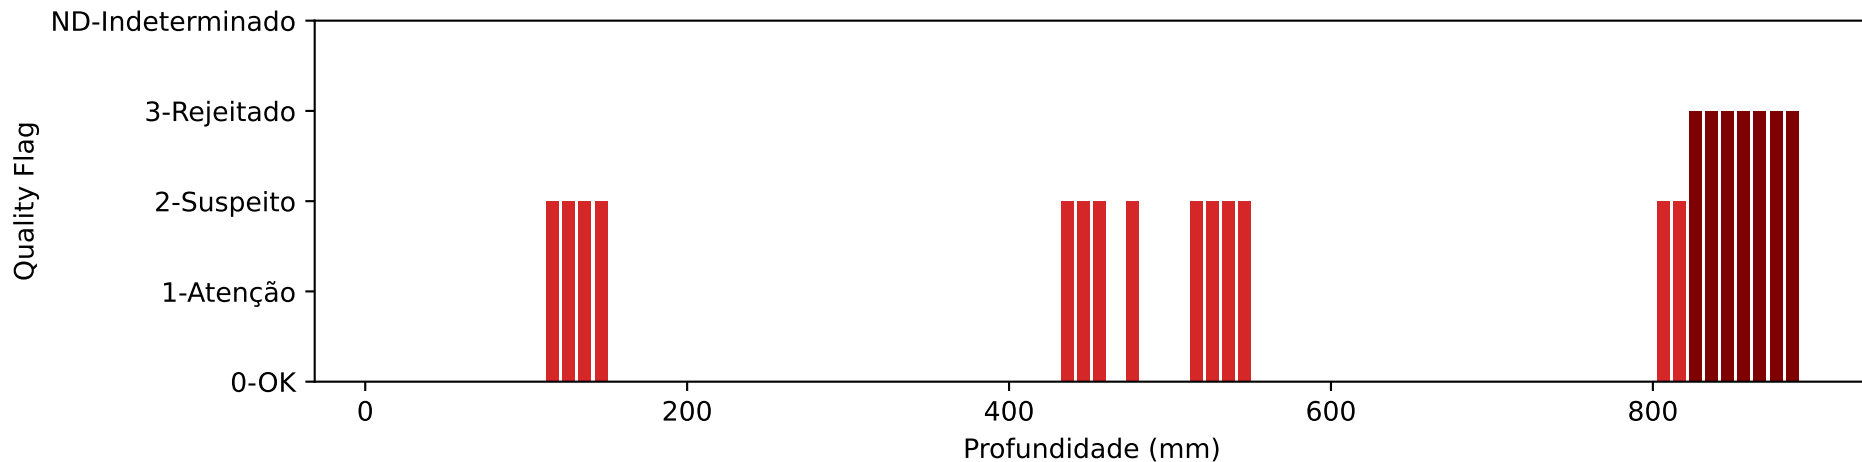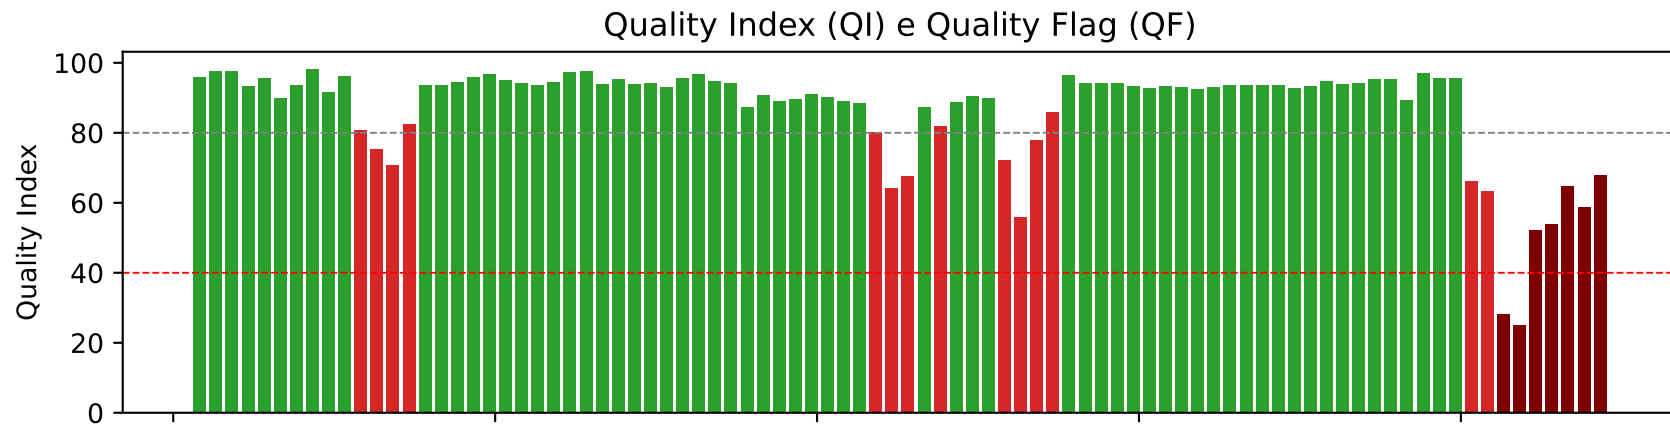

QC6 — PCA (colorido por Mahalanobis)

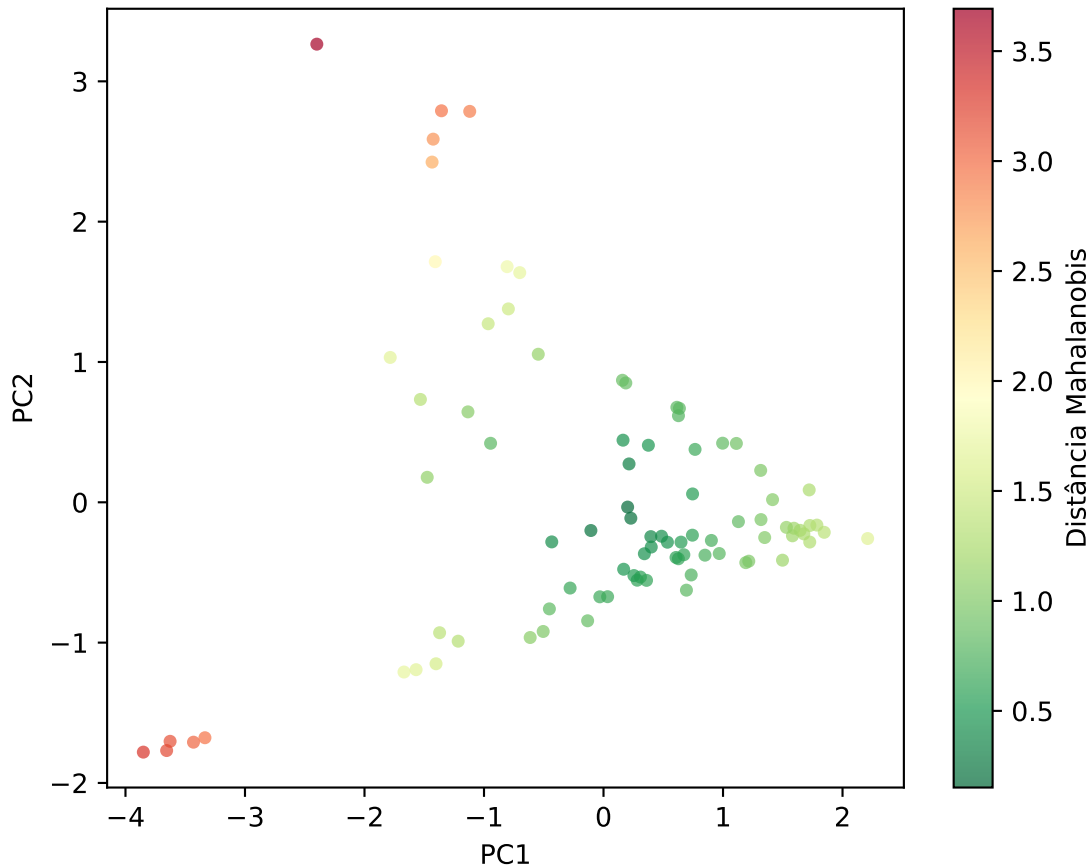

Intervalos Problemáticos

Início (CompositeDepth, mm)	Fim (CompositeDepth, mm)	Nº Medidas	QF Máximo	Causas
116.5	146.5	4	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC)
436.5	476.5	4	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC), Throughput
516.5	546.5	4	2-Suspeito ⚠	Deriva (Rolling QC), Throughput
806.5	886.5	9	3-Rejeitado	QI baixo, Deriva (Rolling QC), Throughput

⚠ Intervalo(s) marcados foram disparados por um critério pontual (z-score ou Mahalanobis), não pelo QI agregado — o QI permanece em faixa aceitável (≥ 80).