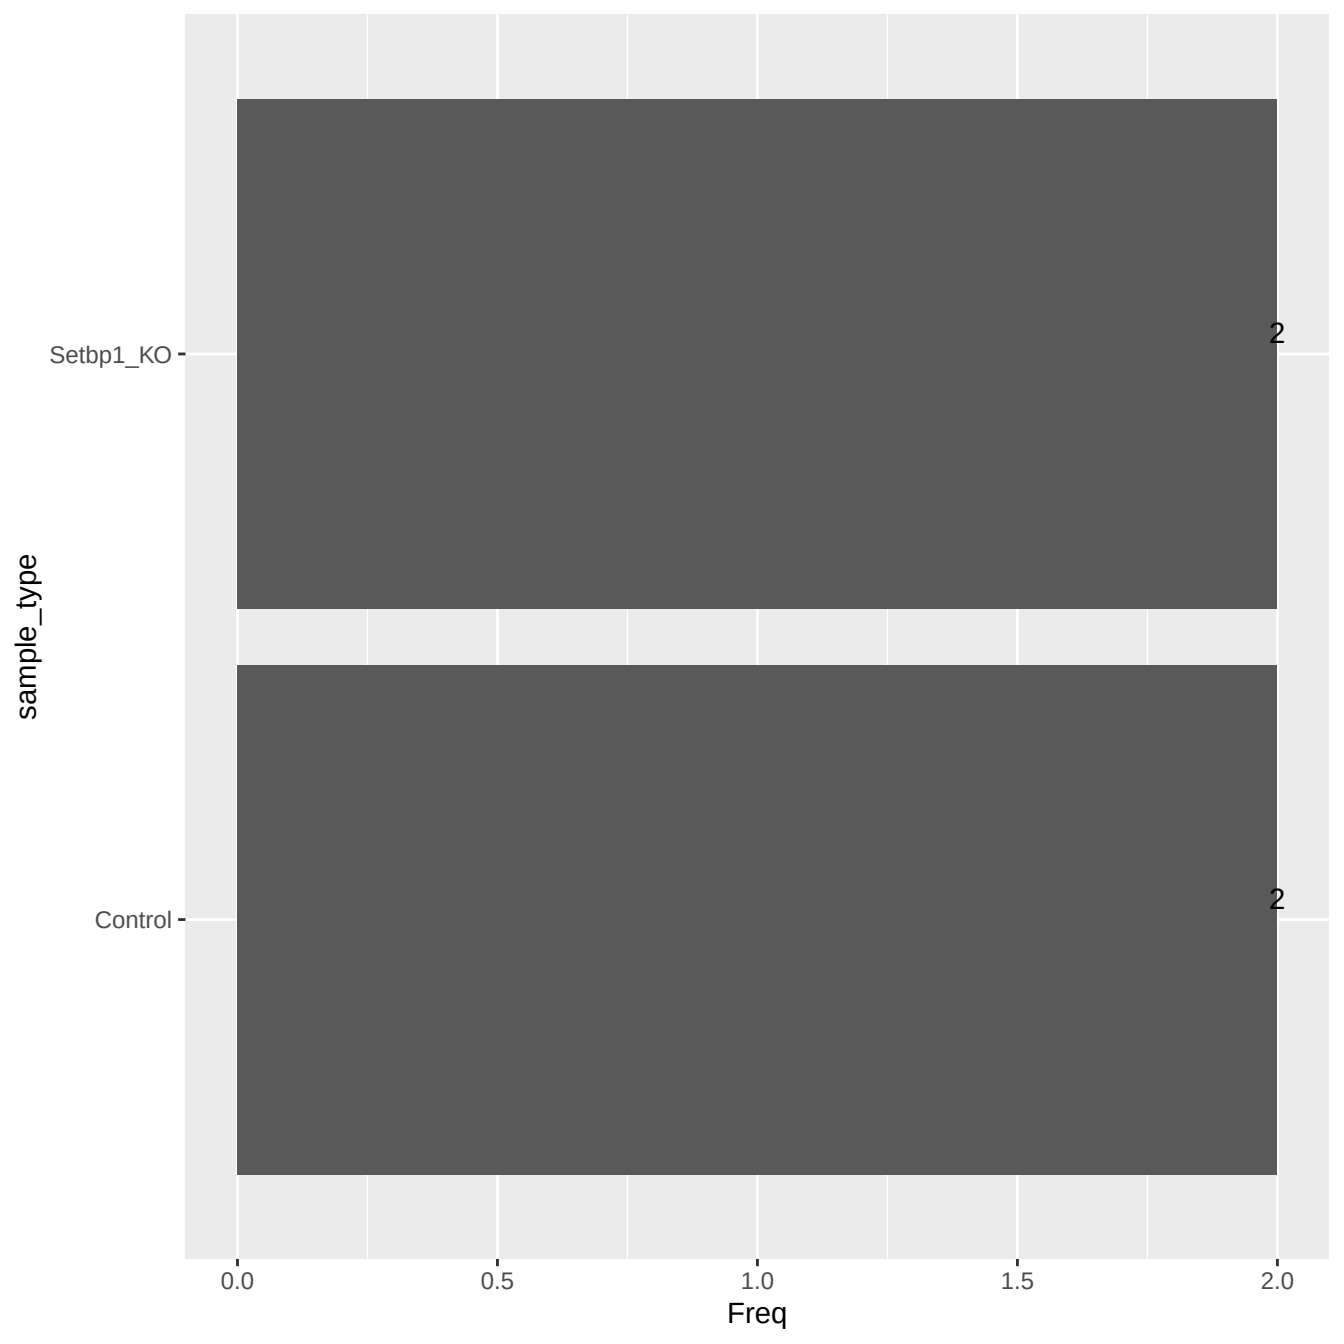
Setbp1_KO
Control
sample_type
2
2
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Freq

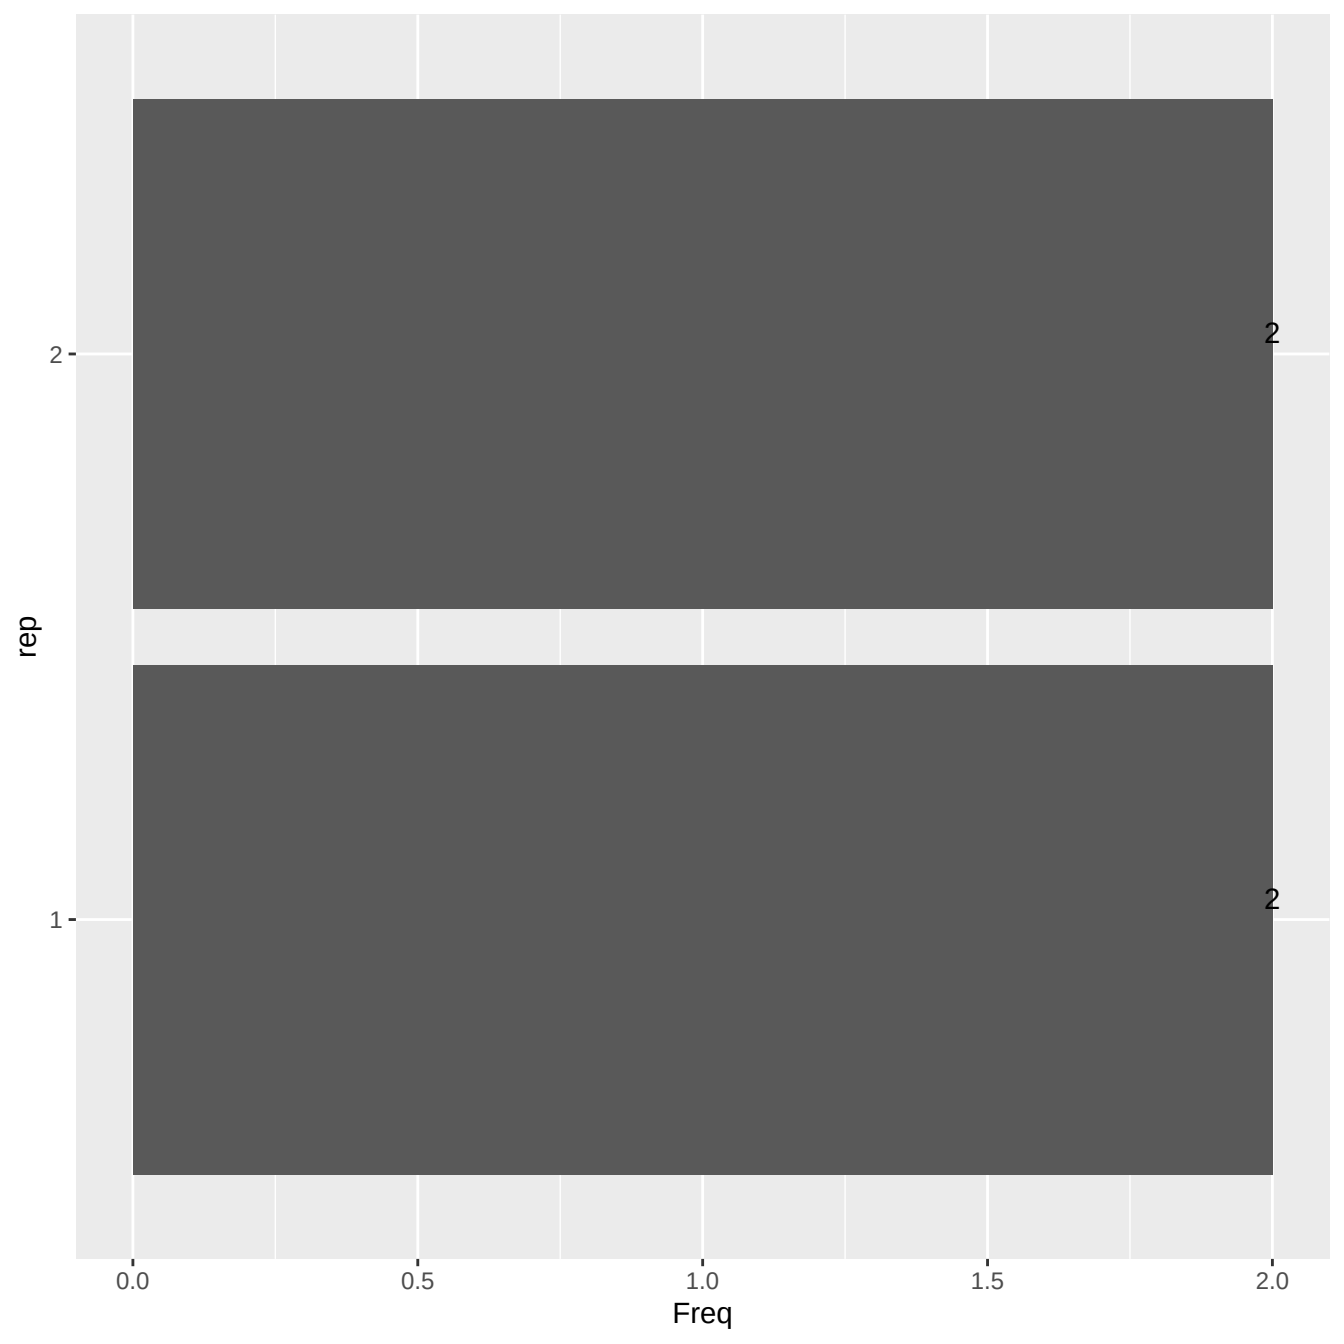
rep
2
1
2
2
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Freq

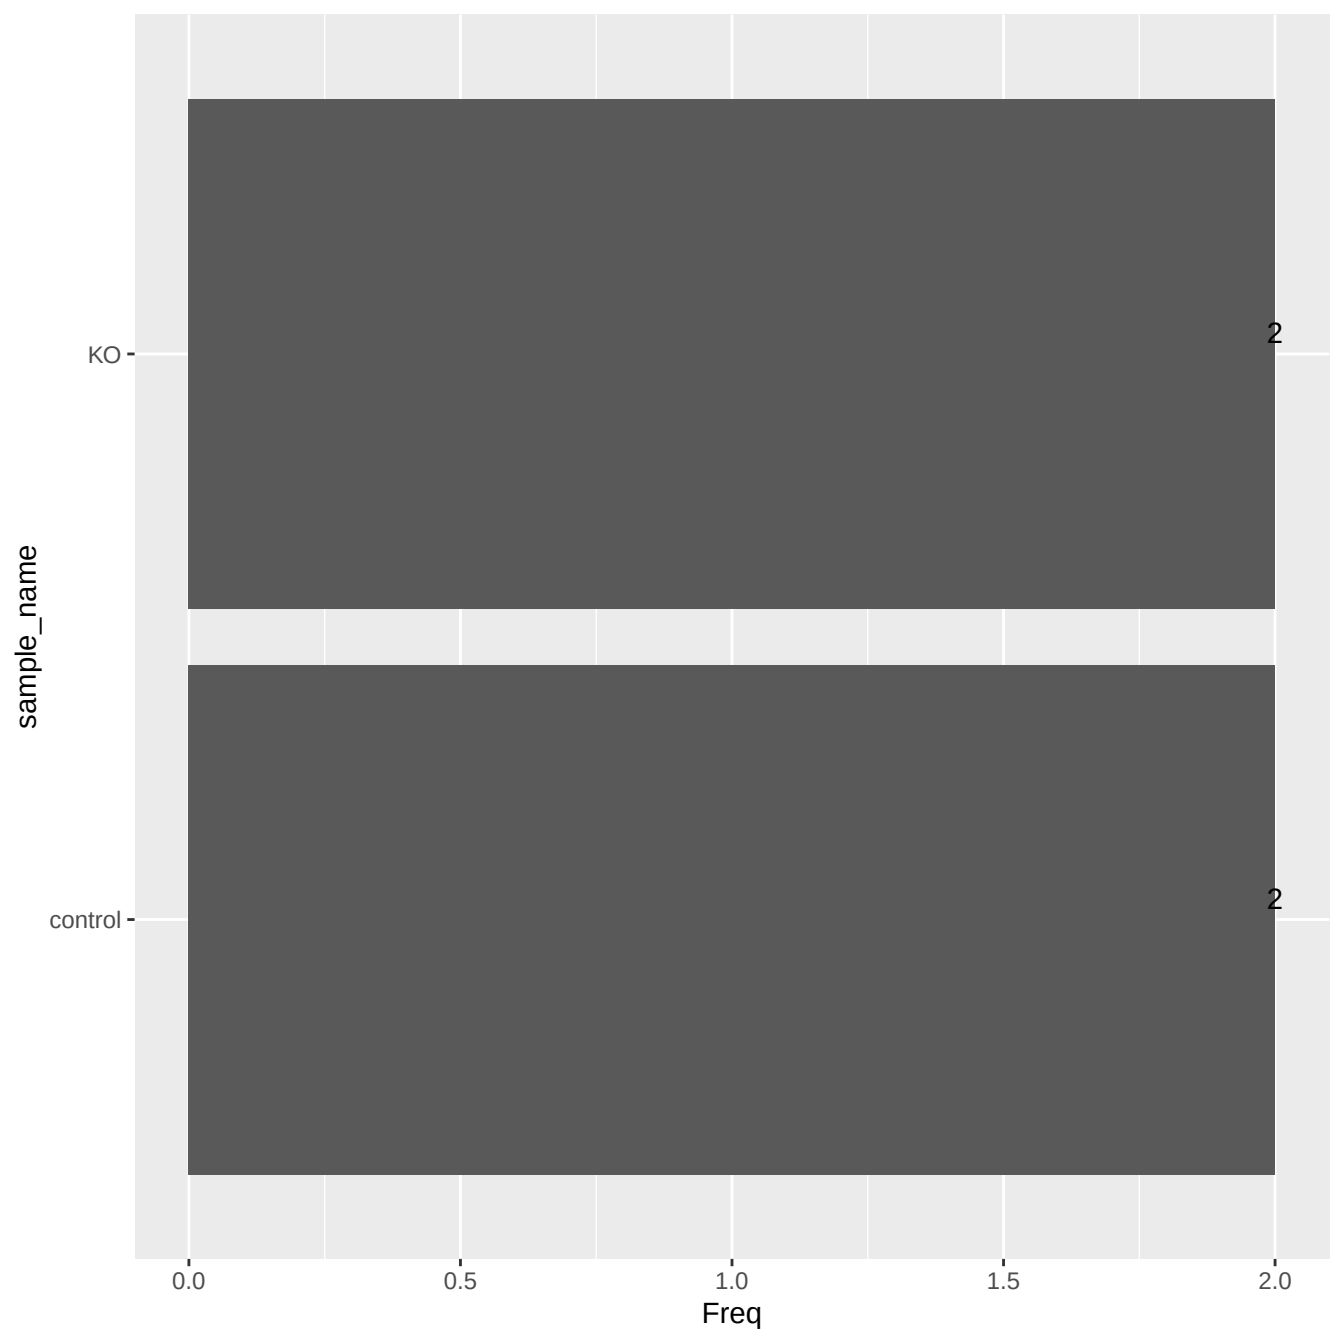
sample_name
KO
control
2
2
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Freq

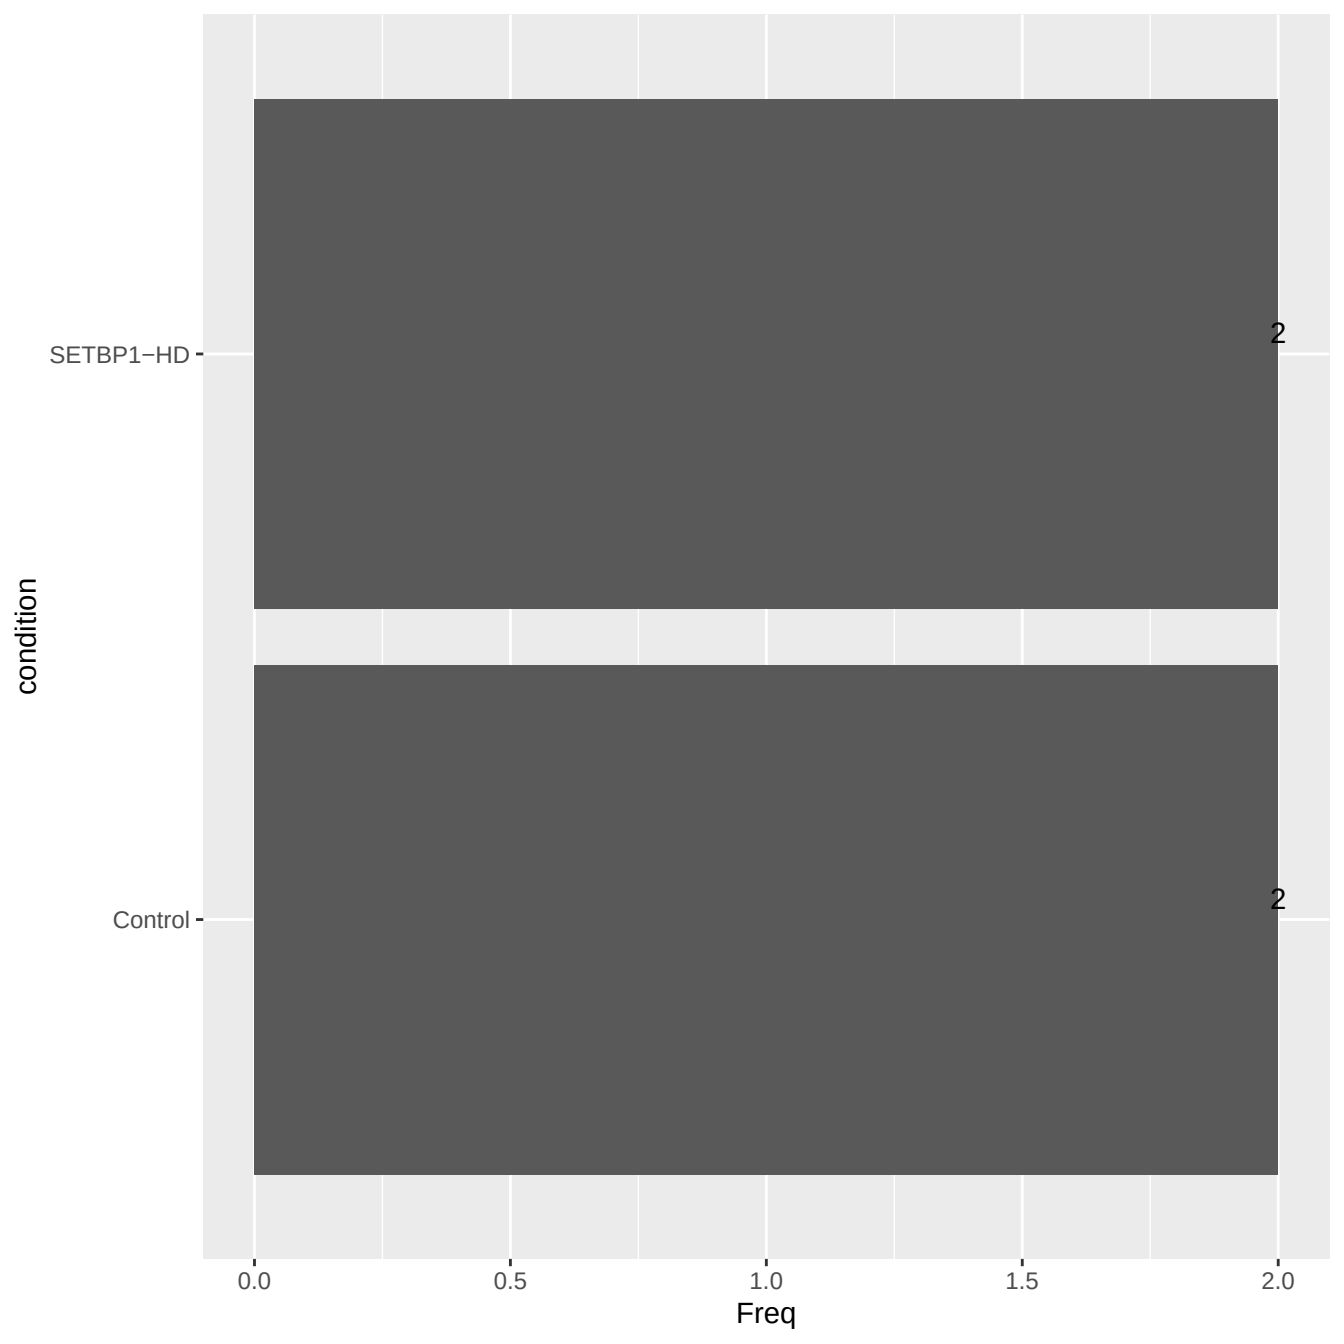
SETBP1−HD
Control
condition
2
2
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Freq

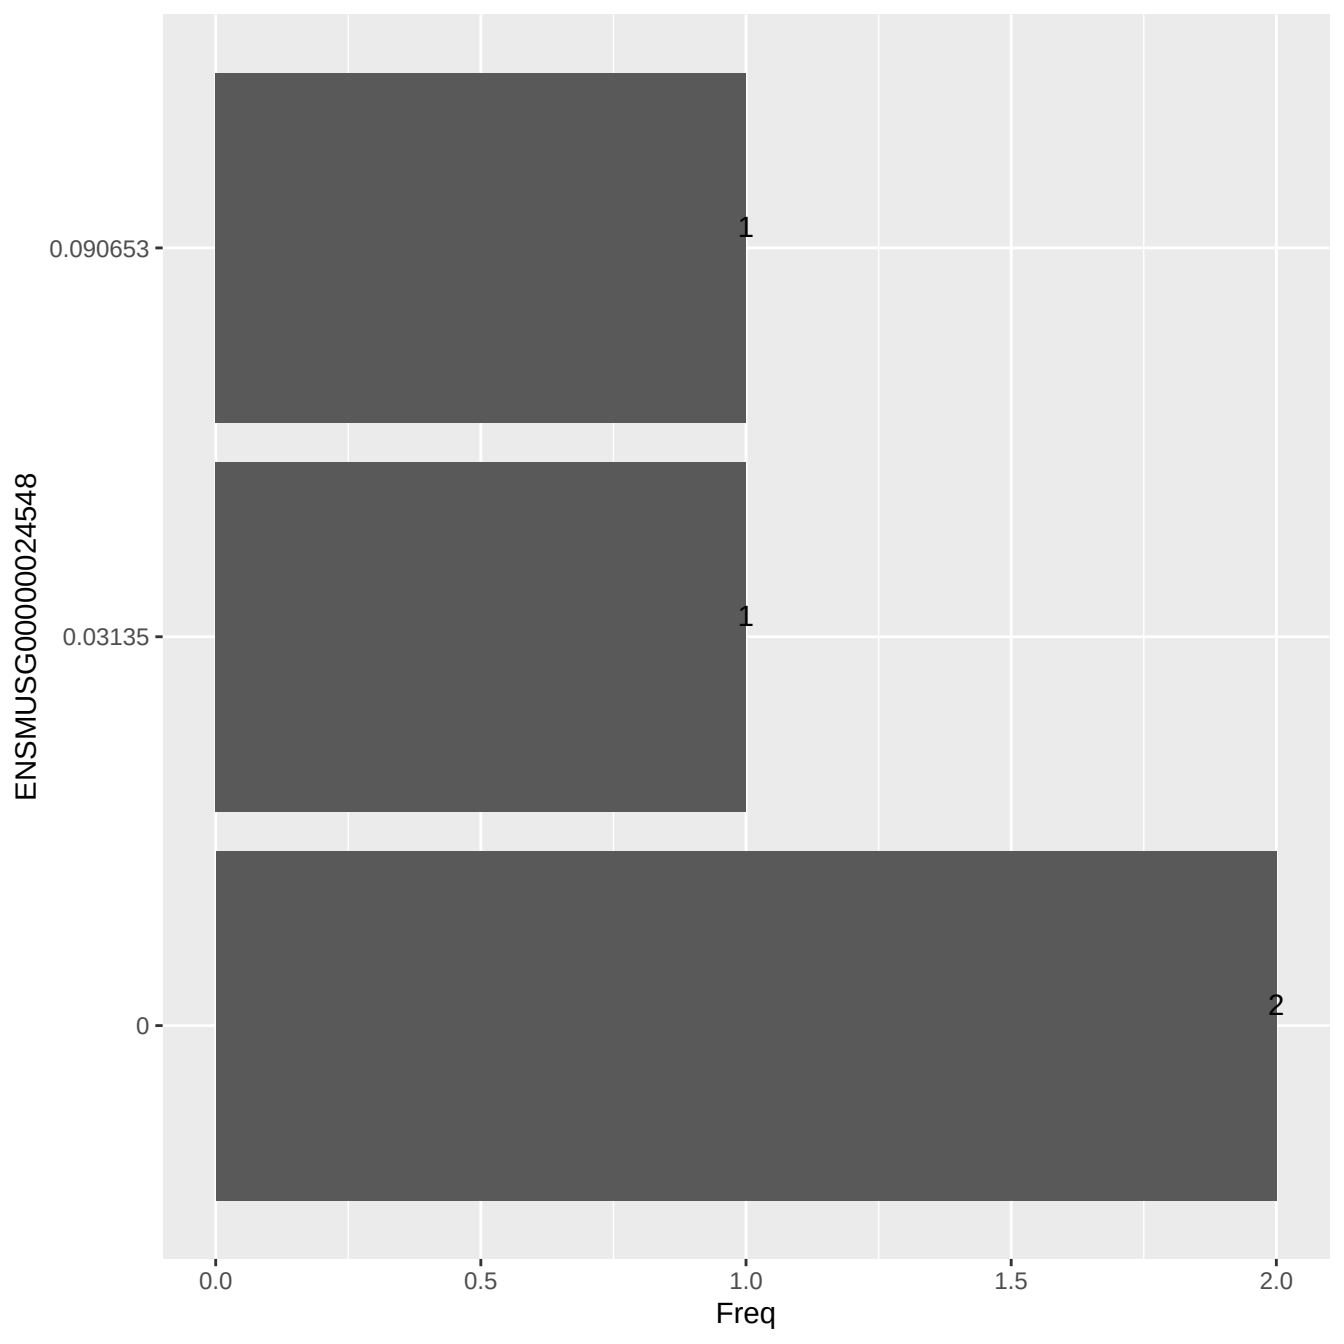
ENSMUSG00000024548
0.090653
0.03135
0
1
1
2
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
Freq