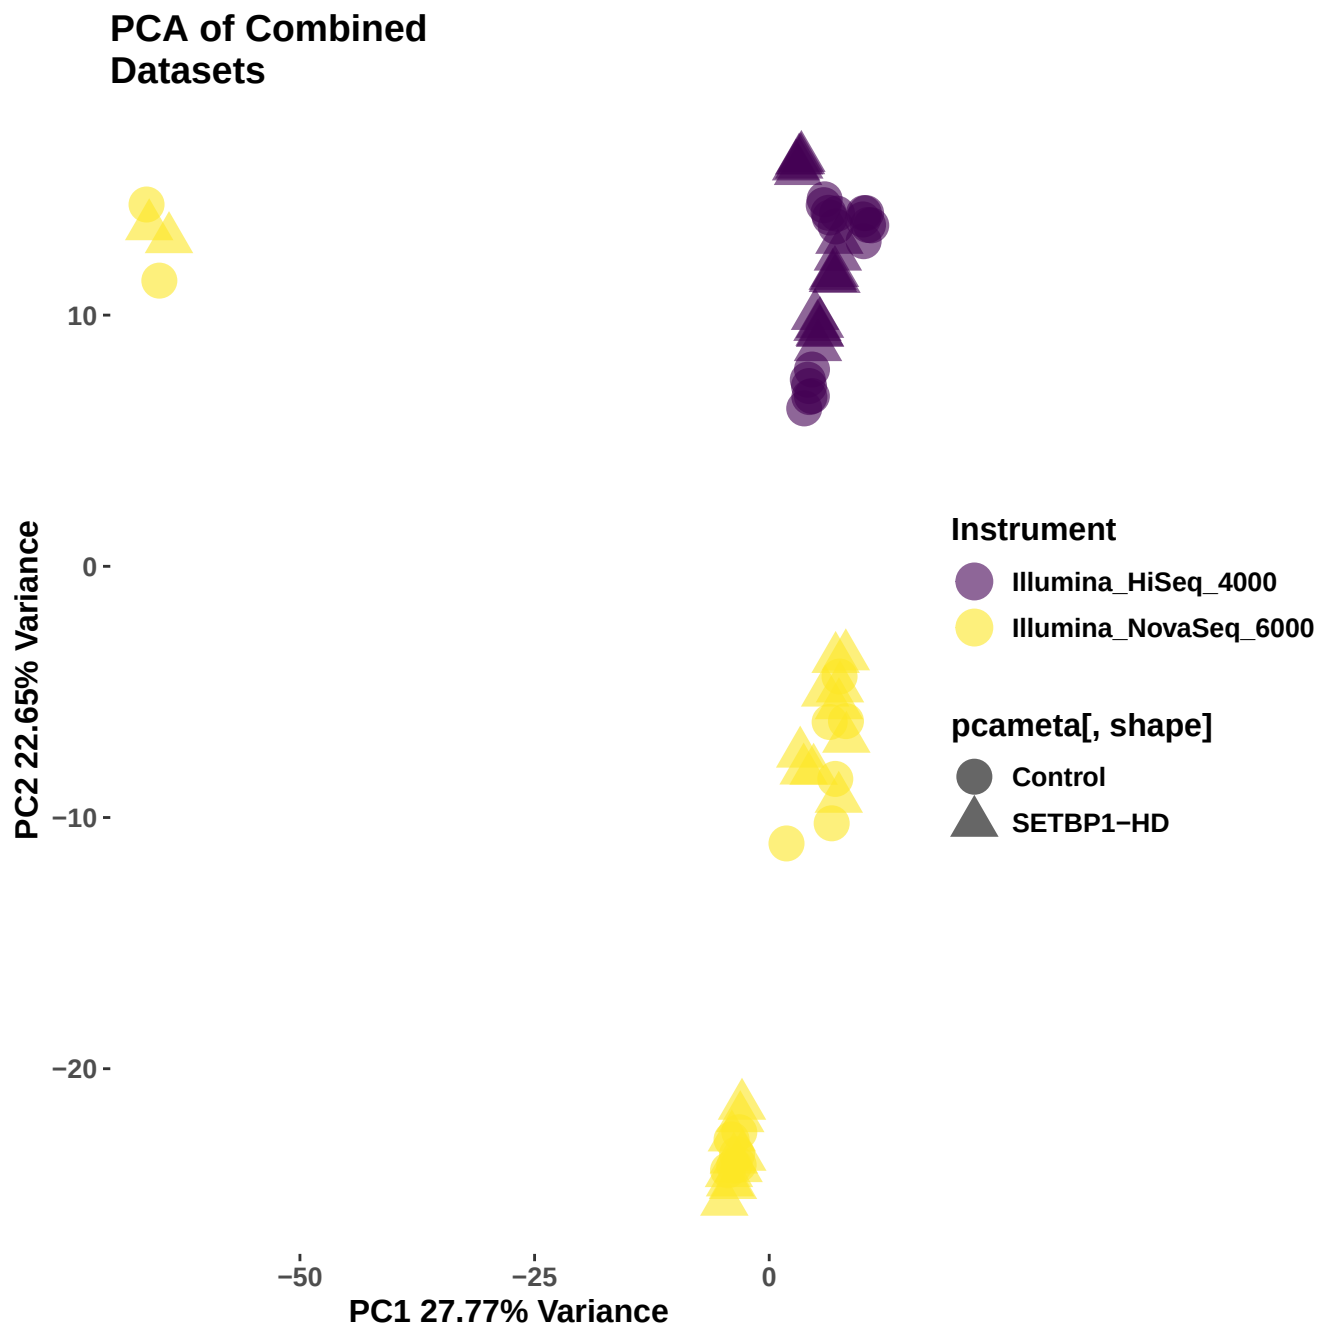
PCA of Combined Datasets
10
0
−10
−20
PC2 22.65% Variance
−50
−25
0
PC1 27.77% Variance
Instrument
Illumina_HiSeq_4000
Illumina_NovaSeq_6000
pcameta[, shape]
Control
SETBP1−HD

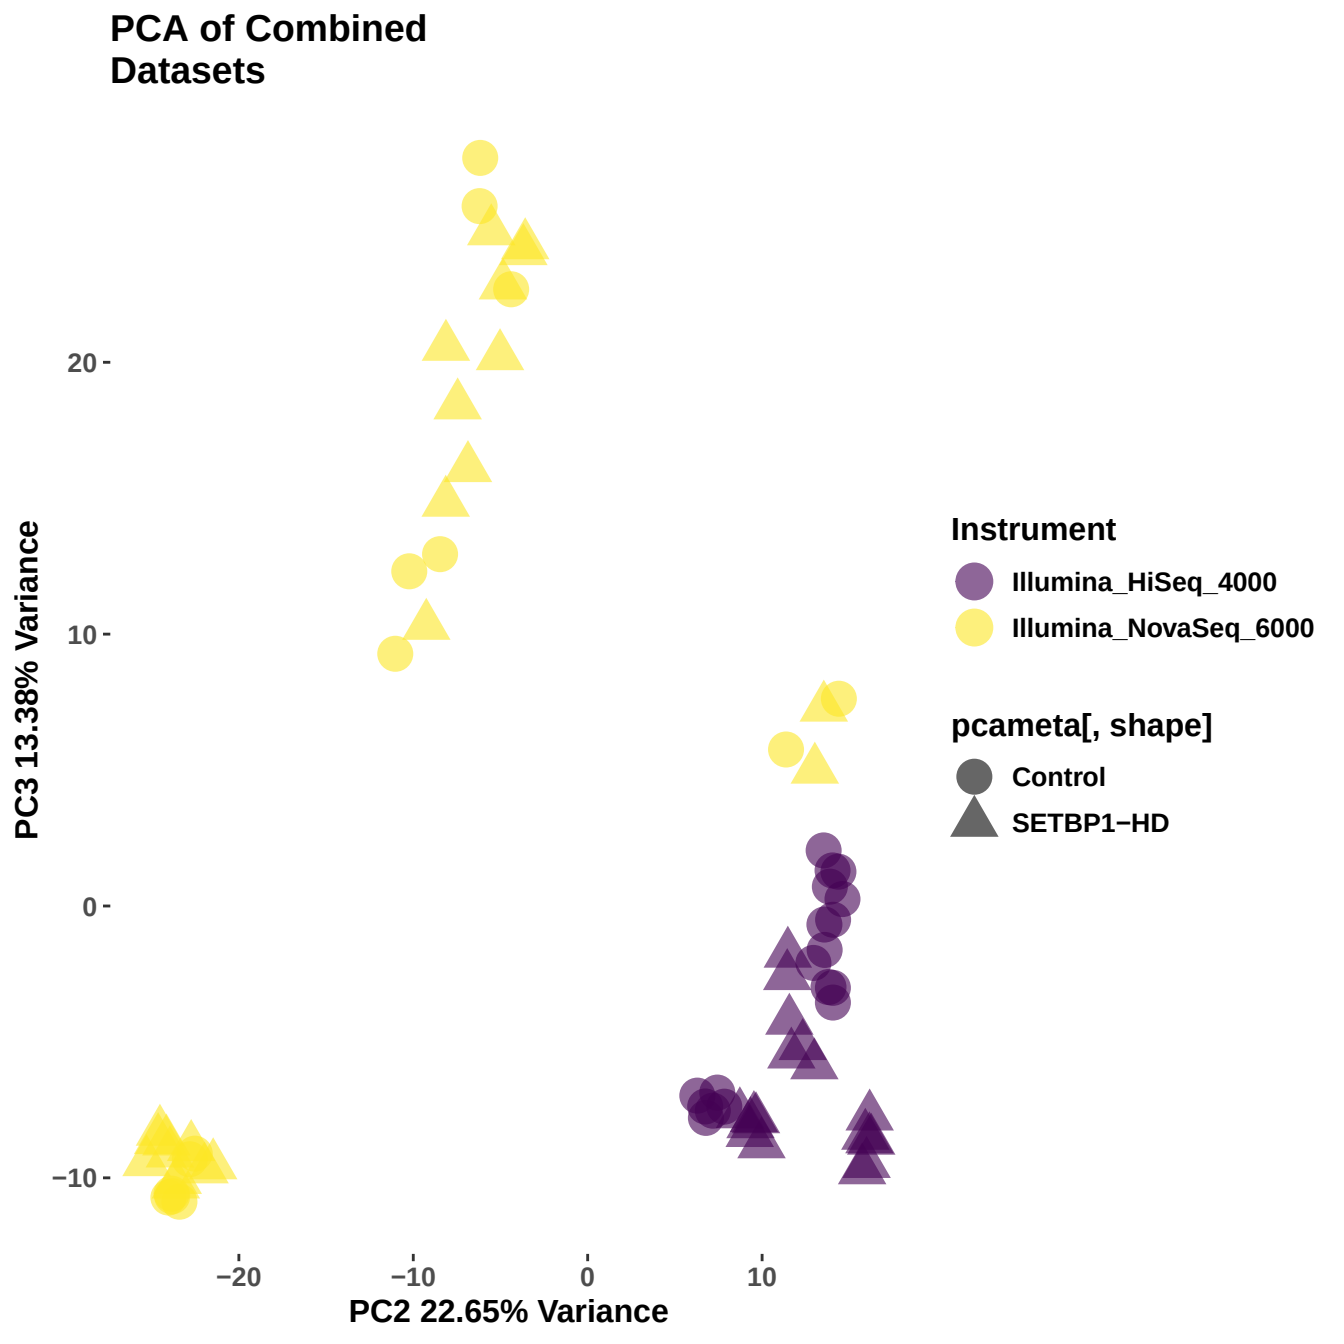
PCA of Combined Datasets
PC3 13.38% Variance
PC2 22.65% Variance
20
10
0
−10
−20
−10
0
10
Instrument
Illumina_HiSeq_4000
Illumina_NovaSeq_6000
pcameta[, shape]
Control
SETBP1−HD

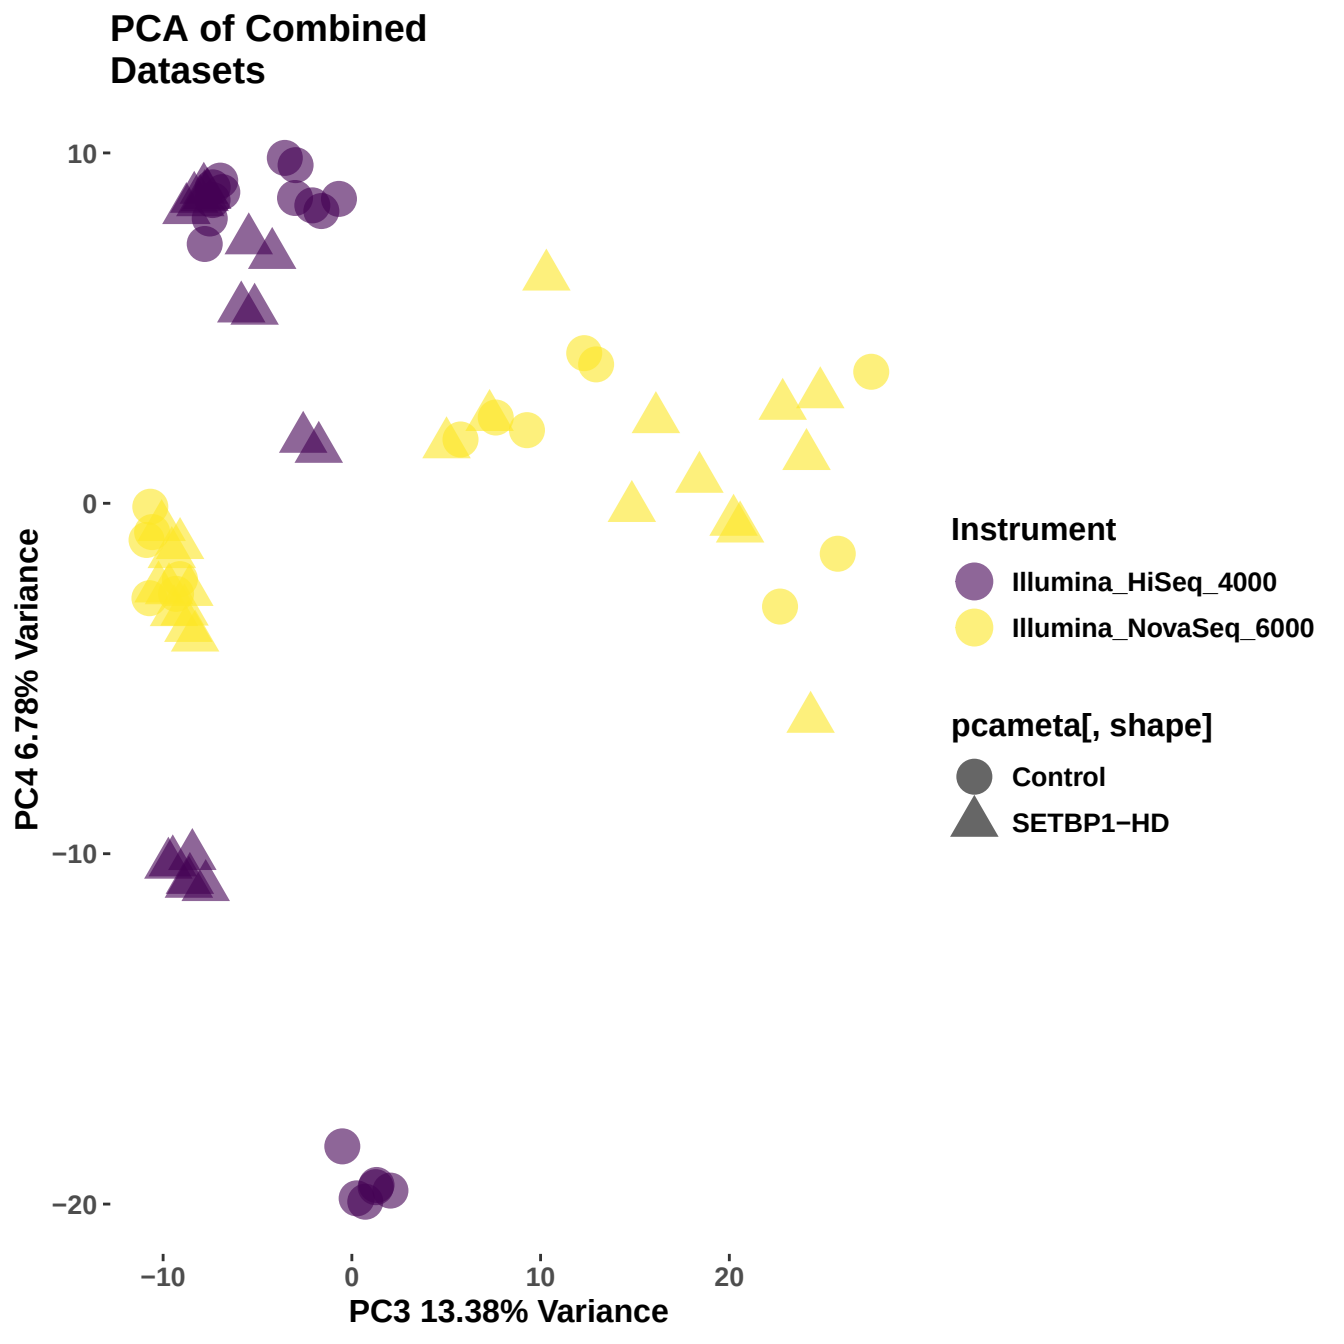
PCA of Combined Datasets
10
0
−10
−20
PC4 6.78% Variance
−10
0
10
20
PC3 13.38% Variance
Instrument
Illumina_HiSeq_4000
Illumina_NovaSeq_6000
pcameta[, shape]
Control
SETBP1−HD

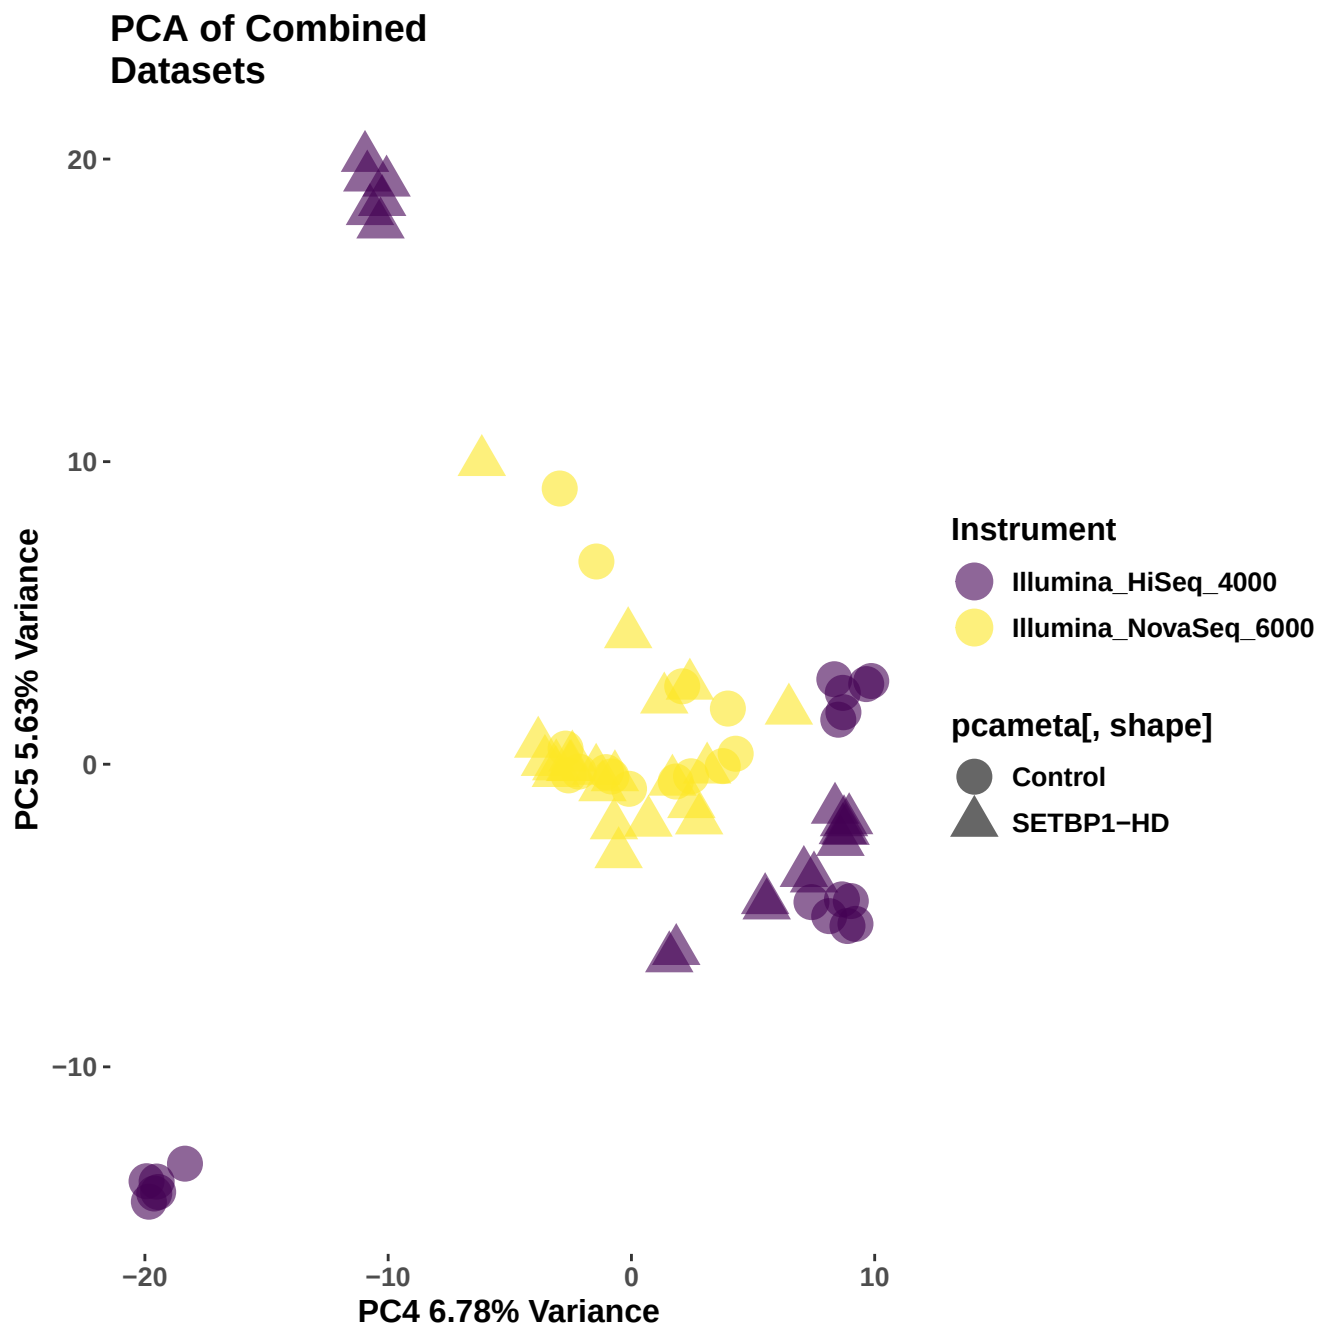
PCA of Combined Datasets
20
10
0
−10
PC5 5.63% Variance
−20
−10
0
10
PC4 6.78% Variance
Instrument
Illumina_HiSeq_4000
Illumina_NovaSeq_6000
pcameta[, shape]
Control
SETBP1−HD

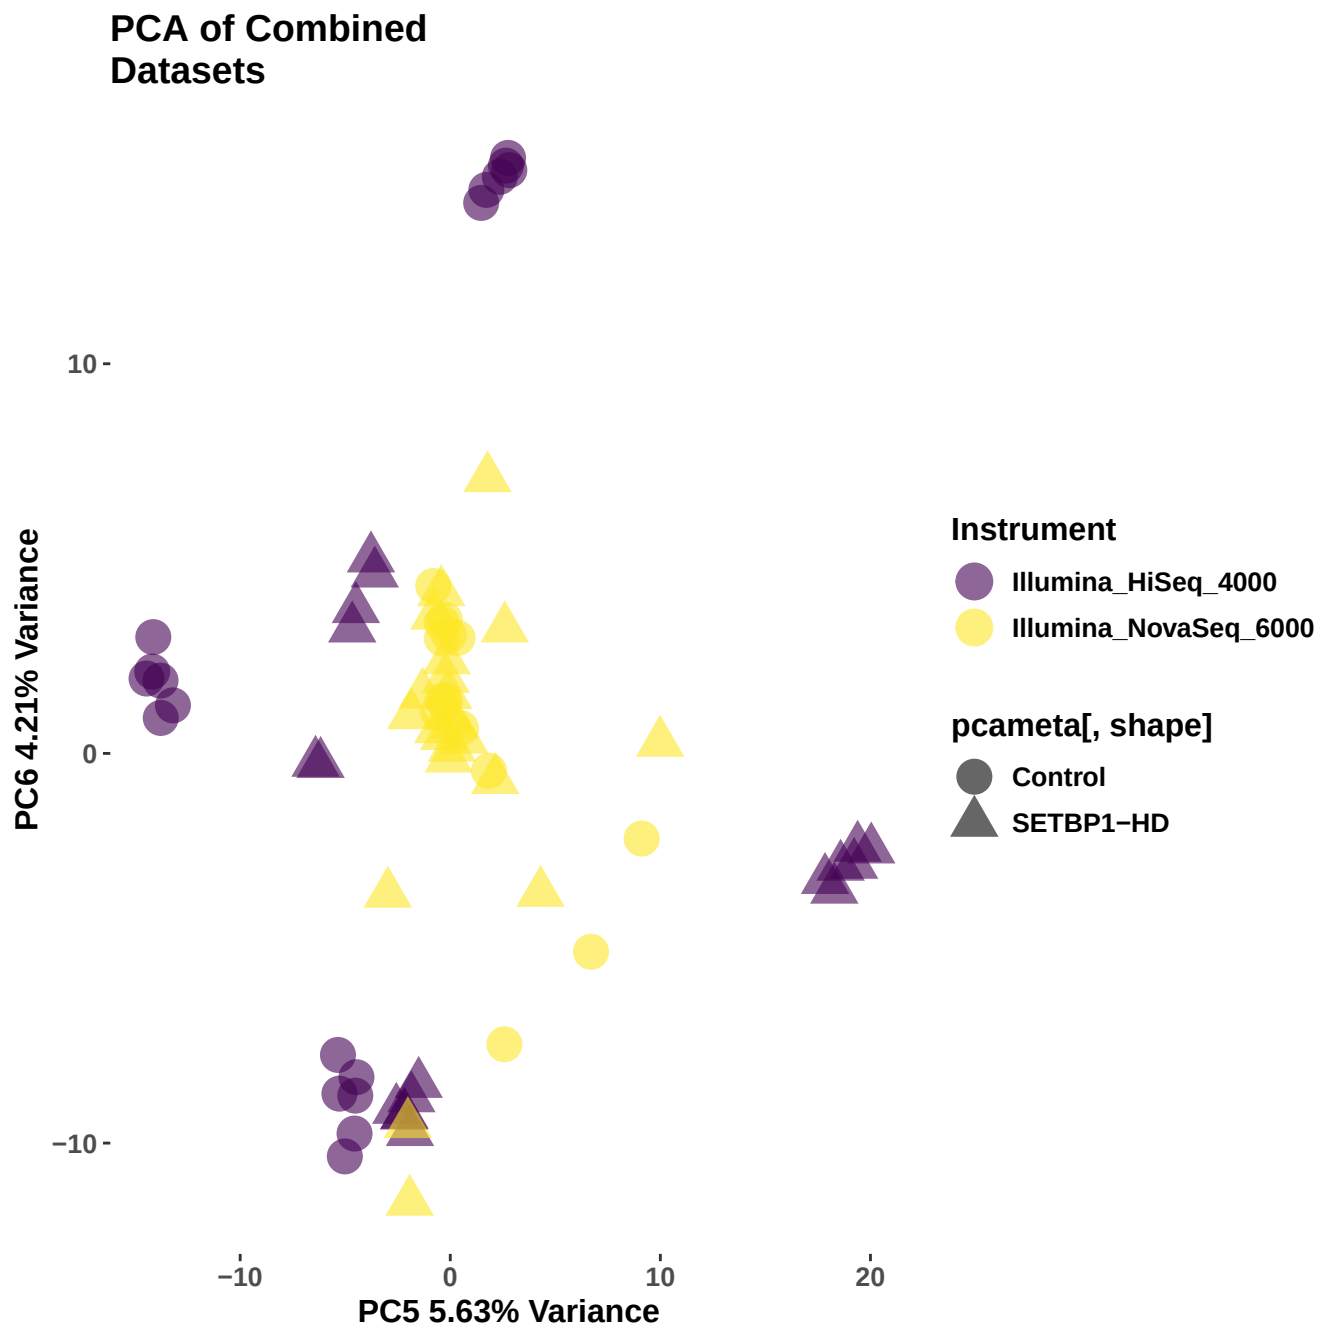
PCA of Combined Datasets
PC6 4.21% Variance
PC5 5.63% Variance
10
0
−10
−10
0
10
20
Instrument
Illumina_HiSeq_4000
Illumina_NovaSeq_6000
pcameta[, shape]
Control
SETBP1−HD

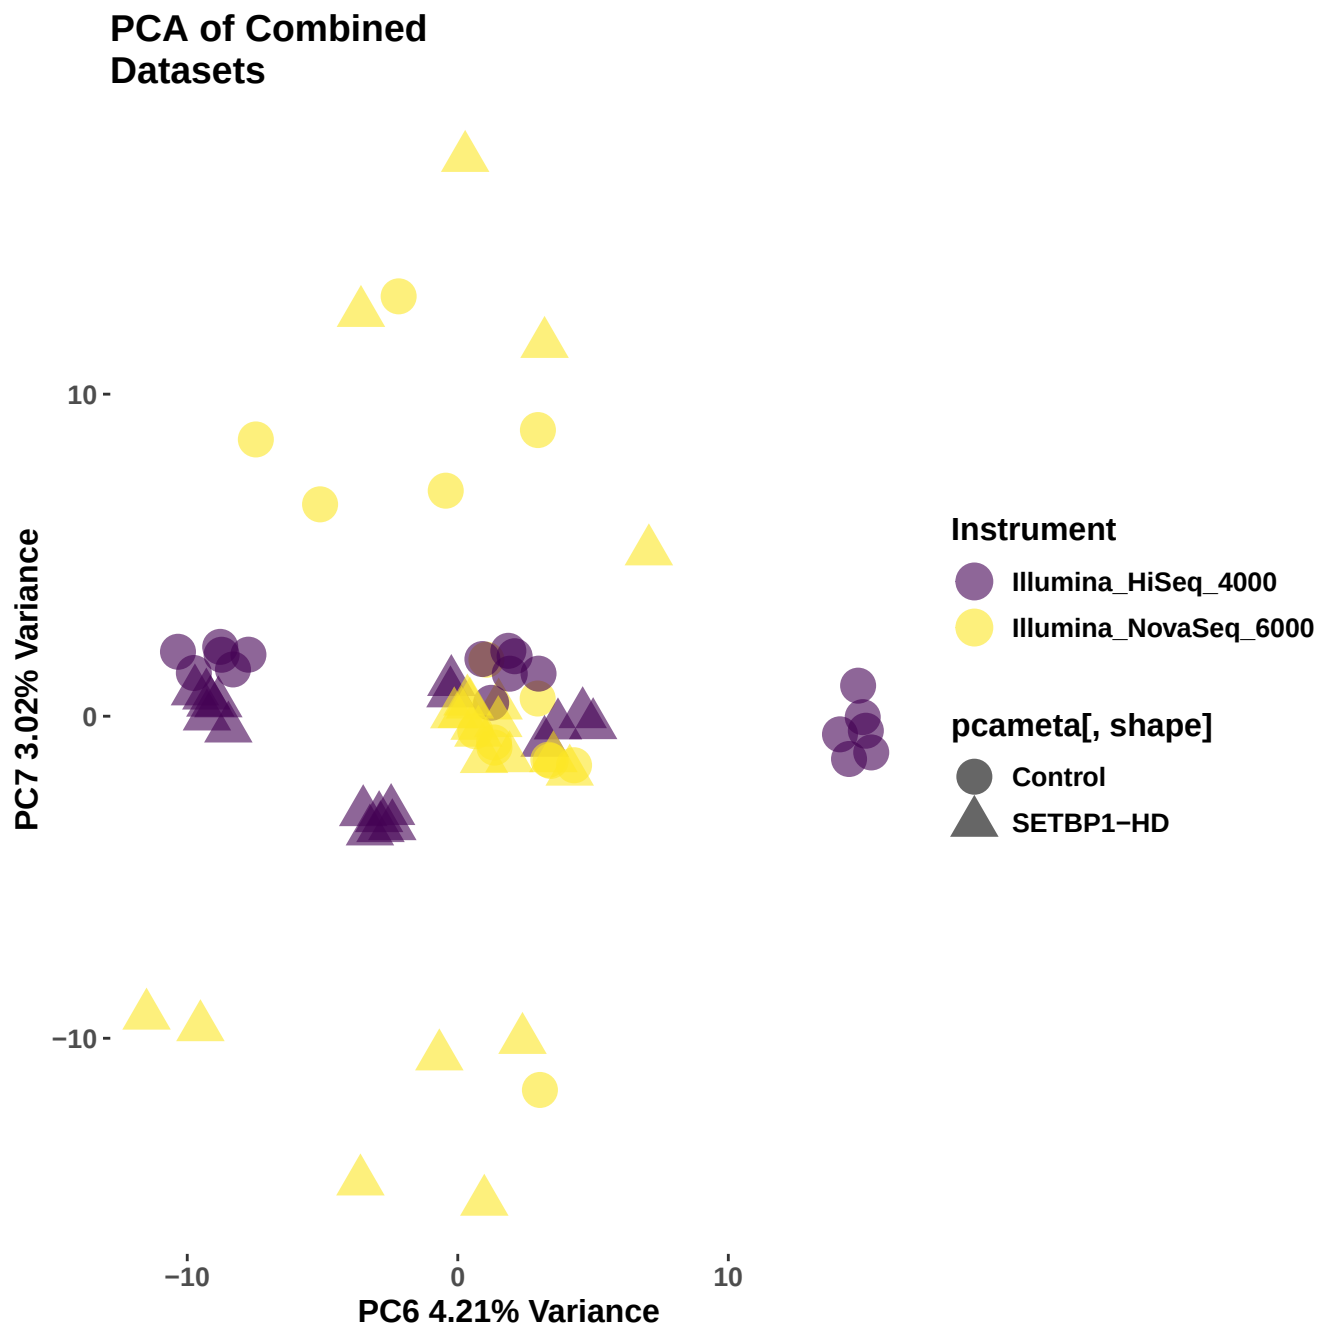
PCA of Combined Datasets
PC7 3.02% Variance
PC6 4.21% Variance
10
0
−10
−10
0
10
Instrument
Illumina_HiSeq_4000
Illumina_NovaSeq_6000
pcameta[, shape]
Control
SETBP1−HD