

Microondas Mars 5



Observações:

- Para a realização deste procedimento, é necessário o agendamento prévio com o chefe da central analítica.

Protocolo:

- A temperatura ambiente recomendada para utilização do liofilizador é de 21°C → verificar se os aparelhos de ar-condicionado estão ligados.
- Ligar a capela → o microondas só pode ser usado com a capela ligada.
- Coloque a tampa e aperte cada vaso manualmente. Em seguida, use a ferramenta de torque até acontecer um “TEC”.

Chave de
fechamento dos
tubos



- Ligar a chave de energia I (ligar os dois botões).



Para cima liga/para baixo desliga

- Ligar o estabilizador e esperar o sinal (Barulho “Bip”).




Para cima
liga/para baixo
desliga

- Ligar a chave de energia II pressionando o botão verde (Só liga se fizer o barulho “Tuf”):




- Ligar o micro-ondas no botão lateral

Botão
liga/desliga

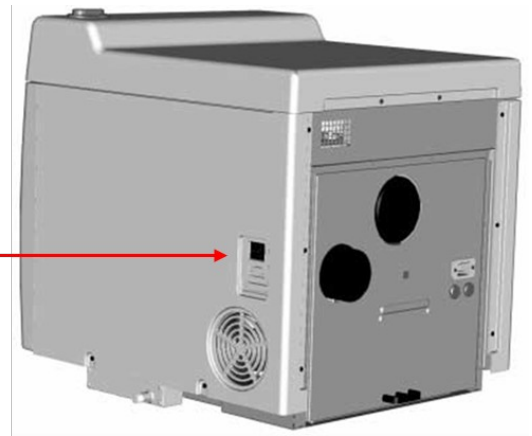

- Painel do microondas

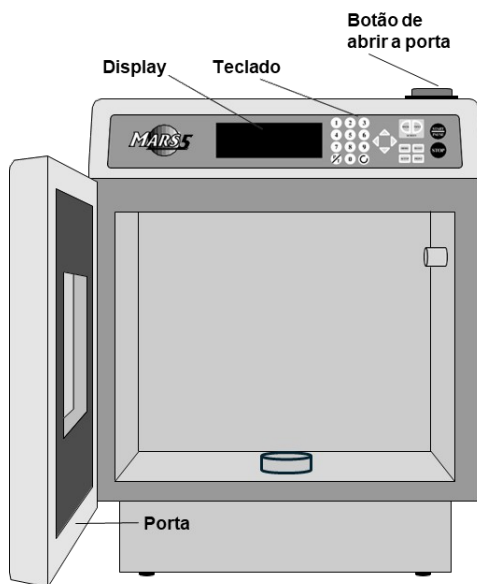


Teclado




- Limpe os tubos com toalha de papel e coloque no carrossel de acordo conforme o número de tubos e o quadro abaixo.

Parâmetro	Valor
Capacidade do frasco	55 mL
Volume mínimo	5 mL


Volume máximo	25 mL
Tamanho máx. da amostra orgânica (peso seco)	0,5 g
Tamanho máx. da amostra inorgânica (peso seco)	1,0 g
Temperatura máxima do método	210 °C
Mínimo de frascos por rodada	8

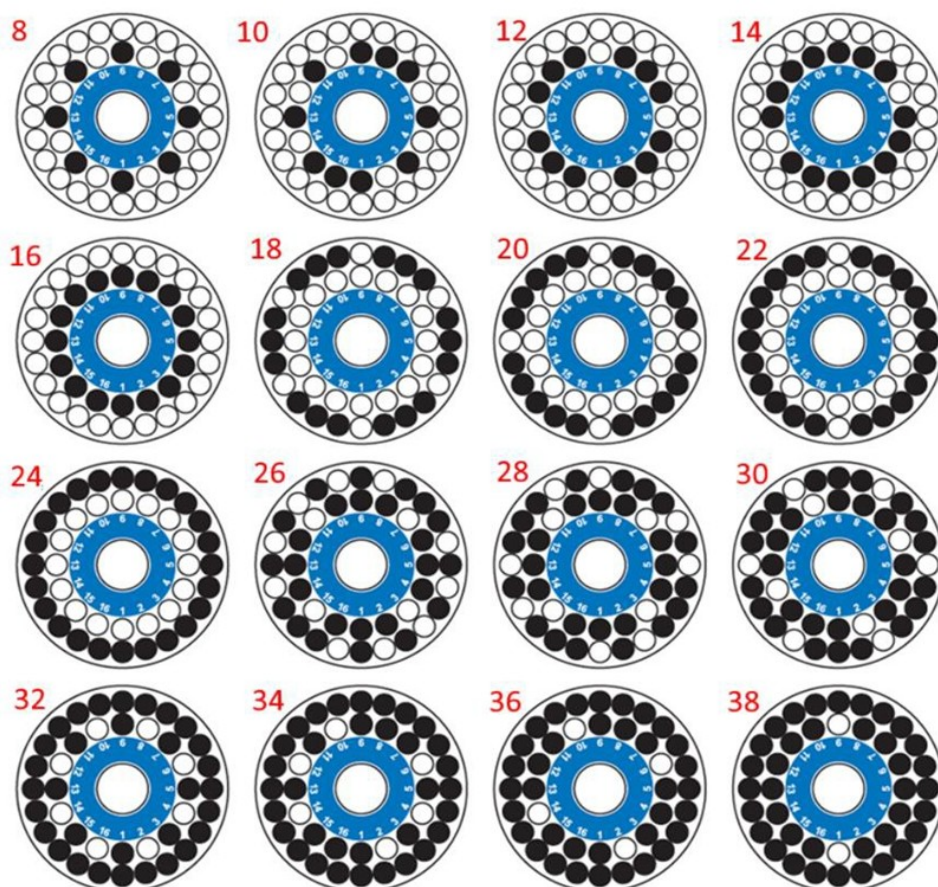


Todos os tubos devem ser inseridos **COMPLETAMENTE** dentro de uma manga composta sobre a plataforma giratória. Durante a digestão por micro-ondas, os vasos se expandem e formam bolhas, furos ou inchaço das paredes onde não estiverem contidos pela manga. Isso destruirá o vaso e a amostra será perdida.

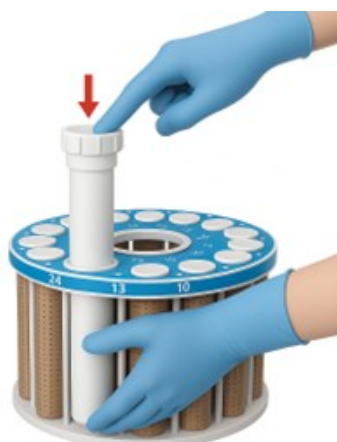

- Colocar o carrossel no micro-ondas com o número 1 voltado para frente

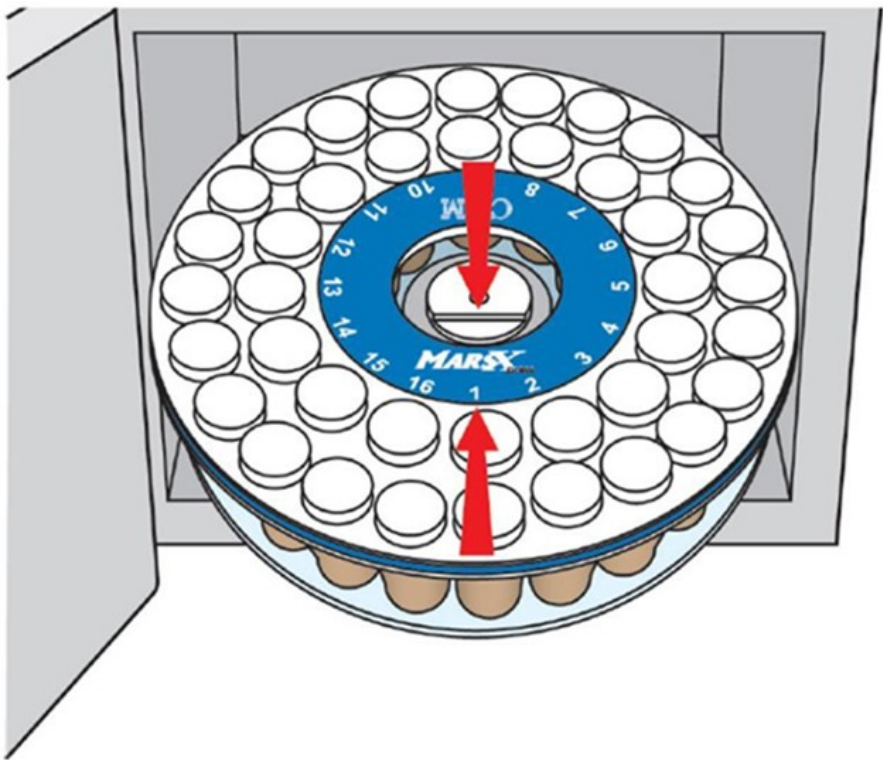


- Selecionar a opção Edit/Create Method e pressionar a tecla Select.

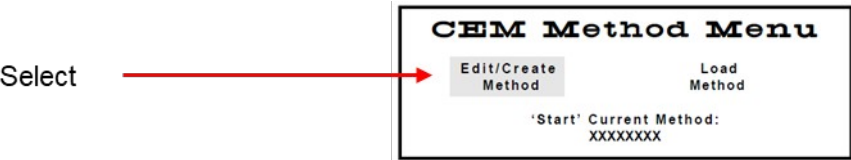


- Selecionar a opção User Directory e pressionar a tecla Select.




- Selecionar o tipo de método e pressionar a tecla Select.

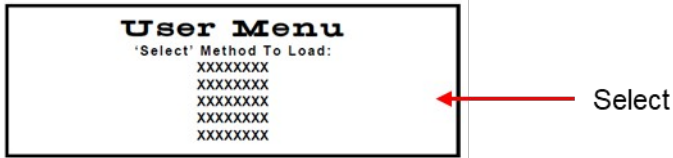

- Selecionar o tipo de tubo, geralmente XPRESS e pressionar a tecla Select

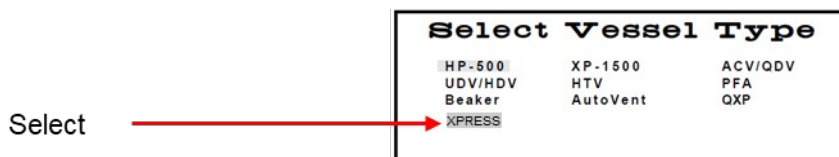


- Selecionar o tipo de amostra e pressionar Select

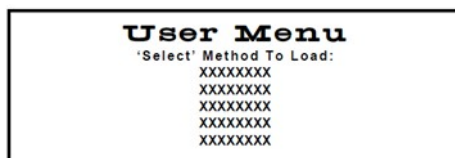


- Programar a potência

- A potência será sempre 1600 W por causa do tipo de tubo (XPRESS)
- Programar a porcentagem da potência de acordo com a regra:

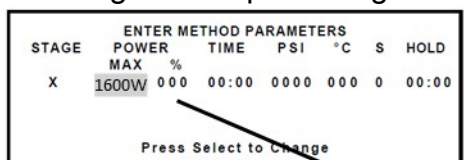


8 a 12 tubos = 60%
13 a 24 tubos = 80%
25 a 40 tubos = 100%


- Editar o nome do método e/ou pressionar a tecla Next

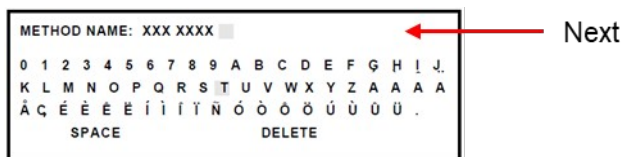

- Informar o número de tubos e pressionar a tecla Next

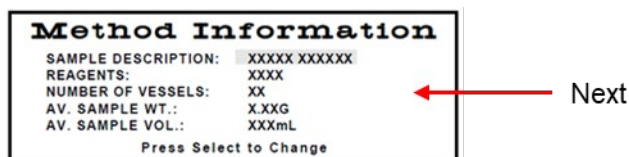

- Iniciar o método editado selecionando a opção Load Method e pressionar a tecla Start

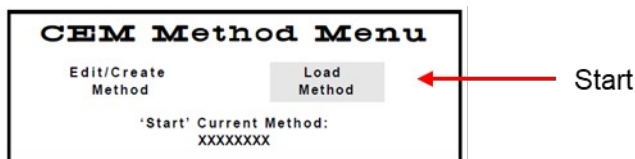

- Após o término da digestão, permita que os tubos esfriem por pelo menos 30 minutos antes de retirá-los do microondas ou abrir os tubos. A liberação de pressão não deve ser feita até que as amostras estejam em temperatura ambiente.

- Em capela, abra cuidadosamente cada vaso. Qualquer perda de amostra ou volume durante este procedimento comprometerá os resultados. Gire a tampa lentamente usando a chave de torque, mantendo o orifício de ventilação voltado para longe de você.
 - Pode ser necessário liberar a pressão gradualmente, afrouxando e apertando a tampa várias vezes. Repita o processo até que a amostra esteja completamente despressurizada.
 -
 - Utilize sempre os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) apropriados para evitar queimaduras químicas.
- Se a solução não estiver clara e homogênea, contate a equipe do laboratório.

Desligar o microondas:

- 1º Retirar o carrossel e fechar a porta
- 2º Desligar o micro-ondas no botão lateral
- 3º Desligar a chave de energia II pressionando o botão vermelho
- 4º Desligar o estabilizador
- 5º Desligar a chave de energia I 6º Desligar a capela
- 7º Desligar o ar-condicionado