TP M3-1 — Bien-être ou dispositif médical ? Classer 8 produits réels

Module 3 — vendredi 16 octobre 2026 — 09:50-10:30 (40 min, correction collective comprise), en équipe MBA Santé, IA & IoT — Epitech — Nicolas LAURIO

En bref — ce que nous allons faire

- **Objectif** : pour 8 produits réels, décider s'ils sont des produits de bien-être ou des dispositifs médicaux, en partant de ce que le fabricant annonce. Puis trouver leur classe de risque probable.

Ce que vous allez faire

1. S'échauffer sur un exemple à deux phrases → vous voyez que la phrase du fabricant décide (Étape 1).
2. Qualifier les produits 1 à 4 → 4 lignes de la grille remplies (Étape 2).
3. Qualifier les produits 5 à 8, dont deux cas limites → la grille complète (Étape 3).
4. Appliquer la même méthode à votre projet → la ligne n° 9 de la grille (Étape 4).
5. Corriger ensemble → vous comparez votre raisonnement à celui des autres équipes (Étape 5).

- **À la fin, vous déposez** : dans `analyses/m3/`, la grille `grille_classification_eqNN.xlsx` (9 lignes remplies).
- **Durée** : 40 min (09:50-10:30), dont 30 min en équipe et 10 min de correction collective.
- **Outils** : le classeur `TP_M3_1_Grille_classification.xlsx` (Excel, LibreOffice Calc ou Google Sheets) et un navigateur web.
- **Si vous êtes bloqués** : message dans le canal écrit de la promo, avec le numéro du produit et votre hésitation.

Exercice d'entraînement. Les classes trouvées ici sont des classes **probables**. La vraie classe se lit sur la notice et sur le certificat du fabricant. Ce qui est noté, c'est votre **raisonnement**, pas une réponse apprise par cœur. Quand une information n'est pas sûre, écrivez « (à vérifier) ».

Organisation à distance. L'exercice se fait en visio : l'intervenant n'est pas dans la salle.

- Une personne de l'équipe partage son écran avec **une seule grille** ; les autres cherchent les notices et les sites en parallèle.
- Questions : **canal écrit de la promo**, avec le numéro du produit.

> - À 10:20, l'intervenant reprend la main pour la correction collective : gardez la grille ouverte.

---

1. Objectifs

À la fin de l'exercice, vous saurez :

1. repérer la **finalité revendiquée** d'un produit : ce que le fabricant dit qu'il fait pour la santé ;
2. décider si un produit est un produit de **bien-être** ou un **dispositif médical** ;
3. trouver sa **classe de risque probable** (I, IIa, IIb, III) avec la **règle 11** pour les logiciels ;
4. dire si un **organisme notifié** doit intervenir avant la mise sur le marché.

2. Les mots à connaître

Mot	En clair
Finalité revendiquée	Ce que le fabricant annonce : sur la notice, la publicité, le site, la fiche de l'App Store. C'est elle qui décide du statut.
Dispositif médical	Un objet ou un logiciel destiné par son fabricant à une fin médicale : diagnostiquer, prévenir, surveiller, prédire, traiter ou atténuer une maladie, compenser un handicap. Texte de référence : le règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR), règlement (UE) 2017/745.
Bien-être	Un produit pour la forme, le sport, la détente, sans viser une maladie. Ce n'est pas un dispositif médical.
Classe de risque	I (risque faible), IIa, IIb, III (risque le plus élevé). Plus la classe est haute, plus le contrôle est strict.
Organisme notifié	Un organisme indépendant, agréé par un État, qui vérifie le produit avant sa vente. En France : GMED, par exemple. Obligatoire dès la classe IIa.
Marquage CE	Le logo qui autorise la vente en Europe. Pour un dispositif médical contrôlé par un organisme notifié, un **numéro à 4 chiffres** suit le logo CE.
Règle 11	La règle du MDR qui classe les **logiciels** médicaux. Elle est résumée au § 4.

Image à garder en tête : le même capteur peut être vendu comme un jouet de sport ou comme un appareil médical. C'est l'**étiquette** qui change, pas l'électronique.


3. Outils

Outil	Rôle
`TP_M3_1_Grille_classification.xlsx` (Teams / Moodle)	La grille : onglet **Lisez-moi** (procédure, règle 11), onglet **Grille** (une ligne par produit)
Navigateur web	Chercher la notice, la fiche produit, la page de l'App Store, l'avis de la HAS ou de l'ANSM

Couleurs de la grille :

- **police bleue sur fond bleu pâle** = à remplir, avec des **listes déroulantes** en colonnes E, G, H et I ;
- fond gris = donné (le produit, un exemple réel, où chercher) ;
- colonne K = **vérification automatique** : elle signale une réponse incohérente (par exemple un produit de bien-être avec une classe). Ne l'écrasez pas.

4. La procédure en 3 questions (plus une)

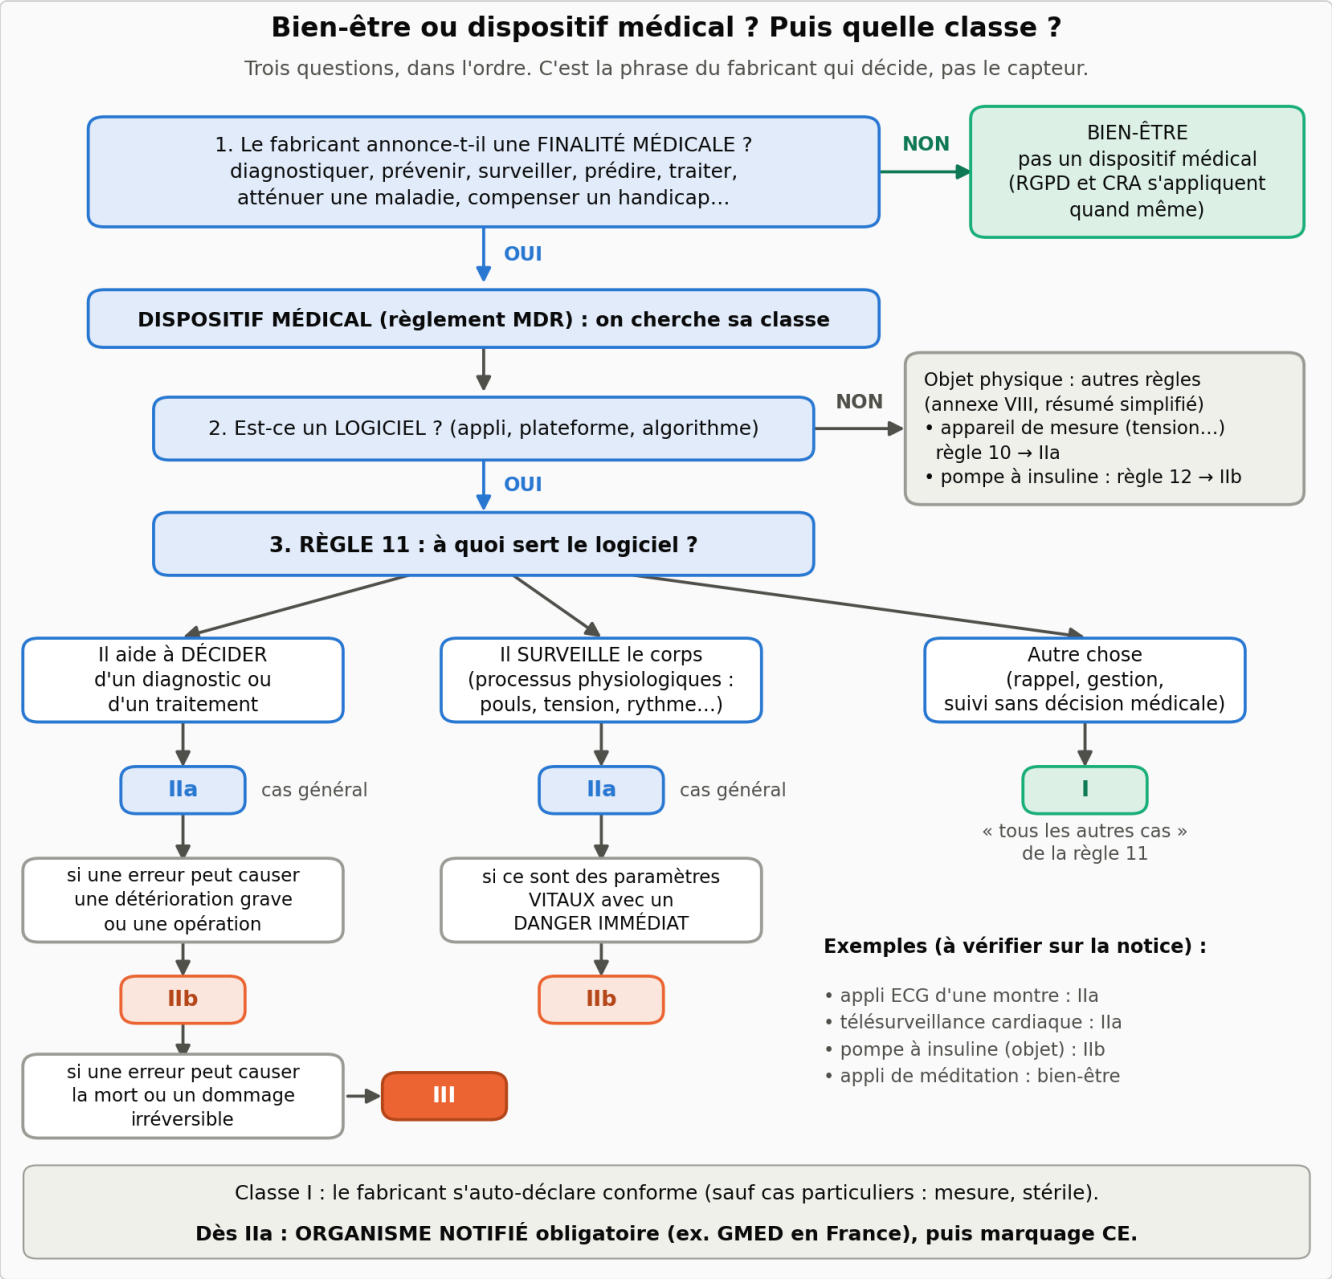

Question (a) — Le fabricant annonce-t-il une finalité médicale ?

- Non → **Bien-être**. Pas de classe. Le RGPD (protection des données personnelles) s'applique quand même.
- Oui → **Dispositif médical**. On passe à la question (c).
- Ça dépend de la phrase choisie → **À discuter**. Écrivez les deux phrases possibles.

Question (b) — Quelle phrase le prouve ? Recopiez la phrase de la notice, de la publicité ou du site. Pas de phrase, pas de preuve.

Question (c) — Si c'est un dispositif médical : quelle classe, avec quelle règle ?

D'abord : est-ce un **logiciel** (une appli, une plateforme, un algorithme) ?

- **Oui** → règle 11 (tableau ci-dessous).

- **Non, c'est un objet physique** → d'autres règles du MDR. Deux suffisent aujourd'hui : un appareil qui **mesure** une fonction vitale (la tension, par exemple) suit la règle 10, souvent IIa ; un appareil qui **délivre un médicament** suit la règle 12, IIa ou IIb selon le danger. Le logiciel qui pilote l'objet prend la même classe que l'objet.

La règle 11 en clair

Le logiciel…	Classe
aide à **décider** d'un diagnostic ou d'un traitement	**IIa**
… et une erreur peut causer une **détérioration grave** ou une opération	**IIb**
… et une erreur peut causer la **mort** ou un dommage **irréversible**	**III**
surveille le corps (pouls, tension, rythme…)	**IIa**
… et surveille des paramètres **vitaux** avec un **danger immédiat**	**IIb**
fait autre chose (tous les autres cas)	**I**

Conséquence pratique : la plupart des logiciels médicaux sont **au moins IIa**.

Question (d) — Organisme notifié ? Classe I : en général **non**, le fabricant s'auto-déclare conforme (sauf cas particuliers, par exemple une fonction de mesure). Dès IIa : **oui**, obligatoire.

5. Étapes

Étape 1 — S'échauffer (09:50-09:55)

Pourquoi : avant de chercher des notices, il faut voir que deux phrases suffisent à changer le statut d'un même produit.

Ce que vous faites

1. Ouvrez le classeur, onglet **Grille**. Repérez les colonnes E à K.
2. Lisez les deux phrases ci-dessous. Elles décrivent **le même bracelet**, avec le même capteur de pouls.
   - Phrase A : « Suivez votre forme et votre sommeil. »
   - Phrase B : « Détecte les troubles du rythme cardiaque. »

Vous devez voir : une phrase parle de mieux-être, l'autre d'une maladie.

Question 1. Quelle phrase fait du bracelet un dispositif médical ? Quel mot vous a décidés ?

Étape 2 — Les produits 1 à 4 (09:55-10:07)

Pourquoi : on s'entraîne sur des cas plutôt nets, puis sur une balance qui mélange bien-être et médical.

N°	Produit	Exemple réel à chercher	Où chercher
1	Application ECG d'une montre connectée	App ECG de l'Apple Watch	Page d'aide Apple « app ECG »
2	Tensiomètre connecté (bras)	Withings BPM Connect, ou un tensiomètre Omron connecté	Fiche produit, notice PDF (logo CE)
3	Application de méditation et de sommeil	Petit BamBou (ou Calm, Headspace)	Site de l'éditeur, App Store
4	Balance connectée « multifonction »	Withings Body Scan 2 (juin 2026, 500 €) ; à comparer avec Withings BodyFit	Fiche produit, notice, FAQ Withings

Ce que vous faites

1. Répartissez-vous les 4 produits : une ou deux personnes par produit, 2 à 3 minutes de recherche chacune.
2. Pour chaque produit, cherchez **la phrase du fabricant** qui dit à quoi sert le produit.
3. Remplissez les colonnes E à J de la grille, ligne par ligne, avec la procédure du § 4.
4. Regardez la colonne K : si elle n'affiche pas « OK », relisez votre ligne.

Vous devez voir : 4 lignes remplies. Pas d'inquiétude si une ligne reste « À discuter » : c'est parfois la bonne réponse.

Question 2. Pour les produits 1 à 4, répondez à (a), (b), (c) et (d). En plus : pourquoi la montre elle-même n'est-elle pas entièrement un dispositif médical ?

Étape 3 — Les produits 5 à 8, dont deux cas limites (10:07-10:17)

Pourquoi : on monte en risque (une pompe qui délivre un médicament), puis on traite deux cas proches de vos projets, où la réponse dépend de la phrase choisie.

N°	Produit	Exemple réel à chercher	Où chercher
5	Pompe à insuline patch	Omnipod ; rappel de lots de pods par l'ANSM le 3 juin 2026	Site Omnipod, avis de l'ANSM
6	Logiciel de télésurveillance cardiaque	Implicity (inscrit le 20 mai 2026 sur la liste des télésurveillances remboursées)	Site Implicity, avis de la HAS « IMPLICITY (IM009) »
7	Détecteur de chute / téléassistance pour personne âgée (**cas limite**)	Détection des chutes d'une montre connectée ; une offre de téléassistance avec détecteur de chute	Site de l'offre, conditions générales
8	Pilulier connecté avec rappels (**cas limite**)	Medissimo imedipac	Site Medissimo ; avis de la HAS sur MEDIPAC (2022)

Ce que vous faites

1. Même méthode qu'à l'étape 2 pour les produits 5 et 6.
2. Pour les produits 7 et 8, cherchez **comment le fabricant présente son produit** : sécurité, confort, ou santé ?
3. Si la réponse dépend de la phrase, choisissez « À discuter » et écrivez les deux phrases possibles dans la colonne F.

Vous devez voir : la grille complète, avec au moins deux lignes « À discuter » justifiées.

Question 3. Pour les produits 5 à 8, répondez à (a), (b), (c) et (d).

Question 4. Pour les produits 7 et 8, écrivez une phrase de publicité qui garde le produit en **bien-être**, puis une phrase qui le fait **basculer en dispositif médical**.

Étape 4 — Votre projet, puis déposer (10:17-10:20)

Pourquoi : à 16:30, vous passerez votre projet au crible. Une première réponse maintenant vous fera gagner du temps.

Ce que vous faites

1. Dernière ligne de la grille (n° 9, « Votre projet ») : écrivez votre cas d'usage (A à F) en colonne B.
2. En colonne F, écrivez la **finalité de votre projet en une phrase**, comme si c'était votre publicité.
3. Remplissez E, G, H, I et J avec la même procédure.
4. Enregistrez sous `grille_classification_eqNN.xlsx` (NN = numéro d'équipe) et déposez-la dans `analyses/m3/`.

Question 5. Votre projet est-il un produit de bien-être ou un dispositif médical ? Si c'est un dispositif médical, quelle classe probable, et faut-il un organisme notifié ?

Étape 5 — Correction collective (10:20-10:30)

Pourquoi : sur les cas limites, plusieurs réponses se défendent. On compare les raisonnements.

Ce que vous faites

1. Gardez votre grille ouverte. L'intervenant partage la sienne.
2. Quand votre équipe est appelée, lisez votre réponse et **votre phrase** pour un produit.
3. Corrigez votre grille si besoin, en couleur ou en commentaire, puis redéposez-la.

Vous devez voir : la même méthode donne la même réponse sur les cas nets, et des réponses argumentées sur les cas limites.

---

6. Livrable (dans le repo de l'équipe)

Dossier `analyses/m3/` :

- `grille_classification_eqNN.xlsx` : les 8 produits et la ligne de votre projet, colonnes E à J remplies, colonne K à « OK » (ou un écart expliqué dans la justification).

Ce livrable fait partie des livrables d'équipe du module 3. La ligne n° 9 servira à la séquence « Votre projet passé au crible » (16:30).

7. Pour aller plus loin

- Cherchez un produit dont la **publicité** et la **notice** ne disent pas la même chose. Lequel des deux compte ? (Indice : les deux. Le fabricant ne peut pas revendiquer en publicité une finalité médicale absente de son marquage CE.)
- Pour une appli, cherchez sur sa fiche App Store la mention « dispositif médical » et le nom du fabricant légal.
- Comparez Withings Body Scan 2 et Withings BodyFit : que veut dire « de niveau clinique » sans marquage CE médical ?