



样品名称:

数据文件: testA.dx

仪器: 7890B

进样体积: 1.000

采集方法: FID.amx

处理方法: *9.25.pmx

操作者: 系统

进样日期: 2018-09-21 15:29:15+08:00


位置: 1

类型: 校正

校正级别: 1

样品含量: 0.00

手动修改: 无

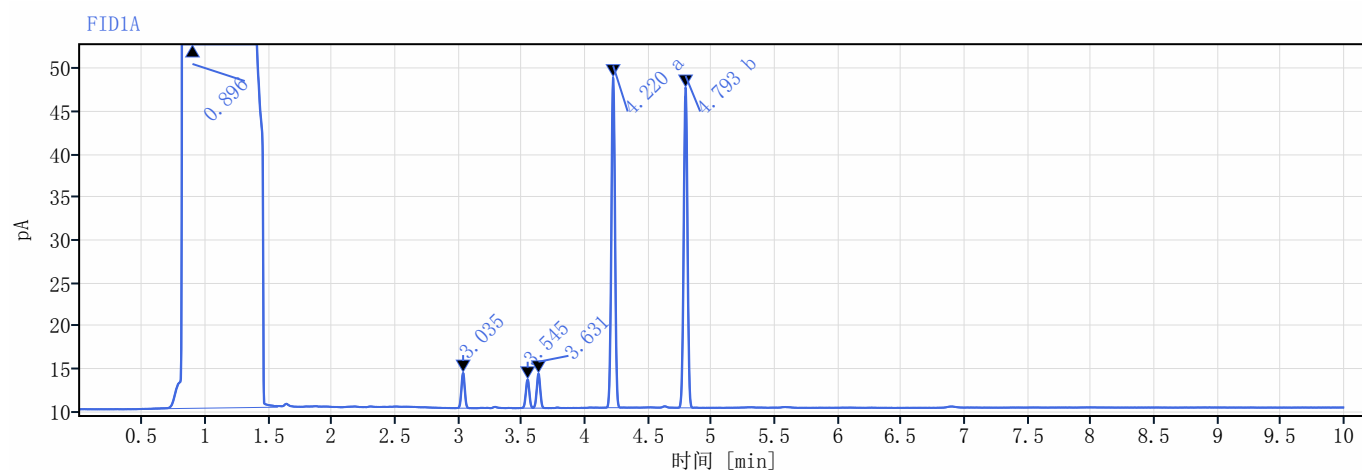

信号: FID1A

名称	保留时间 [min]	响应因子	峰面积	含量 []	浓度 []	组
a	4.22	9.693	76.834	7.927	7.927	
b	4.79	9.684	76.824	7.933	7.933	
			总和	15.860		