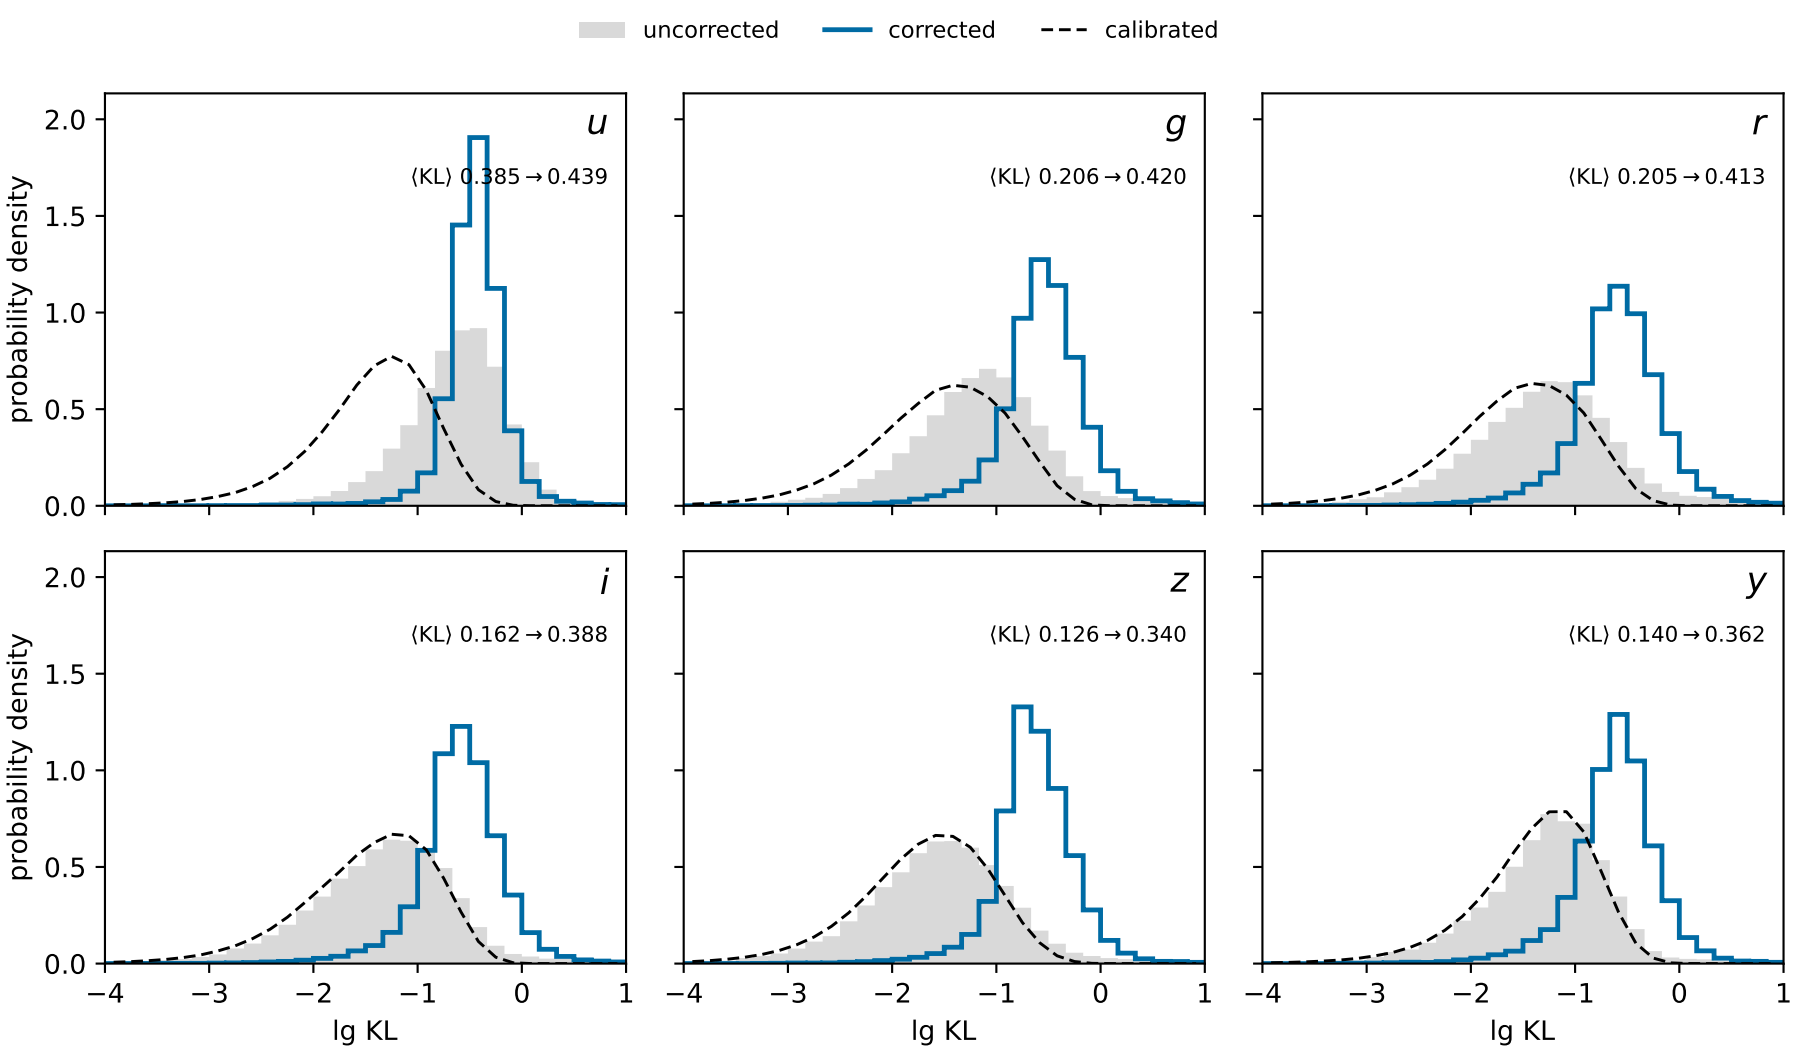
uncorrected
corrected
calibrated
u
⟨KL⟩ 0.385 → 0.439
g
⟨KL⟩ 0.206 → 0.420
r
⟨KL⟩ 0.205 → 0.413
i
⟨KL⟩ 0.162 → 0.388
z
⟨KL⟩ 0.126 → 0.340
y
⟨KL⟩ 0.140 → 0.362
probability density
lg KL
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
−4
−3
−2
−1
0
1