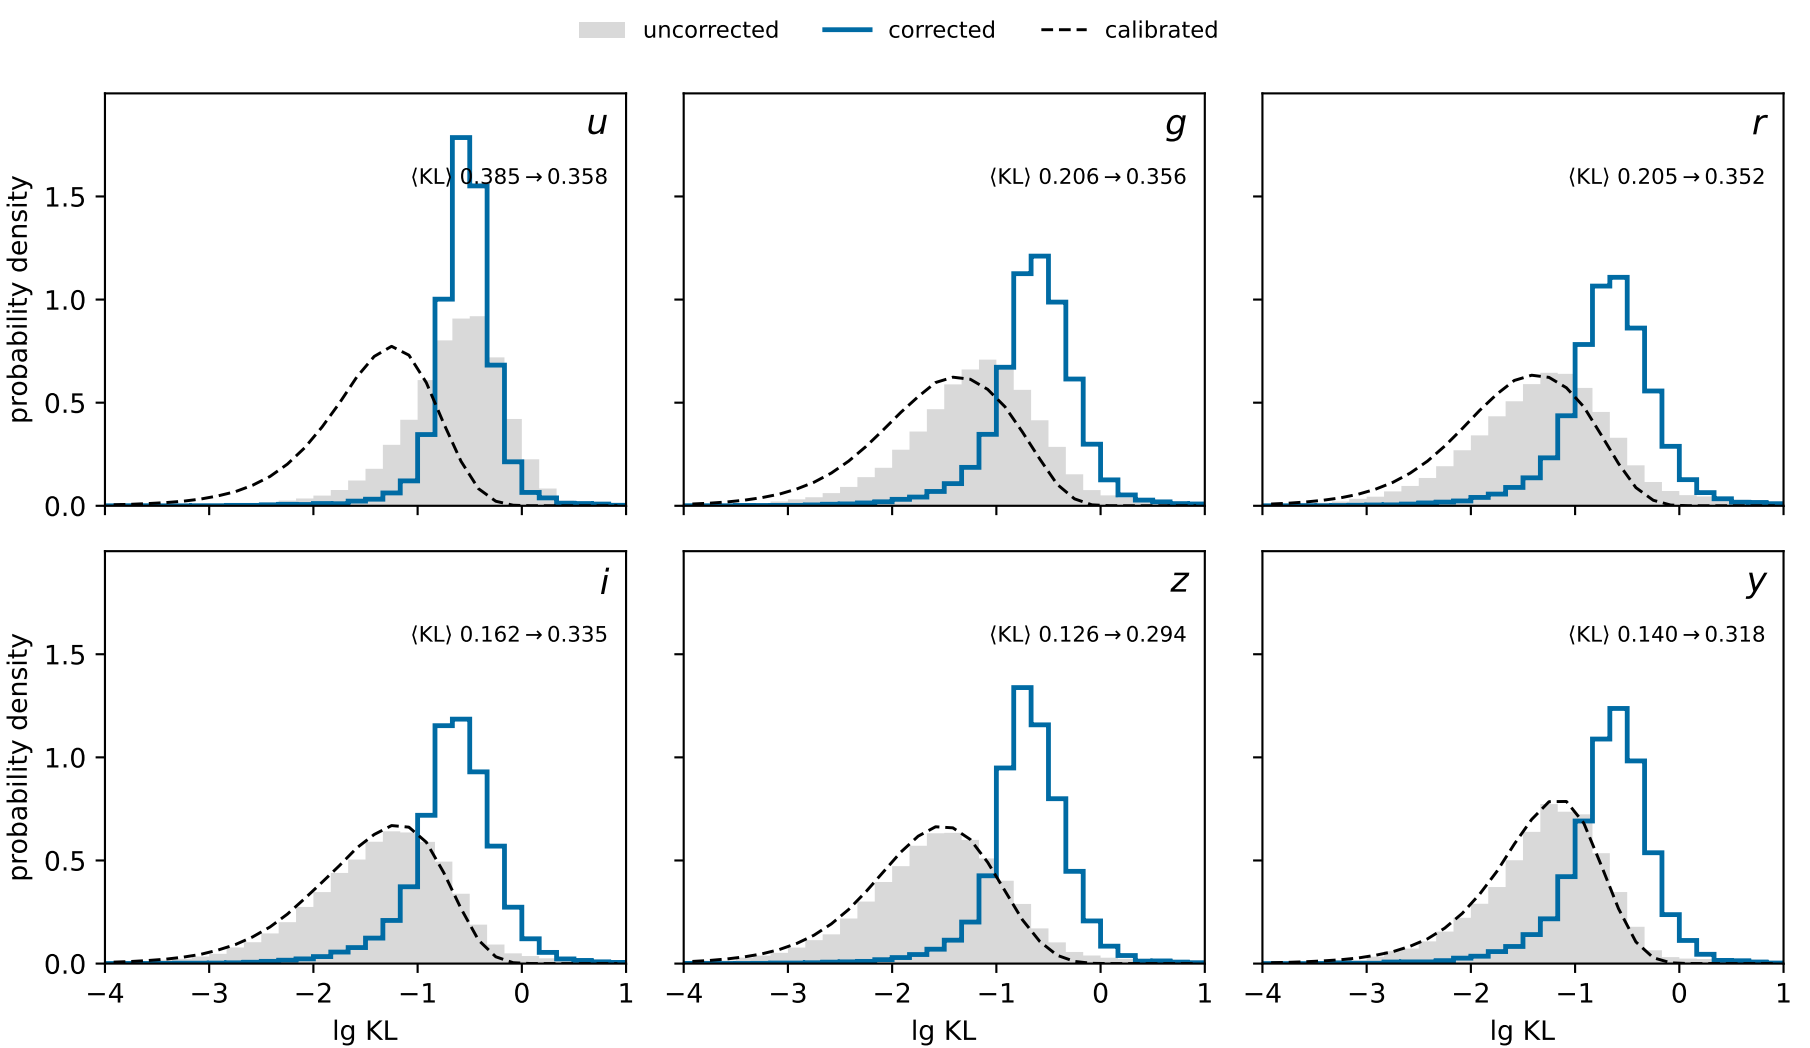
uncorrected
corrected
calibrated
u
⟨KL⟩ 0.385 → 0.358
g
⟨KL⟩ 0.206 → 0.356
r
⟨KL⟩ 0.205 → 0.352
i
⟨KL⟩ 0.162 → 0.335
z
⟨KL⟩ 0.126 → 0.294
y
⟨KL⟩ 0.140 → 0.318
probability density
lg KL
0.0
0.5
1.0
1.5
−4
−3
−2
−1
0
1