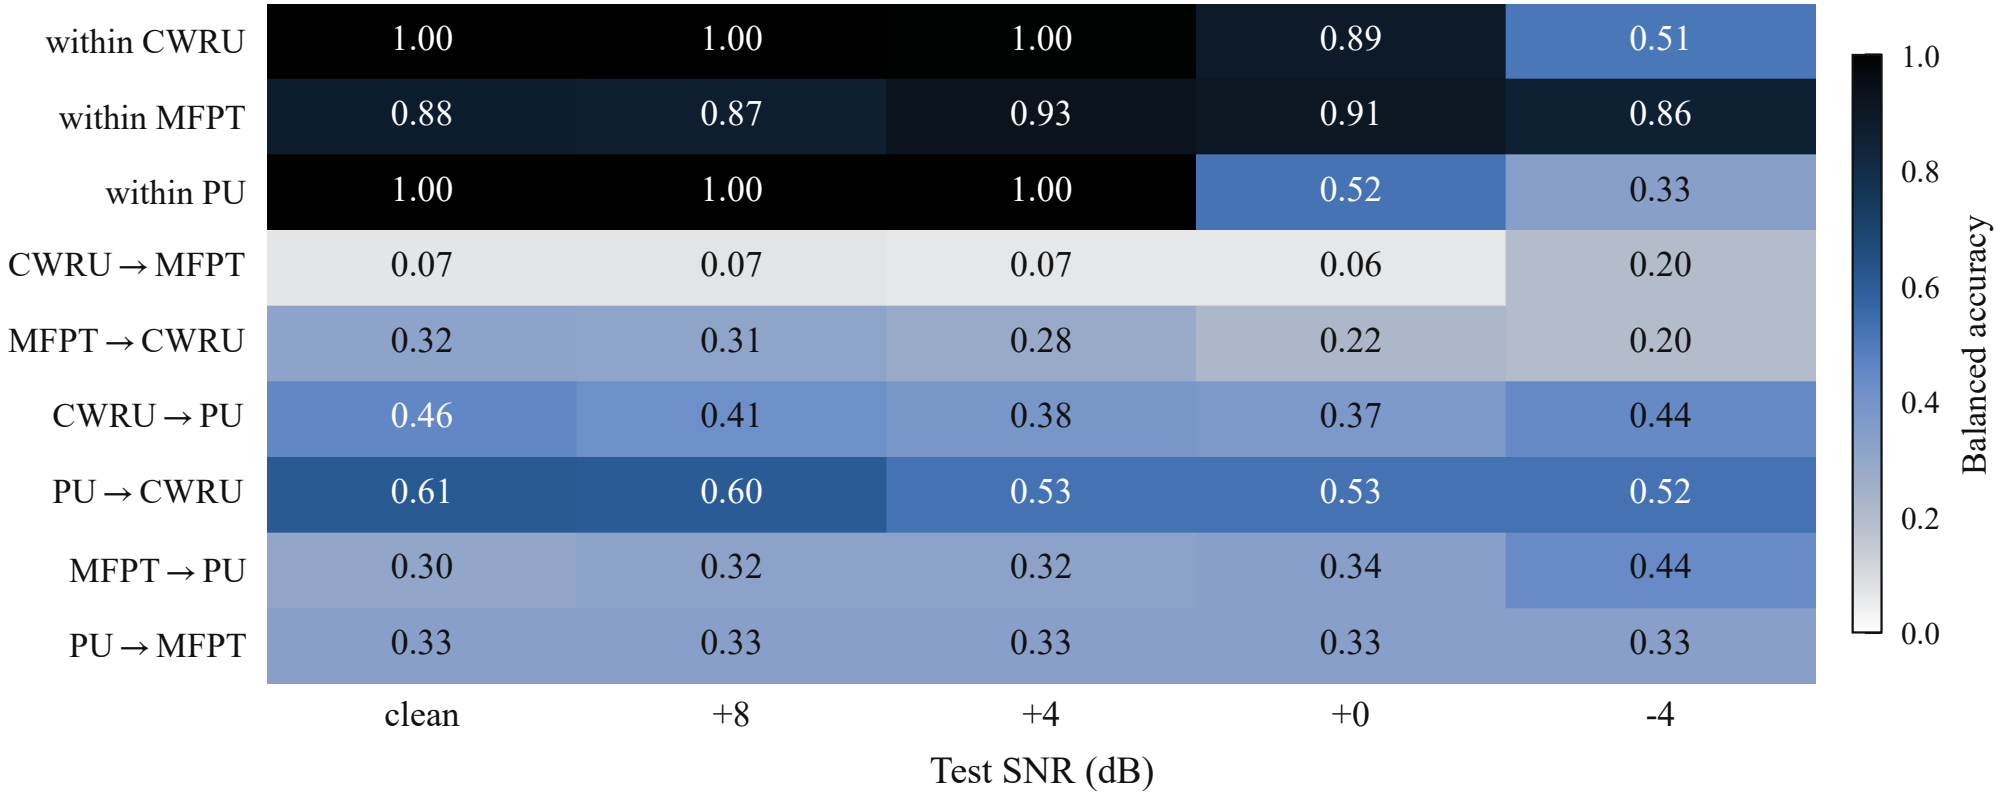
within CWRU
within MFPT
within PU
CWRU → MFPT
MFPT → CWRU
CWRU → PU
PU → CWRU
MFPT → PU
PU → MFPT
1.00 1.00 1.00 0.89 0.51
0.88 0.87 0.93 0.91 0.86
1.00 1.00 1.00 0.52 0.33
0.07 0.07 0.07 0.06 0.20
0.32 0.31 0.28 0.22 0.20
0.46 0.41 0.38 0.37 0.44
0.61 0.60 0.53 0.53 0.52
0.30 0.32 0.32 0.34 0.44
0.33 0.33 0.33 0.33 0.33
clean
+8
+4
+0
-4
Test SNR (dB)
Balanced accuracy
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0