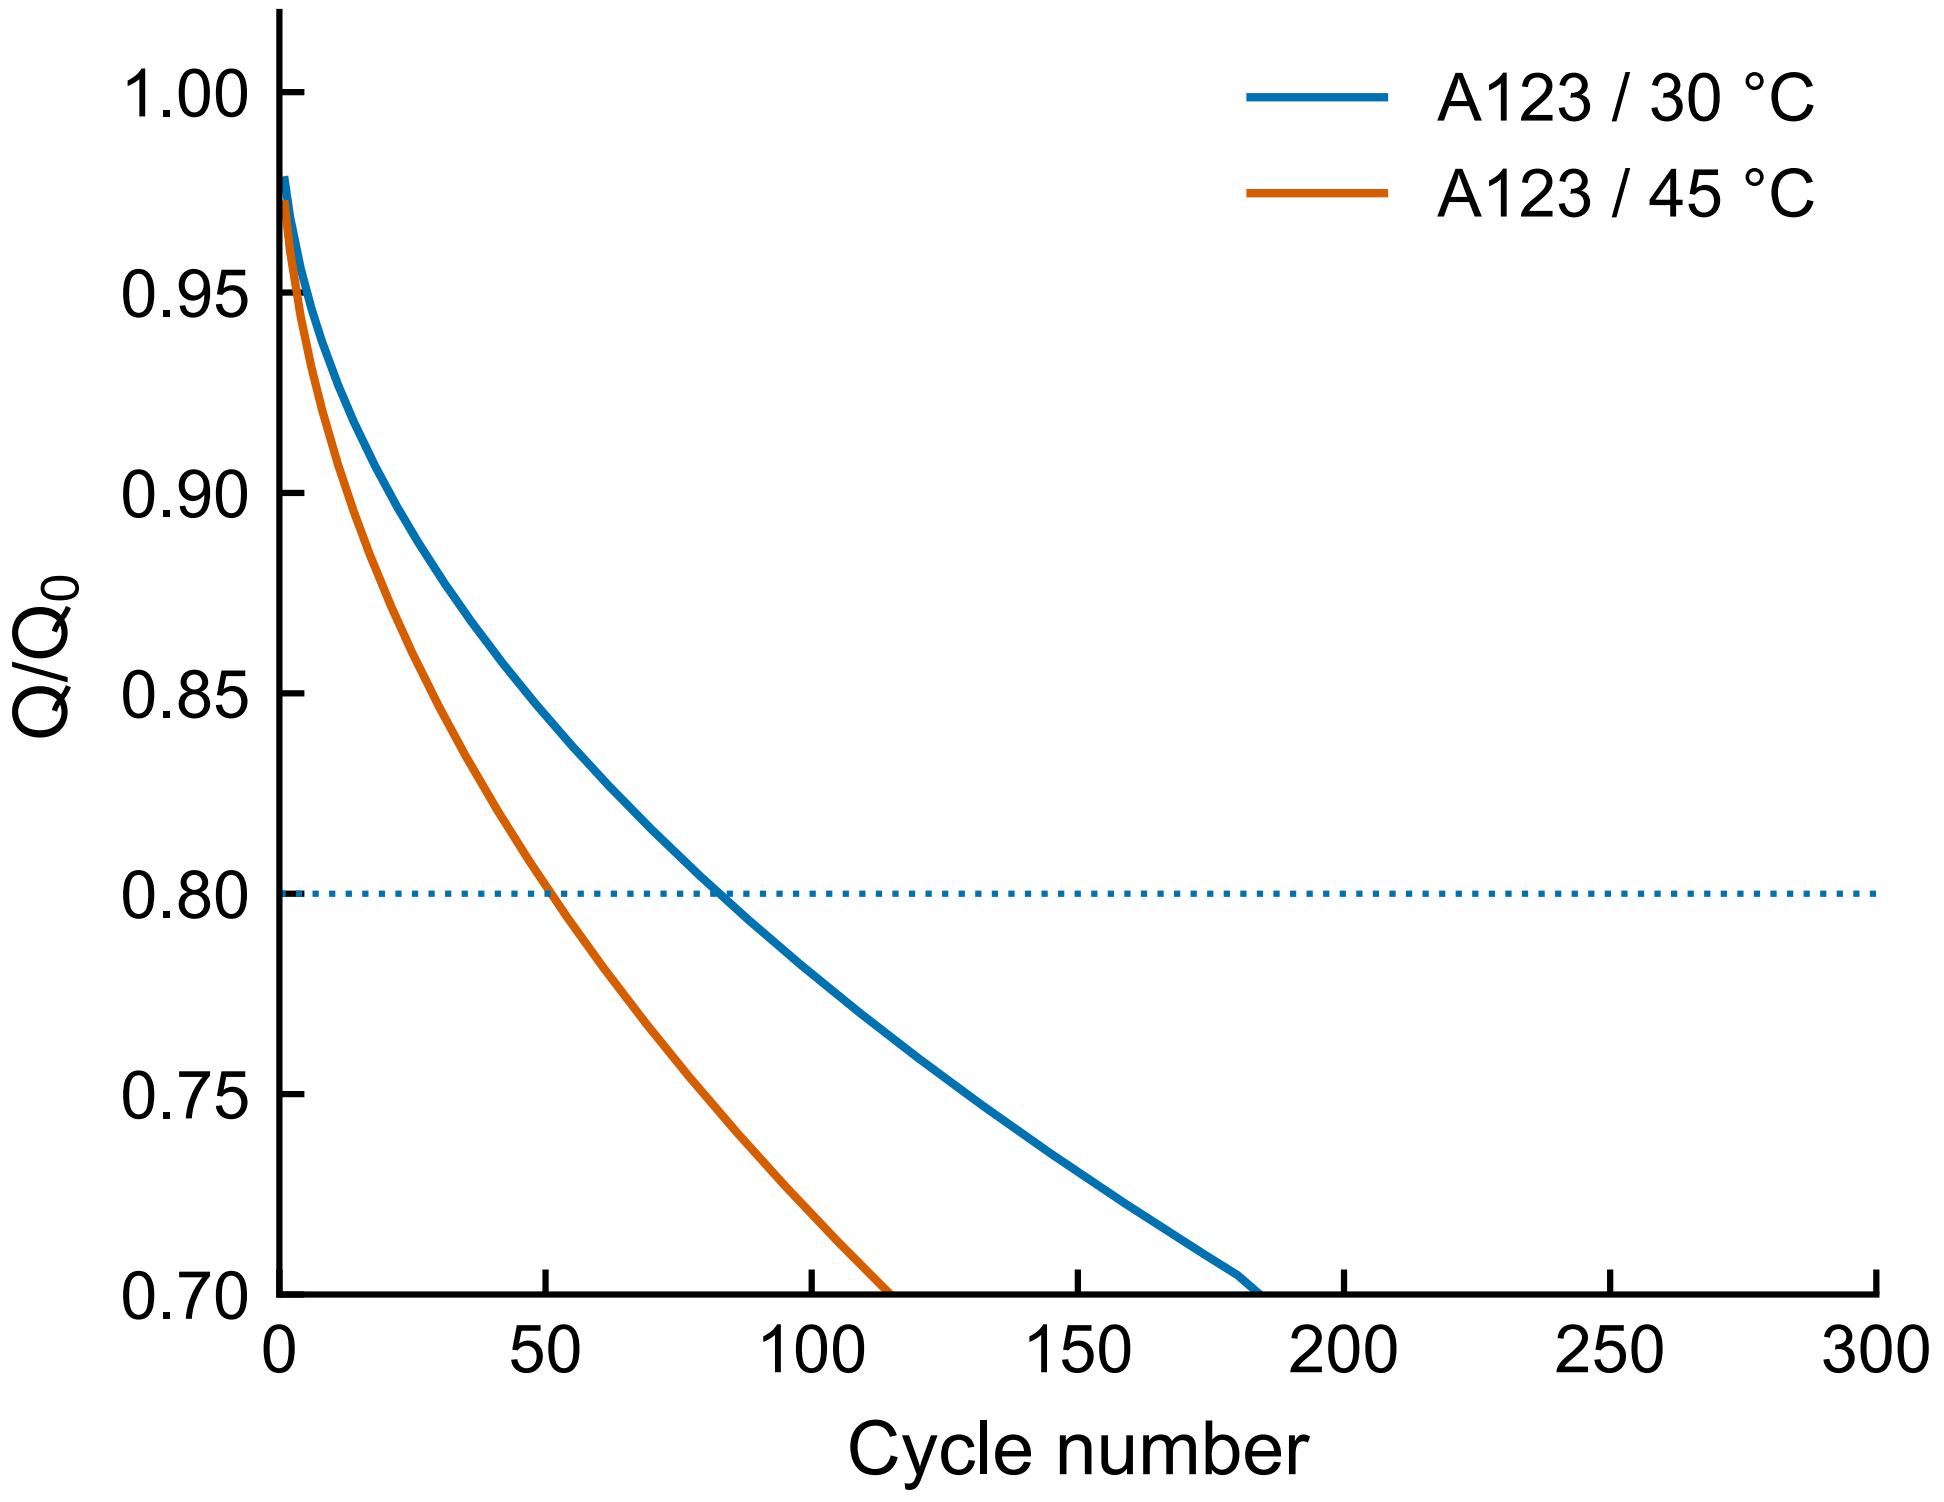
A123 / 30 °C
A123 / 45 °C
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
Q/Q0
0
50
100
150
200
250
300
Cycle number