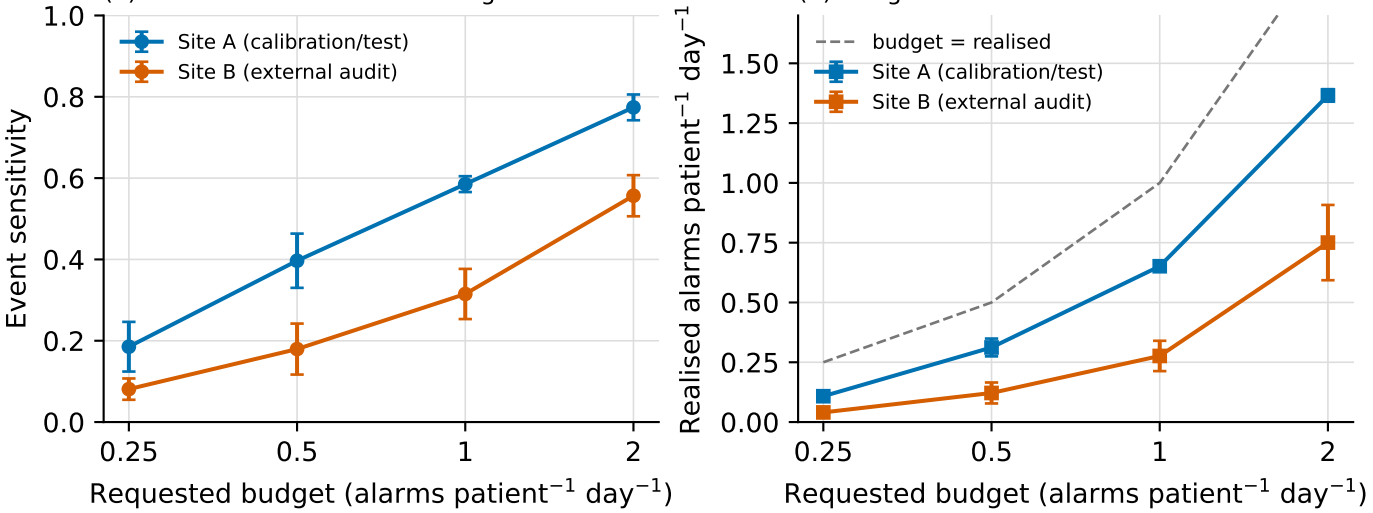
(a) Detection at a declared budget
Site A (calibration/test)
Site B (external audit)
Event sensitivity
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
0.25
0.5
1
2
Requested budget (alarms patient^{-1} day^{-1})
(b) Budget utilisation
budget = realised
Site A (calibration/test)
Site B (external audit)
Realised alarms patient^{-1} day^{-1}
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.25
0.5
1
2
Requested budget (alarms patient^{-1} day^{-1})