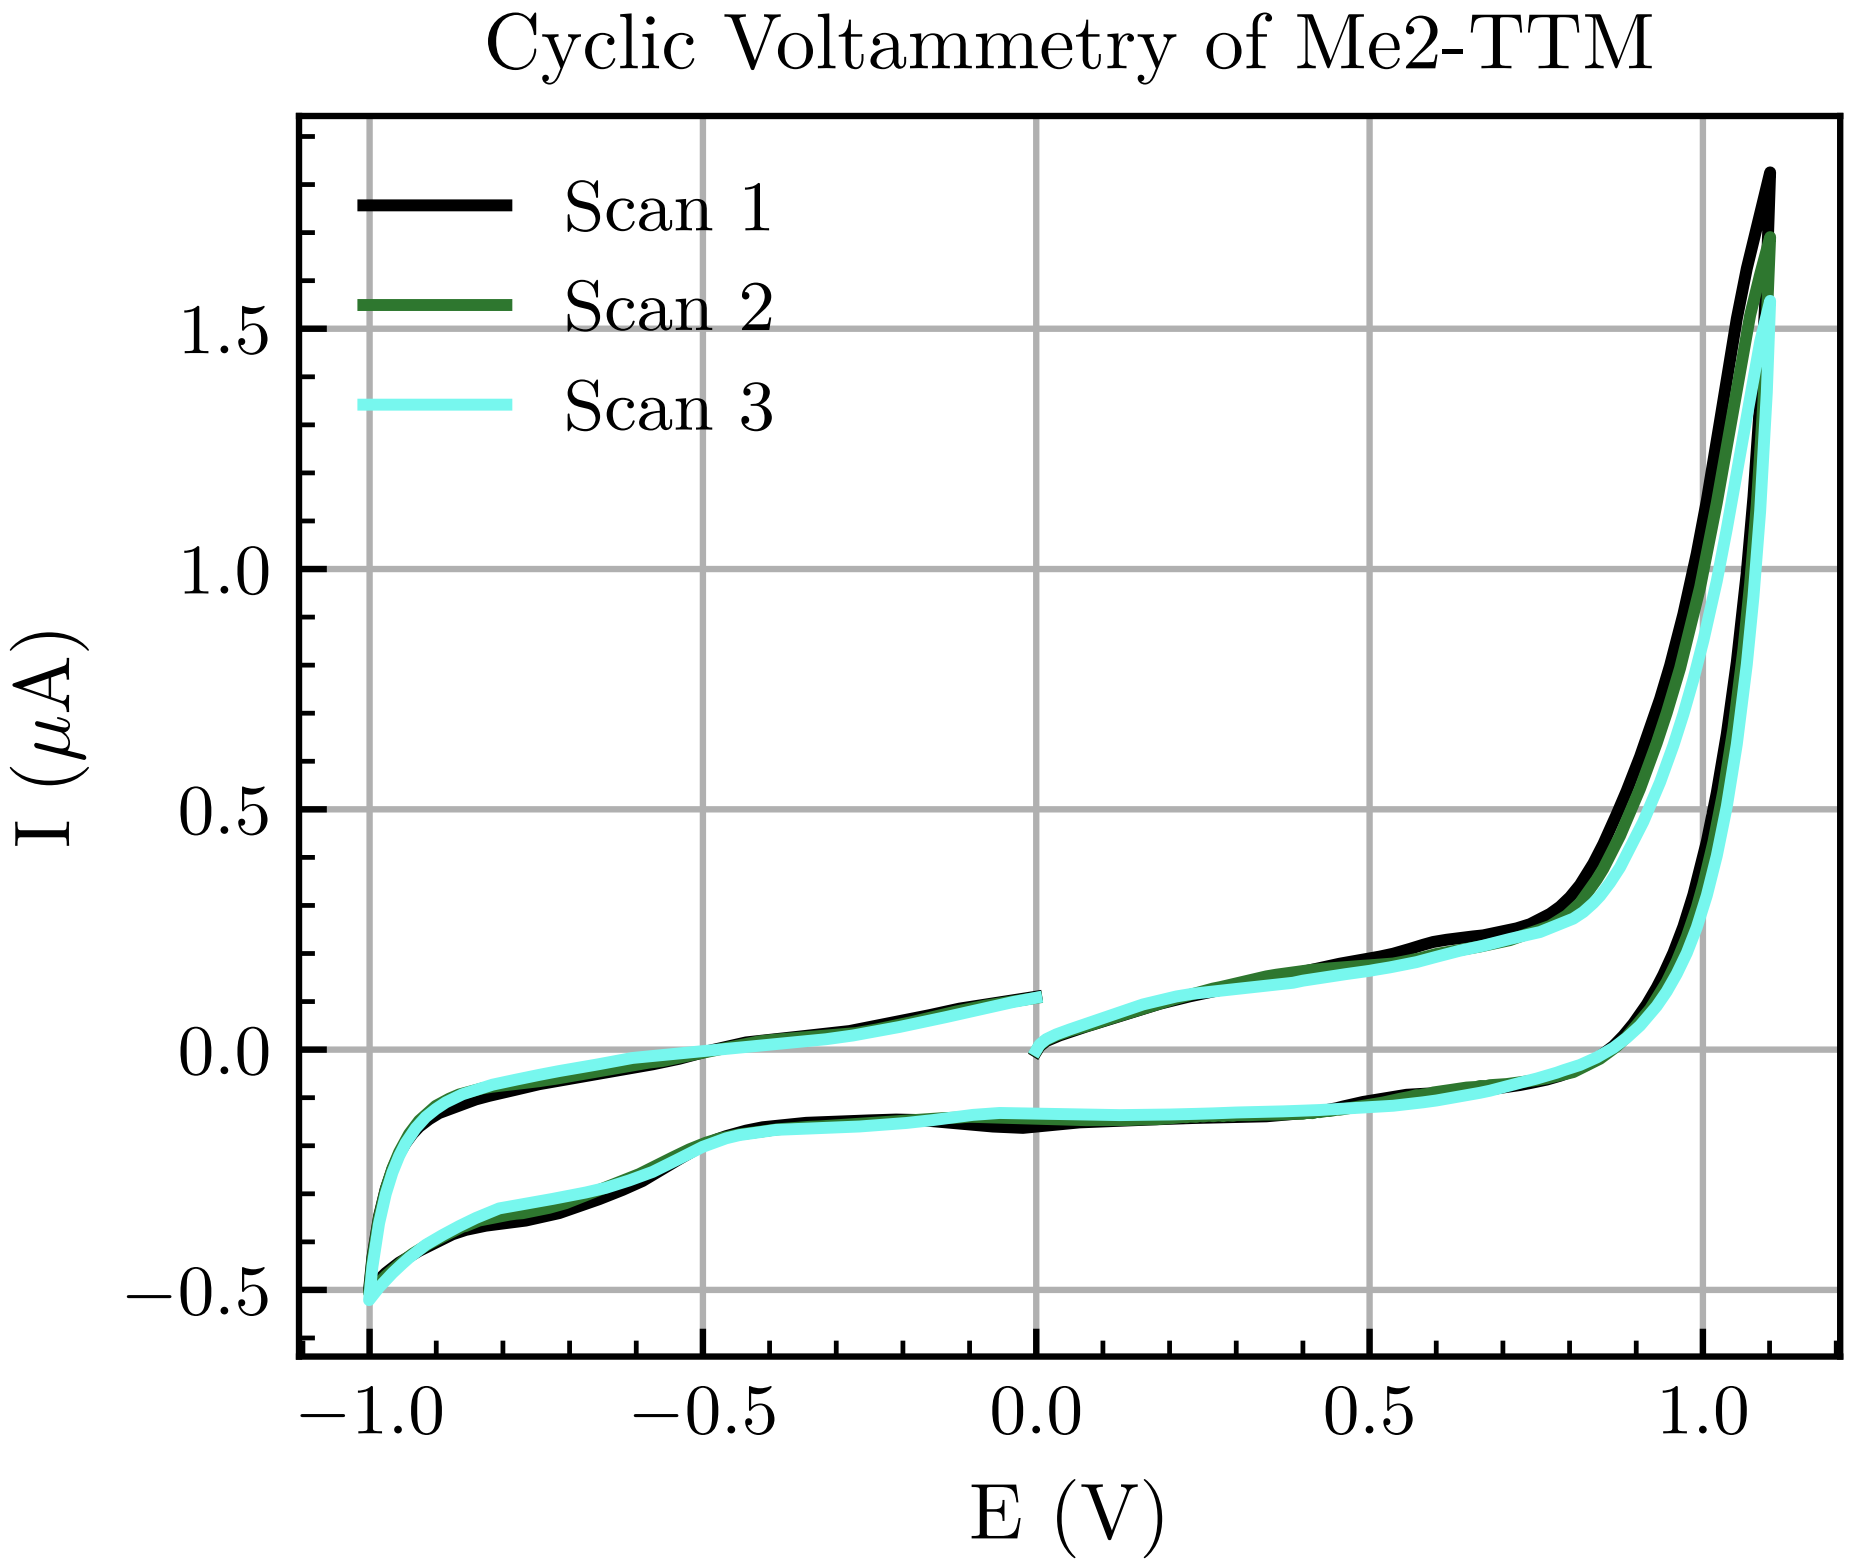
Cyclic Voltammetry of Me2-TTM
Scan 1
Scan 2
Scan 3
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
I (μA)
−1.0
−0.5
0.0
0.5
1.0
E (V)