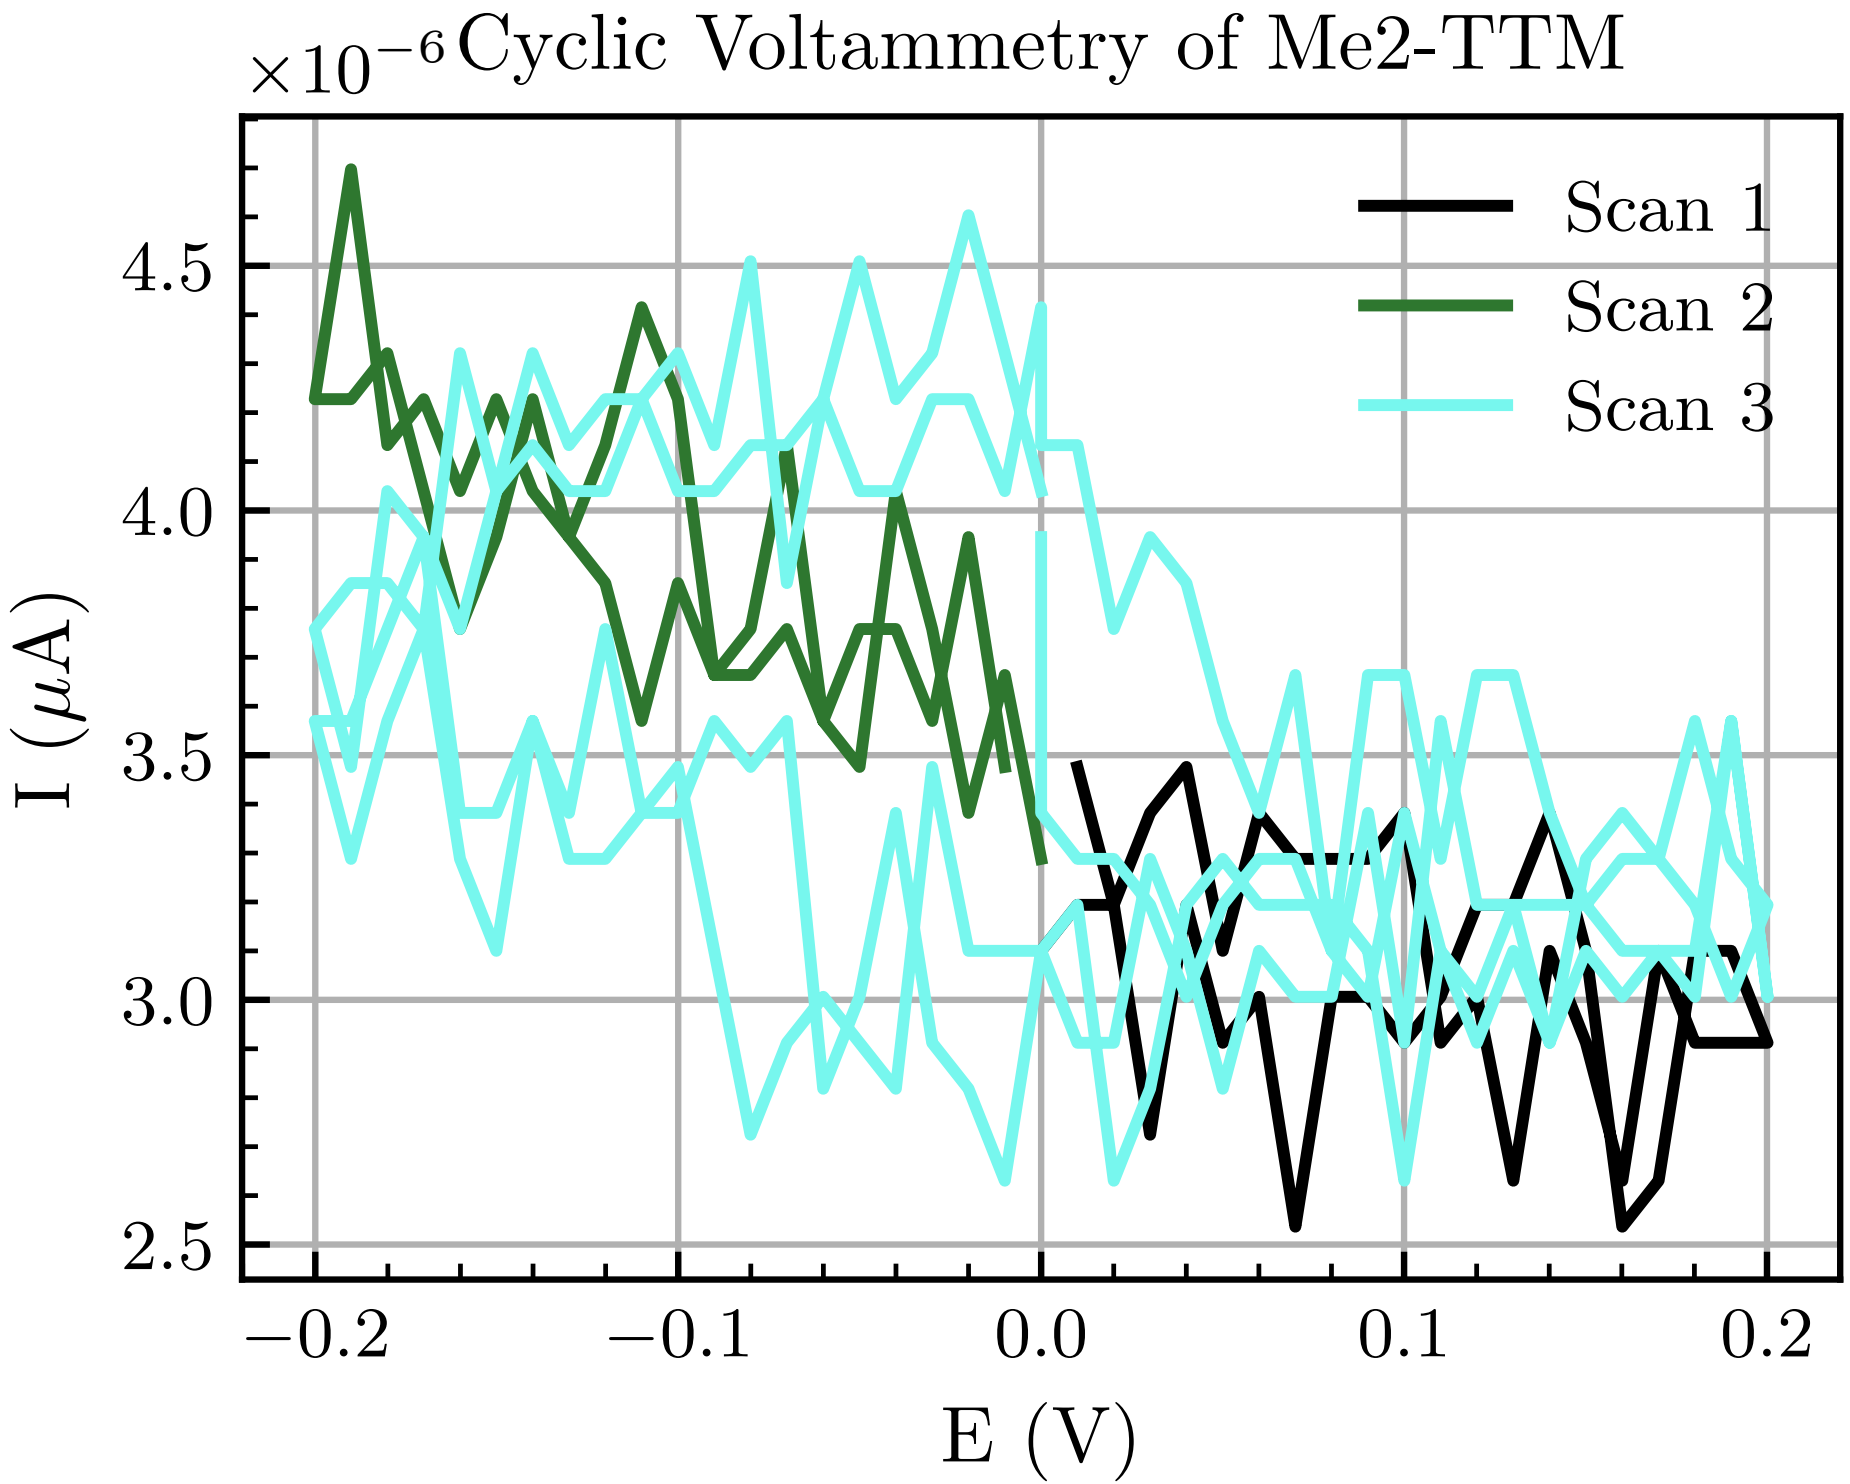
Cyclic Voltammetry of Me2-TTM
×10⁻⁶
Scan 1
Scan 2
Scan 3
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
I (μA)
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
E (V)