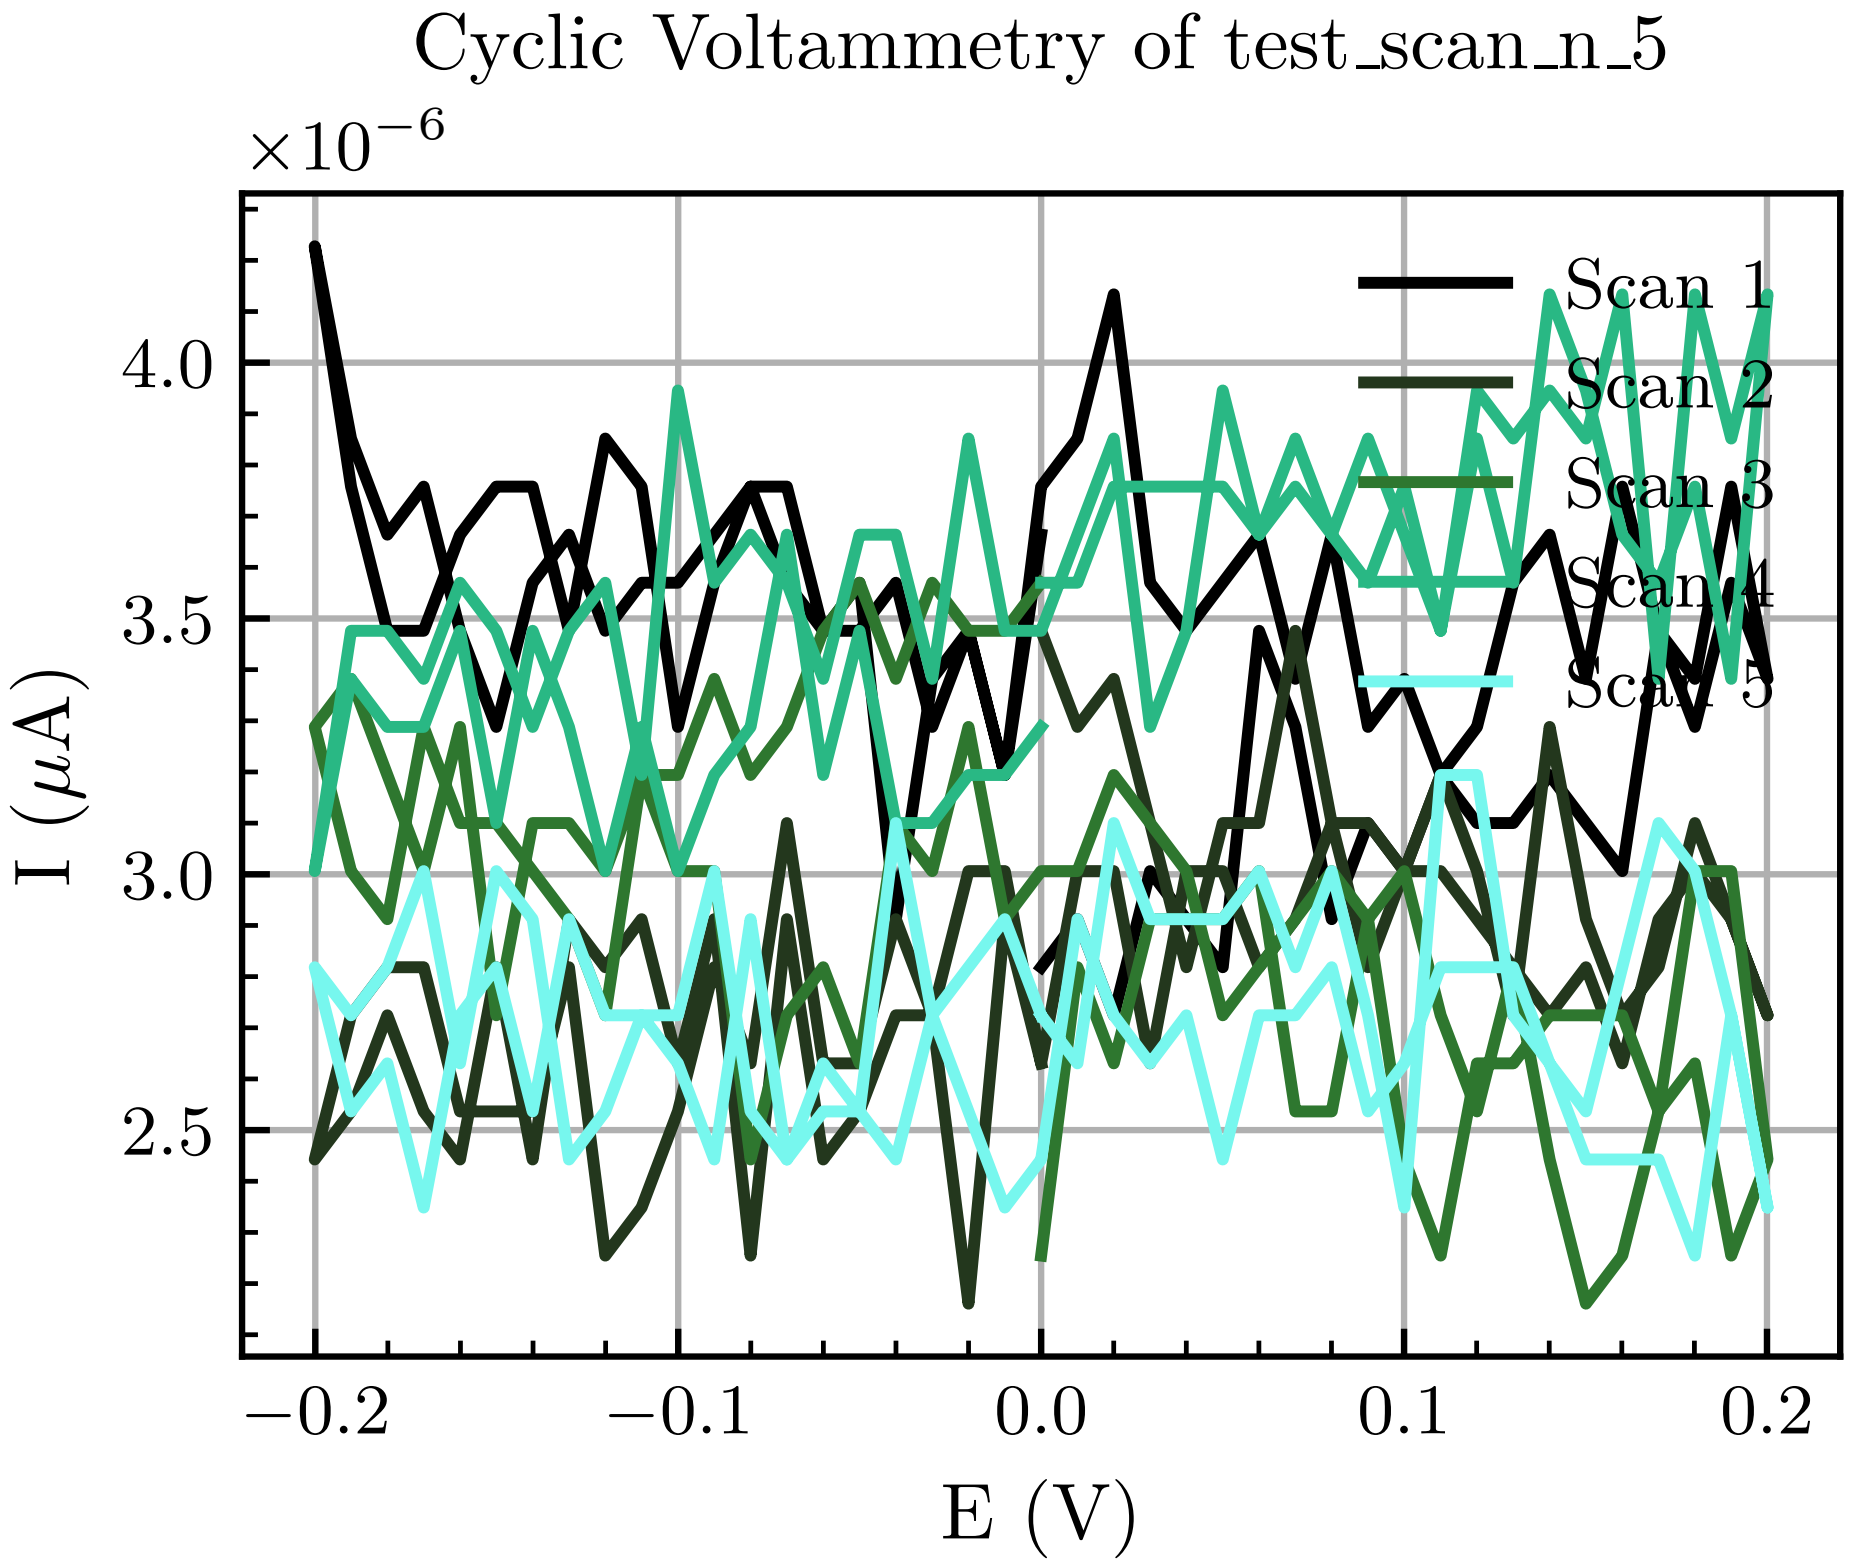
Cyclic Voltammetry of test_scan_n_5
×10^−6
4.0
3.5
3.0
2.5
I (μA)
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
E (V)
Scan 1
Scan 2
Scan 3
Scan 4
Scan 5