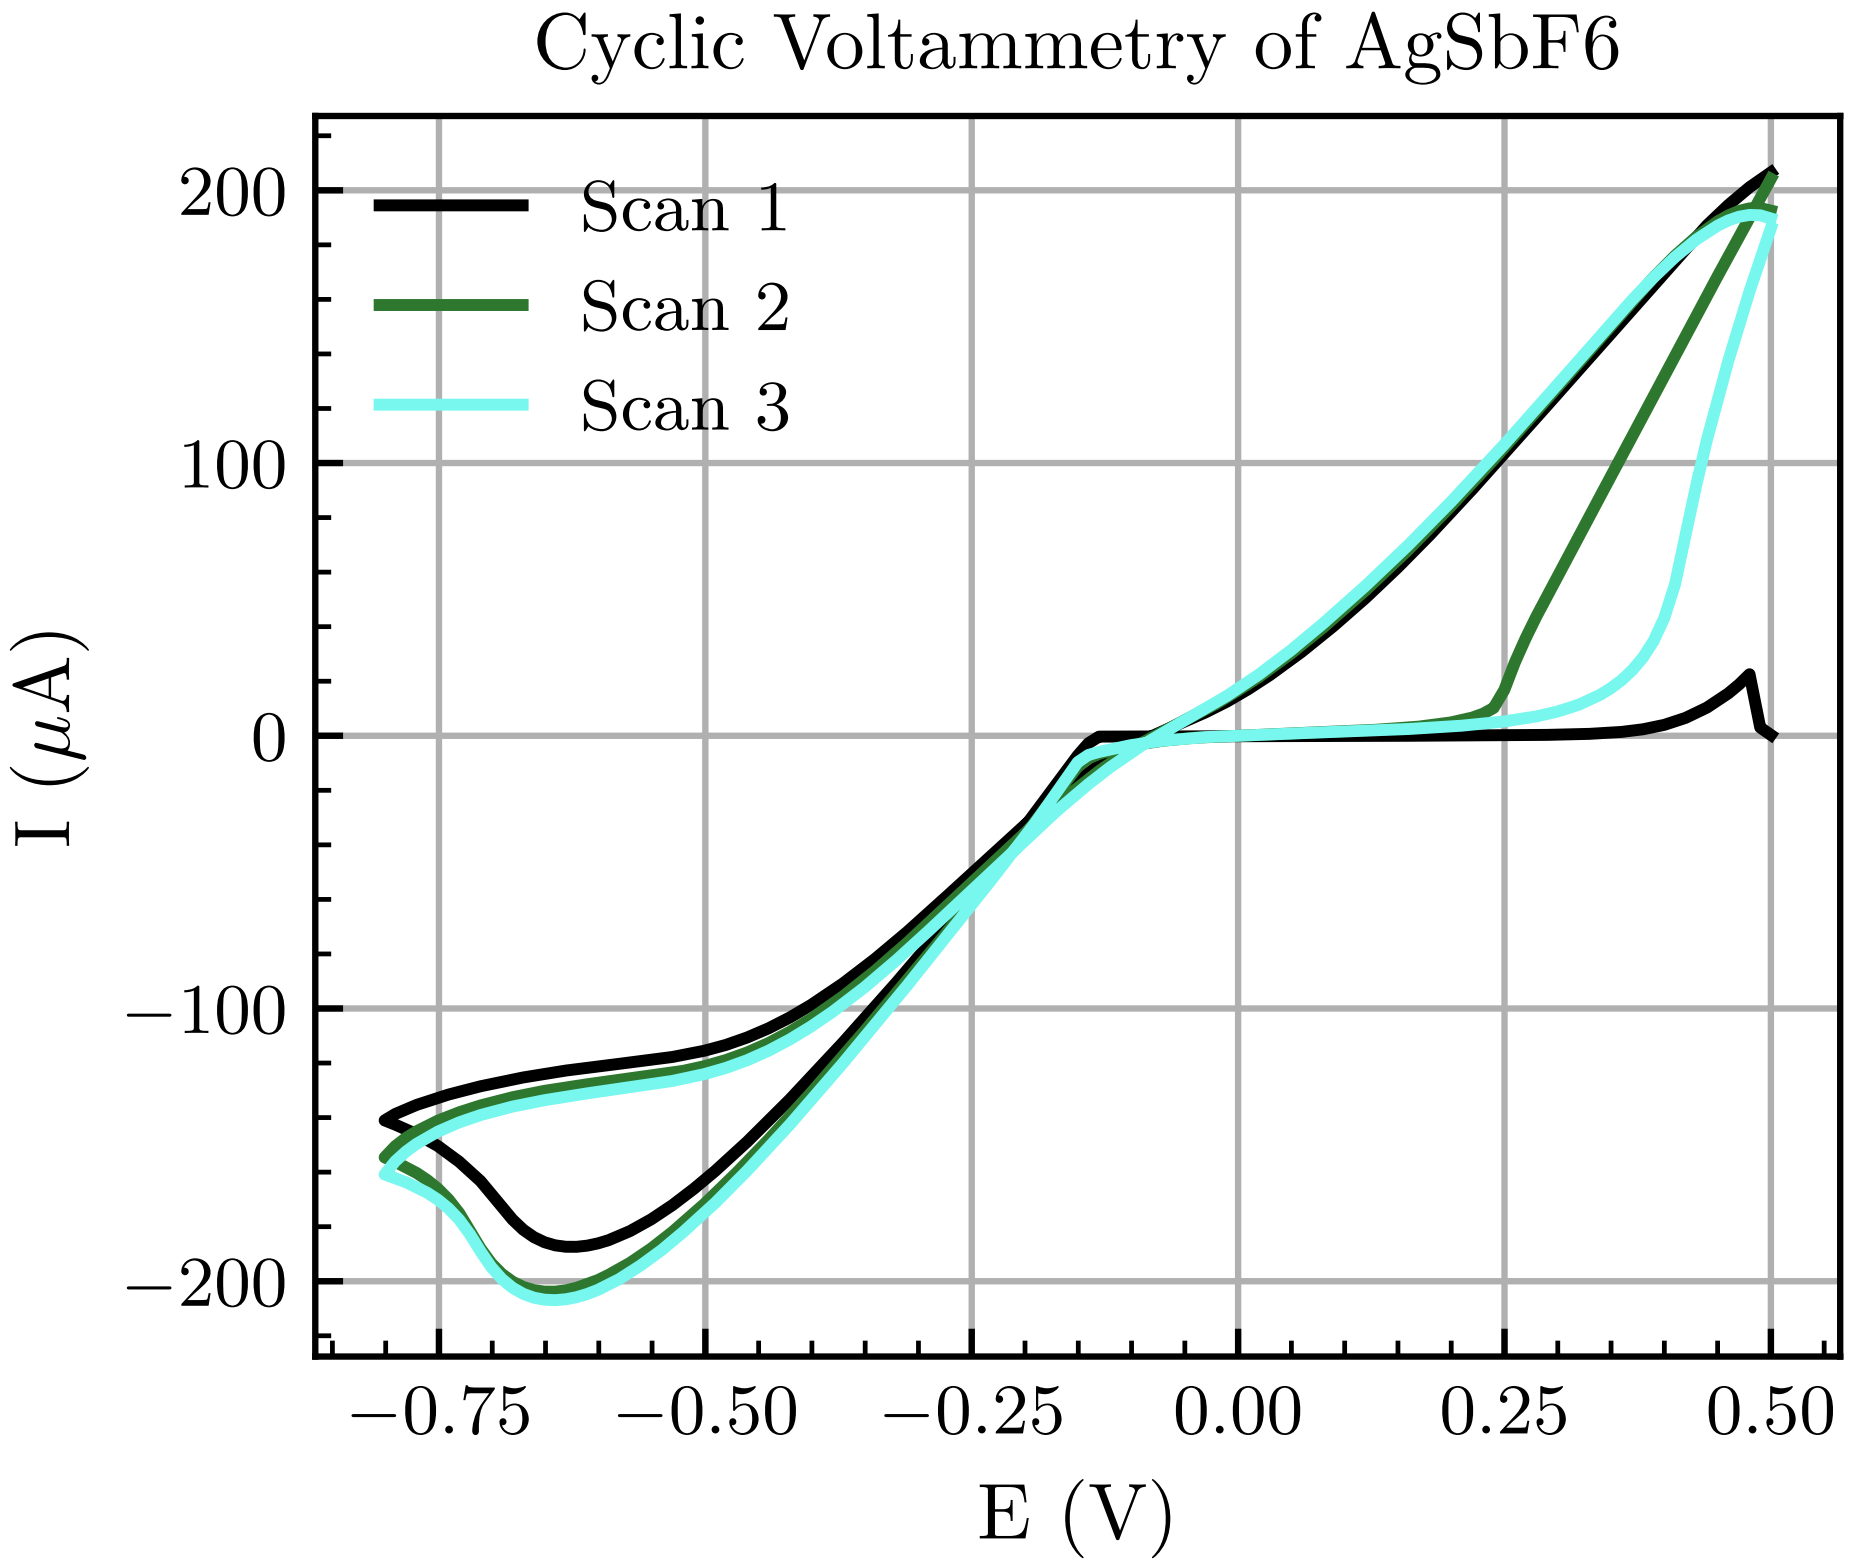
Cyclic Voltammetry of AgSbF6
Scan 1
Scan 2
Scan 3
200
100
0
−100
−200
I (μA)
−0.75
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
E (V)