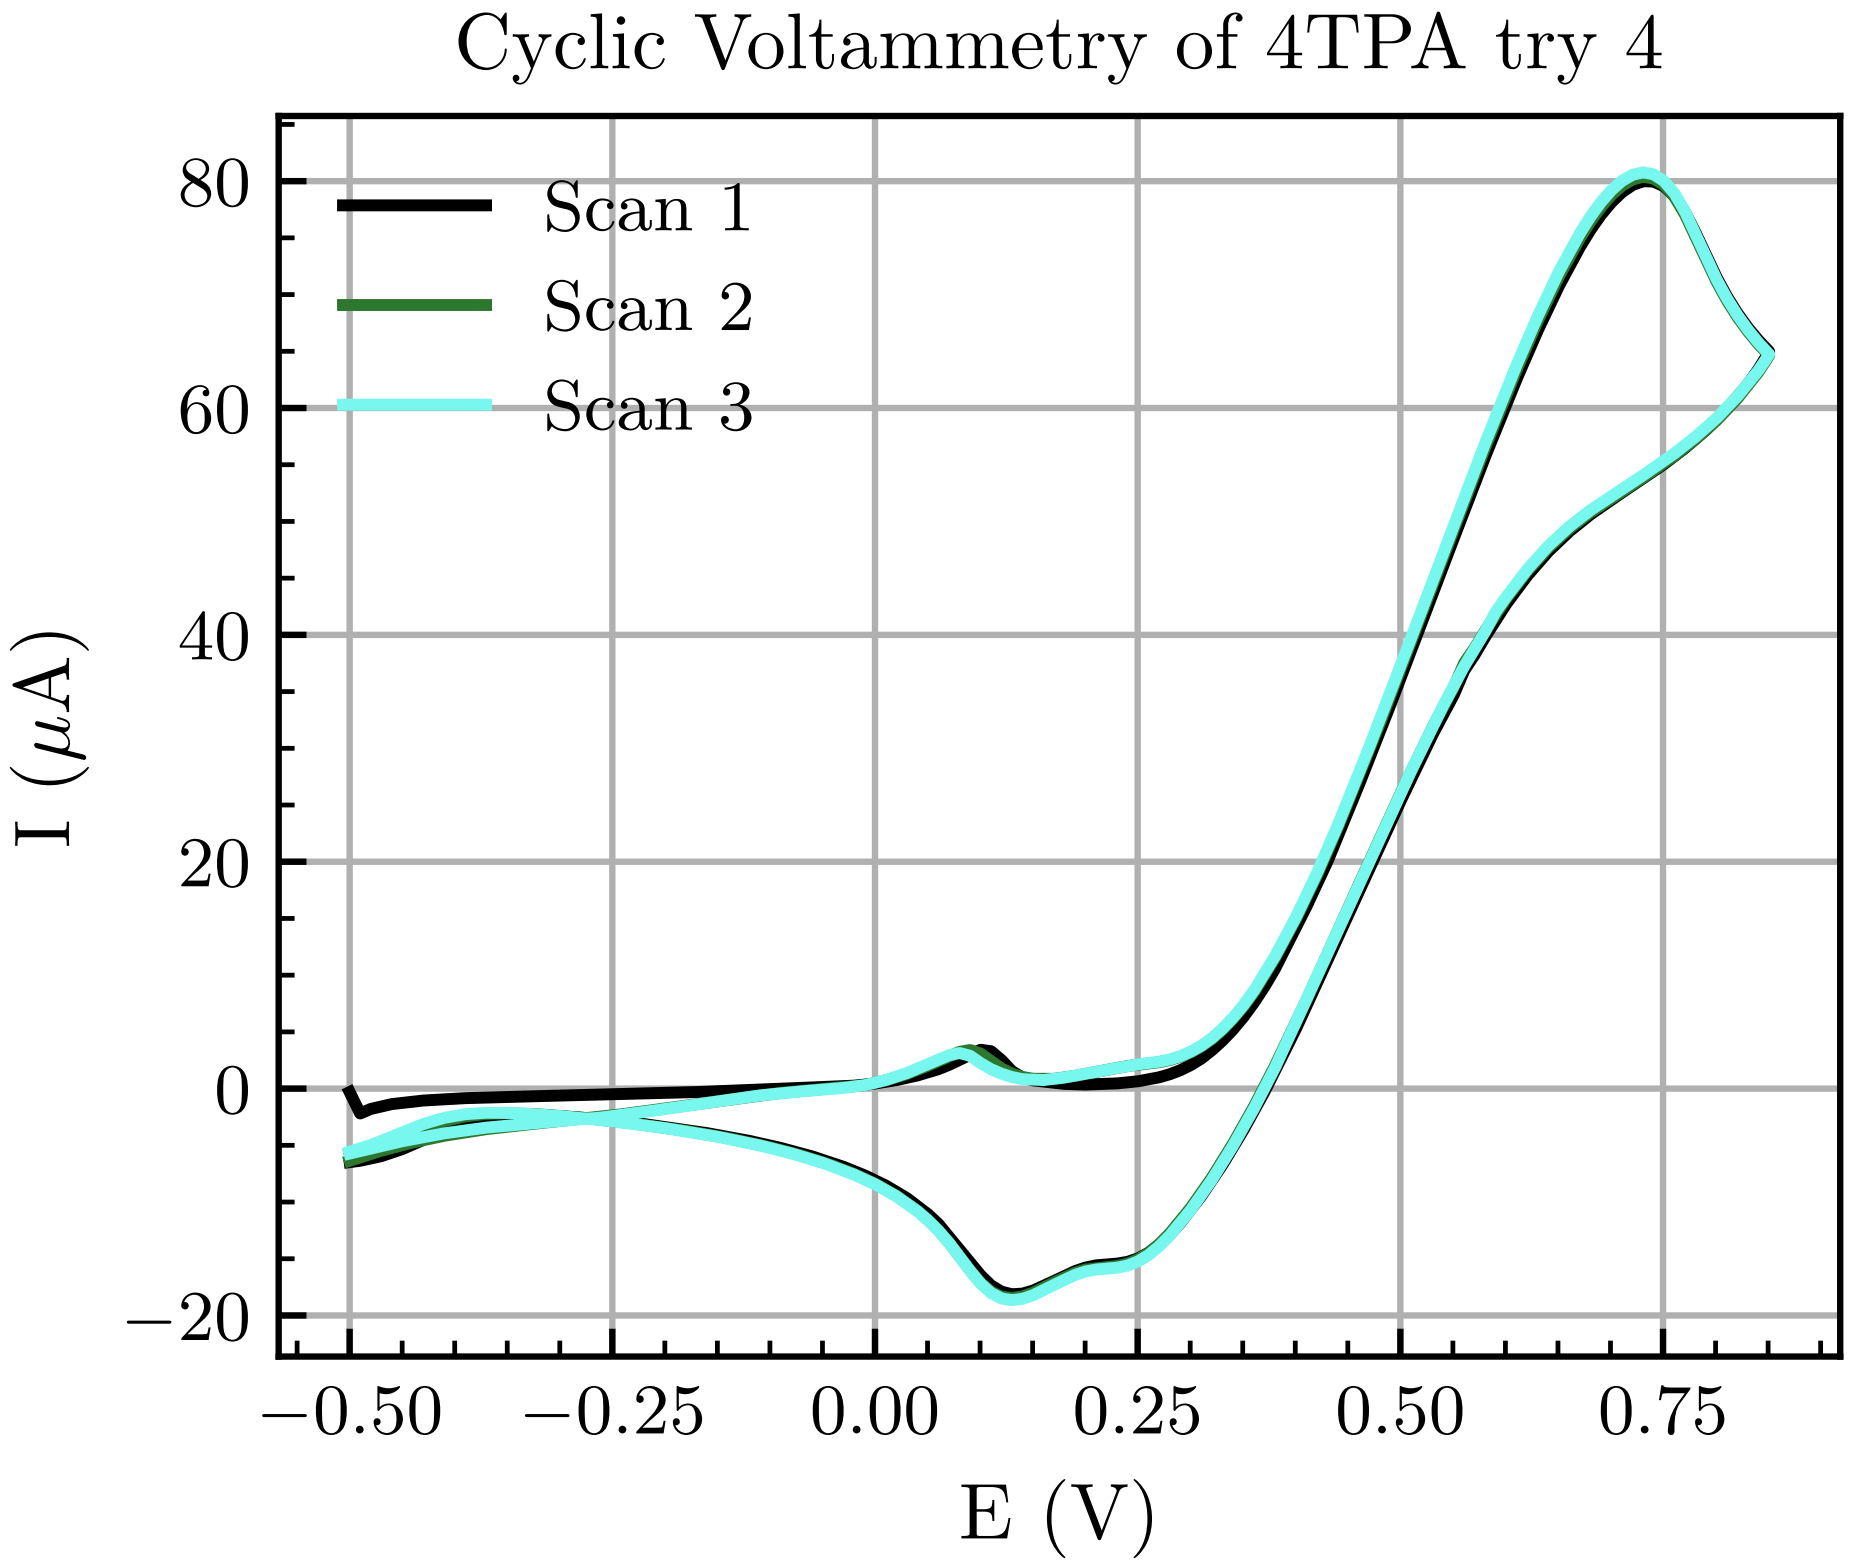
Cyclic Voltammetry of 4TPA try 4
Scan 1
Scan 2
Scan 3
80
60
40
20
0
−20
I (μA)
−0.50
−0.25
0.00
0.25
0.50
0.75
E (V)