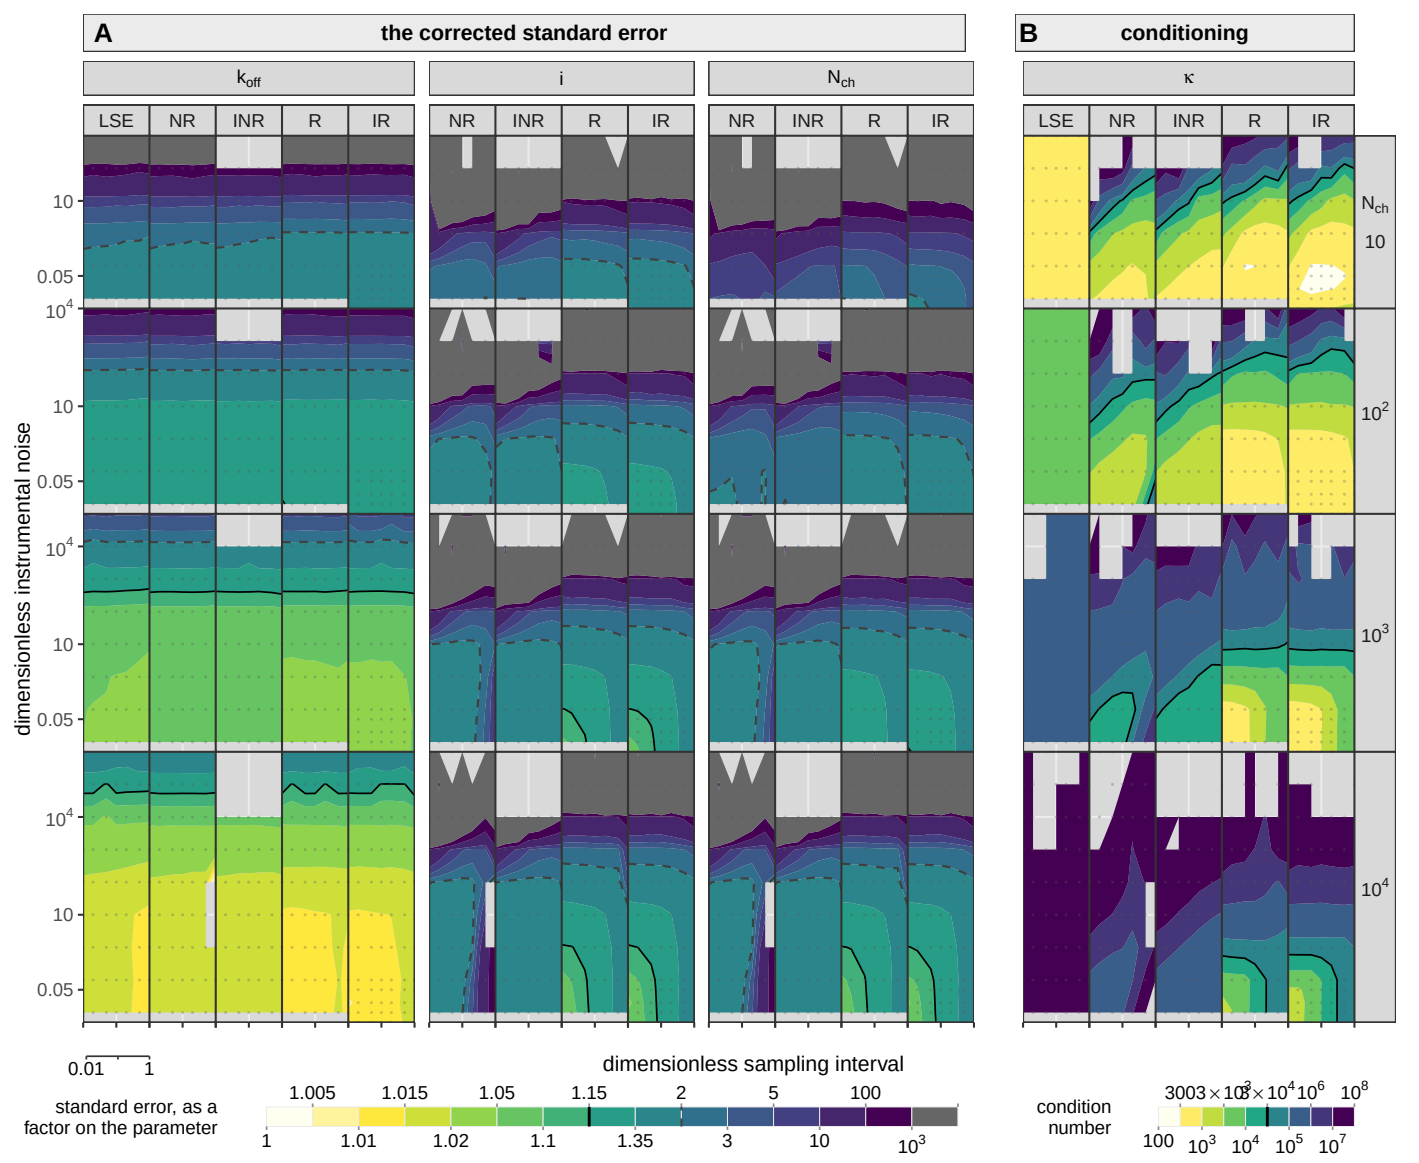
A
the corrected standard error
B
conditioning
k_{off}
i
N_{ch}
κ
LSE
NR
INR
R
IR
dimensionless instrumental noise
10
0.05
10^4
10^2
10^3
dimensionless sampling interval
0.01
1
standard error, as a factor on the parameter
1.005
1.015
1.05
1.15
2
5
100
1
1.01
1.02
1.1
1.35
3
10
10^3
condition number
300
3×10^3
3×10^4
10^6
10^8
100
10^3
10^4
10^5
10^7