


E-104

Laboratório de Tecnologias

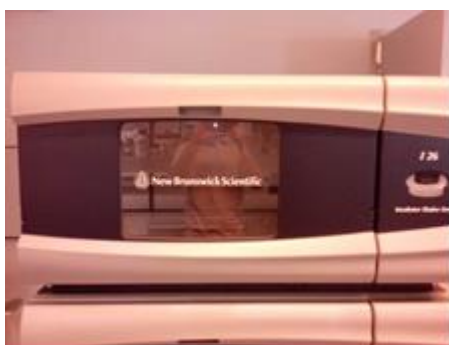

Equipamento Incubadora Orbital

Marca New Brunswick

Modelo Scientific I26

Ano de aquisição 2012

Descrição Incubação de microrganismos.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados.

Docente responsável Filipe Mergulhão

Técnico executante Sílvia Faia
(smfaia@fe.up.pt; ext.4715)

Horário 9h30-12h30 e 14h00-17h00

Preparação de amostras Não aplicável.

Operação O equipamento é operado pelo requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização.

Custo de utilização Pagamento dos custos de manutenção, se existirem.

Procedimento Manual disponível no laboratório.

Observações Consultar a disponibilidade.

E-104

Laboratório de Tecnologias



Equipamento Incubadora Orbital

Marca New Brunswick

Modelo Scientific I26

Ano de aquisição 2012

Descrição Incubação de microrganismos.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados.

Docente responsável Filipe Mergulhão

Técnico executante Sílvia Faia
(smfaia@fe.up.pt; ext.4715)

Horário 9h30-12h30 e 14h00-17h00

Preparação de amostras Não aplicável.

Operação O equipamento é operado pelo requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização.

Custo de utilização Pagamento dos custos de manutenção, se existirem.

Procedimento Manual disponível no laboratório.

Observações Consultar a disponibilidade.

E-104

Laboratório de Tecnologias



Equipamento	Espetrofotómetro UV/VIS
Marca	Thermo
Modelo	Genesys
Ano de aquisição	2008
Descrição	Análise qualitativa e quantitativa por espectrofotometria na região do visível.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização	O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados.
Docente responsável	Filipe Mergulhão
Técnico executante	Sílvia Faia (smfaia@fe.up.pt; ext.4715)
Horário	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	Não aplicável.
Operação	O equipamento é operado pelo requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização.
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, se existirem.
Procedimento	Manual disponível no laboratório.
Observações	Consultar a disponibilidade.

E-104

Laboratório de Tecnologias



Equipamento	Leitor de Microplacas
Marca	Biotek
Modelo	Synergy HT
Ano de aquisição	2012
Descrição	Análise qualitativa e quantitativa por espectrofotometria na região do visível. Análise por fluorescência

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Condições de utilização	O equipamento pode ser operado pelo técnico, estando a sua utilização condicionada à disponibilidade do mesmo, ou pelo requisitante após aprendizagem do funcionamento e regras de segurança e manutenção e garantia que os procedimentos são corretamente executados.
Docente responsável	Filipe Mergulhão
Técnico executante	Sílvia Faia (smfaia@fe.up.pt; ext.4715)
Horário	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	Não aplicável.
Operação	O equipamento é operado pelo requisitante, depois de garantida a observação estrita dos procedimentos e regras de utilização.
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, se existirem.
Procedimento	Manual disponível no laboratório.
Observações	Consultar a disponibilidade.