

DESIGNAÇÃO

Equipamento	Carbono Orgânico Total - TOC
Marca	Shimadzu
Modelo	TOC5000A
Ano de aquisição	2000
Características	Medição de carbono orgânico total (TOC) em amostras líquidas.



REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Docente responsável	Prof. Manuel Fernando Pereira
Técnico executante	Liliana Pereira (E002; ext. 3678; lpereira@fe.up.pt)
Horário de funcionamento	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	A preparação das amostras fica a cargo do: • Técnico do DEQ • Requisitante
Operação	O equipamento é operado por: • Técnico do DEQ • Requisitante
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.
Procedimento	Seguir o manual disponível no laboratório.
Observações	A utilização do equipamento poderá ser mais restrita em períodos de aulas laboratoriais.

DESIGNAÇÃO

Equipamento	Condutivímetro (7 equipamentos)
Marca	Crison
Modelo	Basic 30 (6 eq.) ou GLP 31 (1 eq.)
Ano de aquisição	2002 a 2004
Características	Medição da condutividade de amostras líquidas.



REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Docente responsável	Prof. Manuel Fernando Pereira
Técnico executante	Liliana Pereira (E002; ext. 3678; lpereira@fe.up.pt)
Horário de funcionamento	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	A preparação das amostras fica a cargo do: • Técnico do DEQ • Requisitante
Operação	O equipamento é operado por: • Técnico do DEQ • Requisitante
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.
Procedimento	Seguir o manual disponível no laboratório.
Observações	A utilização do equipamento poderá ser mais restrita em períodos de aulas laboratoriais.

DESIGNAÇÃO

Equipamento	Medidor de pH (4 equipamentos)
Marca	Crison
Modelo	Basic 20
Ano de aquisição	1999
Características	Medição de pH de amostras líquidas.



REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Docente responsável	Prof. Manuel Fernando Pereira
Técnico executante	Liliana Pereira (E002; ext. 3678; lpereira@fe.up.pt)
Horário de funcionamento	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	A preparação das amostras fica a cargo do: • Técnico do DEQ • Requisitante
Operação	O equipamento é operado por: • Técnico do DEQ • Requisitante
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.
Procedimento	Seguir o manual disponível no laboratório.
Observações	A utilização do equipamento poderá ser mais restrita em períodos de aulas laboratoriais.

UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

E002

Laboratório de Ciências do Ambiente

DESIGNAÇÃO

Equipamento	Digestor para carência química em oxigénio (CQO) - refluxo fechado
Marca	Merck
Modelo	Termoreator TR300
Ano de aquisição	1999
Características	Digestão de amostras líquidas para medição da CQO.



REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Docente responsável	Prof. Manuel Fernando Pereira
Técnico executante	Liliana Pereira (E002; ext. 3678; lpereira@fe.up.pt)
Horário de funcionamento	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	A preparação das amostras fica a cargo do: • Técnico do DEQ • Requisitante
Operação	O equipamento é operado por: • Técnico do DEQ • Requisitante
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.
Procedimento	Seguir o manual disponível no laboratório.
Observações	A utilização do equipamento poderá ser mais restrita em períodos de aulas laboratoriais.

DESIGNAÇÃO

Equipamento	Digestor de refluxo aberto
Marca	G.Vittadini
Modelo	Recod6
Ano de aquisição	1999
Características	Digestão de amostras líquidas para medição da CQO. Digestão de amostras sólidas para determinação de metais.



REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Docente responsável	Prof. Manuel Fernando Pereira
Técnico executante	Liliana Pereira (E002; ext. 3678; lpereira@fe.up.pt)
Horário de funcionamento	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	A preparação das amostras fica a cargo do: • Técnico do DEQ • Requisitante
Operação	O equipamento é operado por: • Técnico do DEQ • Requisitante
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.
Procedimento	Seguir o manual disponível no laboratório.
Observações	A utilização do equipamento poderá ser mais restrita em períodos de aulas laboratoriais.

UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

E002

Laboratório de Ciências do Ambiente

DESIGNAÇÃO

Equipamento	Turbidímetro
Marca	Hanna
Modelo	HI88703
Ano de aquisição	2014
Características	Medição da turvação de amostras líquidas.



REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Docente responsável	Prof. Manuel Fernando Pereira
Técnico executante	Liliana Pereira (E002; ext. 3678; lpereira@fe.up.pt)
Horário de funcionamento	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	Não aplicável.
Operação	O equipamento é operado por: • Técnico do DEQ • Requisitante
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.
Procedimento	Seguir o manual disponível no laboratório.
Observações	A utilização do equipamento poderá ser mais restrita em períodos de aulas laboratoriais.

DESIGNAÇÃO

Equipamento	Jar test
Marca	Velp
Modelo	JTL6
Ano de aquisição	2006
Características	Realização de ensaios de coagulação/floculação.



REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Docente responsável	Prof. Manuel Fernando Pereira
Técnico executante	Liliana Pereira (E002; ext. 3678; lpereira@fe.up.pt)
Horário de funcionamento	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	Não aplicável.
Operação	O equipamento é operado por: • Técnico do DEQ • Requisitante
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.
Procedimento	Seguir o manual disponível no laboratório.
Observações	A utilização do equipamento poderá ser mais restrita em períodos de aulas laboratoriais.

UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

E002

Laboratório de Ciências do Ambiente

DESIGNAÇÃO

Equipamento	Fotómetro
Marca	Merck
Modelo	Spectroquant® NOVA 60
Ano de aquisição	1999
Características	Medição da carência química em oxigénio (CQO).



REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Docente responsável	Prof. Manuel Fernando Pereira
Técnico executante	Liliana Pereira (E002; ext. 3678; lpereira@fe.up.pt)
Horário de funcionamento	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	A preparação das amostras fica a cargo do: • Técnico do DEQ • Requisitante
Operação	O equipamento é operado por: • Técnico do DEQ • Requisitante
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.
Procedimento	Seguir o manual disponível no laboratório.
Observações	A utilização do equipamento poderá ser mais restrita em períodos de aulas laboratoriais.

DESIGNAÇÃO

Equipamento	Mufla
Marca	Nabertherm
Modelo	L5/C6
Ano de aquisição	1999
Características	Calcinação de amostras.



REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Docente responsável	Prof. Manuel Fernando Pereira
Técnico executante	Liliana Pereira (E002; ext. 3678; lpereira@fe.up.pt)
Horário de funcionamento	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	A preparação das amostras fica a cargo do: • Técnico do DEQ • Requisitante
Operação	O equipamento é operado por: • Técnico do DEQ • Requisitante
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.
Procedimento	Seguir o manual disponível no laboratório.
Observações	A utilização do equipamento poderá ser mais restrita em períodos de aulas laboratoriais.

UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

E002

Laboratório de Ciências do Ambiente

DESIGNAÇÃO

Equipamento	Espectrofotómetro UV-VIS de feixe duplo
Marca	Thermo scientific
Modelo	Genesis 10UV
Ano de aquisição	2008
Características	Análise qualitativa e quantitativa por espectrofotometria na regiões do ultra-violeta e visível em cuvette.



REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Docente responsável	Prof. Manuel Fernando Pereira
Técnico executante	Liliana Pereira (E002; ext. 3678; lpereira@fe.up.pt)
Horário de funcionamento	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	A preparação das amostras fica a cargo do: • Técnico do DEQ • Requisitante
Operação	O equipamento é operado por: • Técnico do DEQ • Requisitante
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.
Procedimento	Seguir o manual disponível no laboratório.
Observações	A utilização do equipamento poderá ser mais restrita em períodos de aulas laboratoriais.

UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

E002

Laboratório de Ciências do Ambiente

DESIGNAÇÃO

Equipamento	Espectrofotómetro UV-VIS de feixe duplo
Marca	PG Instruments
Modelo	T60
Ano de aquisição	2005
Características	Análise qualitativa e quantitativa por espectrofotometria na regiões do ultra-violeta e visível em cuvete e por aspiração.



REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Docente responsável	Prof. Manuel Fernando Pereira
Técnico executante	Liliana Pereira (E002; ext. 3678; lpereira@fe.up.pt)
Horário de funcionamento	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	A preparação das amostras fica a cargo do: • Técnico do DEQ • Requisitante
Operação	O equipamento é operado por: • Técnico do DEQ • Requisitante
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.
Procedimento	Seguir o manual disponível no laboratório.
Observações	A utilização do equipamento poderá ser mais restrita em períodos de aulas laboratoriais.

DESIGNAÇÃO

Equipamento	Carbono Orgânico Total - TOC
Marca	Shimadzu
Modelo	TOC-LCSH
Ano de aquisição	2015
Características	Medição de carbono orgânico total (TOC) e Azoto Total (TN) em amostras líquidas.



REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Docente responsável	Prof. Manuel Fernando Pereira
Técnico executante	Liliana Pereira (E002; ext. 3678; lpereira@fe.up.pt)
Horário de funcionamento	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	A preparação das amostras fica a cargo do: • Técnico do DEQ • Requisitante
Operação	O equipamento é operado por: • Técnico do DEQ • Requisitante
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.
Procedimento	Seguir o manual disponível no laboratório.
Observações	Equipamento ainda em fase de teste.


UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

E002

Laboratório de Ciências do Ambiente

DESIGNAÇÃO

Equipamento	Agitador Orbital
Marca	J.P. Seleta
Modelo	"Rotabit"
Ano de aquisição	2016
Características	O controlo de velocidade variável garante uma agitação consistente e uniforme.

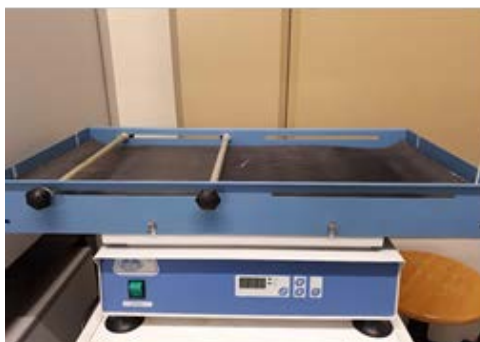

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Docente responsável	Prof. Manuel Fernando Pereira
Técnico executante	Liliana Pereira (E002; ext. 3678; lpereira@fe.up.pt)
Horário de funcionamento	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	A preparação das amostras fica a cargo do: • Técnico do DEQ • Requisitante
Operação	O equipamento é operado por: • Técnico do DEQ • Requisitante
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.
Procedimento	Seguir o manual disponível no laboratório.
Observações	A utilização do equipamento poderá ser mais restrita em períodos de aulas laboratoriais.

UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

E002

Laboratório de Ciências do Ambiente

DESIGNAÇÃO

Equipamento	Espectrofotómetro/Fotómetro
Marca	Hach
Modelo	DR 2000
Ano de aquisição	2017 (protocolo IDIT)
Características	Medição de varios parâmetros (por exemplo: nitritos, CQO, nitratos, etc.)



REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Docente responsável	Prof. Manuel Fernando Pereira
Técnico executante	Liliana Pereira (E002; ext. 3678; lpereira@fe.up.pt)
Horário de funcionamento	9h30-12h30 e 14h00-17h00
Preparação de amostras	A preparação das amostras fica a cargo do: • Técnico do DEQ • Requisitante
Operação	O equipamento é operado por: • Técnico do DEQ • Requisitante
Custo de utilização	Pagamento dos custos de manutenção, consoante % de utilização.
Procedimento	Seguir o manual disponível no laboratório.
Observações	A utilização do equipamento poderá ser mais restrita em períodos de aulas laboratoriais.