


Calibrazione Multimetro Oscilloscopio

Voltaggio Oscilloscopio (mV)

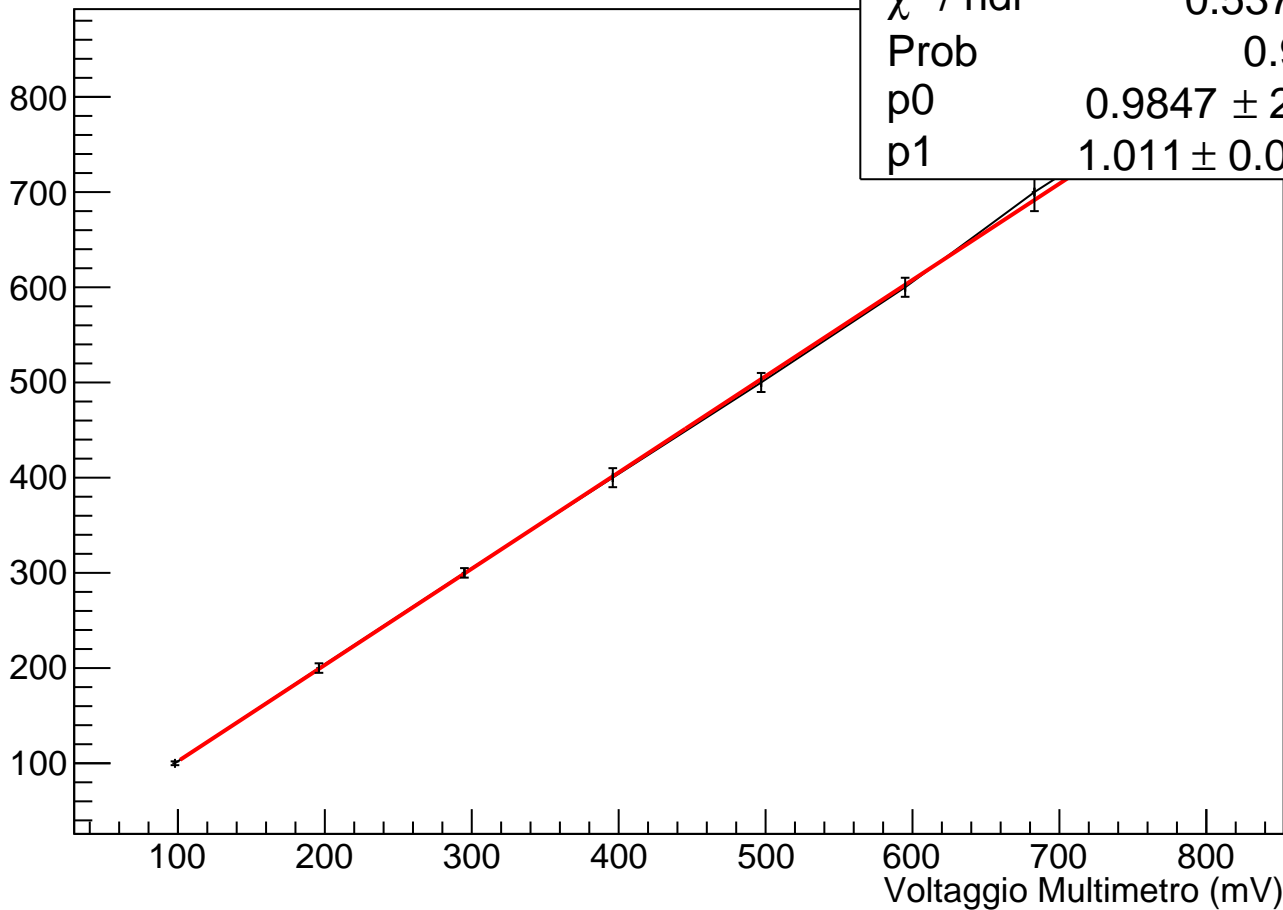

χ^2 / ndf	0.5374 / 6
Prob	0.9974
p0	0.9847 ± 2.645
p1	1.011 ± 0.01201